

大功率直流电源

IT6600D 系列 用户手册



型号: IT6600D 系列

版本号: V1.2/11,2024

声明

© Itech Electronic, Co., Ltd.
2024
根据国际版权法，未经 Itech Electronic, Co., Ltd. 事先允许和书面同意，不得以任何形式（包括电子存储和检索或翻译为其他国家或地区语言）复制本手册中的任何内容。

手册部件号

IT6600D

版本

第1版，2024年11月
29日发布

Itech Electronic, Co., Ltd.

商标声明

Pentium是 Intel Corporation 在美国的注册商标。

Microsoft、Visual Studio、Windows 和 MS Windows是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。

担保

本文档中包含的材料按现状提供，在将来版本中如有更改，恕不另行通知。此外，在适用法律允许的最大范围内，**ITECH** 不承诺与本手册及其包含的任何信息相关的任何明示或暗示的保证，包括但不限于对适销和适用于某种特定用途的暗示保证。**ITECH** 对提供、使用或应用本文档及其包含的任何信息所引起的错误或偶发或间接损失概不负责。如 **ITECH** 与用户之间存在其他书面协议含有与本文档材料中所包含条款冲突的保证条款，以其他书面协议中的条款为准。

技术许可

本文档中描述的硬件和 / 或软件仅在得到许可的情况下提供并且只能根据许可进行使用或复制。

限制性权限声明

美国政府限制性权限。授权美国政府使用的软件和技术数据权限仅包括那些定制提供给最终用户的权限。

ITECH 在软件和技术数据中提供本定制商业许可时遵循 FAR 12.211（技术数据）和 12.212（计算机软件）以及 DFARS 252.227-70 15（技术数据—商业制品）和 DFARS 227.7202-3（商业计算机软件或计算机软件文档中的权限）。

安全声明

小心

小心标志表示有危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意，如果不正确地执行或不遵守操作步骤，则可能导致产品损坏或重要数据丢失。在没有完全理解指定的条件且不满足这些条件的情况下，请勿继续执行小心标志所指示的任何不当操作。

警告

警告标志表示有危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意，如果不正确地执行操作或不遵守操作步骤，则可能导致人身伤亡。在没有完全理解指定的条件且不满足这些条件的情况下，请勿继续执行警告标志所指示的任何不当操作。



说明

说明标志表示有提示，它要求在执行操作步骤时需要参考，给操作员提供窍门或信息补充。

认证与质量保证

本系列仪器完全达到手册中所标称的各项技术指标。

保固服务

ITECH 公司对本产品的材料及制造，自出货日期起提供一年的质量保固服务（保固服务除以下保固限制内容）。

本产品若需保固服务或修理，请将产品送回 ITECH 公司指定的维修单位。

- 若需要送回 ITECH 公司作保固服务的产品，顾客须预付寄送到 ITECH 维修部的单程运费，ITECH 公司将负责支付回程运费。
- 若从其它国家送回 ITECH 公司做保固服务，则所有运费、关税及其它税赋均须由顾客负担。

保证限制

保固服务不适用于因以下情况所造成的损坏：

- 顾客自行安装的电路造成的损坏，或顾客使用自己的产品造成的瑕疵；
- 顾客自行修改或维修过的产品；
- 顾客自行安装的电路造成的损坏或在指定的环境外操作本产品造成的损坏；
- 产品型号或机身序列号被改动、删除、移除或无法辨认；
- 由于事故造成的损坏，包括但不限于雷击、进水、火灾、滥用或疏忽。

安全标志

	直流电		ON（电源合）
	交流电		OFF(电源断)
	既有直流也有交流电		电源合闸状态
	保护性接地端子		电源断开状态
	接地端子		参考端子
	危险标志		正接线柱
	警告标志（请参阅本手册了解具体的警告或小心信息）		负接线柱
	地线连接端标识		-

安全注意事项

在此仪器操作的各个阶段中，必须遵循以下一般安全预防措施。如果未遵循这些预防措施或本手册其他部分说明的特定警告，则会违反有关仪器的设计、制造和

用途方面的安全标准。艾德克斯公司对用户不遵守这些预防措施的行为不承担任何责任。

警告

- 请勿使用已损坏的设备。在使用设备之前，请先检查其外壳，检查是否存在裂缝。请勿在含有易爆气体、蒸汽或粉尘的环境中操作本设备。
- 设备出厂时提供了电源线，您的设备应该被连接到带有保护接地的插座、接线盒或三相配电箱。在操作设备之前，请先确定设备接地良好！
- 请始终使用所提供的电缆连接设备。
- 在连接设备之前，请观察设备上的所有标记。
- 使用具有适当额定负载的电线，所有负载电线的容量必须能够承受电源的最大短路输出电流而不会发生过热。如果有多个负载，则每对负载电线都必须能安全承载电源的满载额定短路输出电流。
- 为减少起火和电击风险，请确保市电电源的电压波动不超过工作电压范围的10%。
- 请勿自行在仪器上安装替代零件，或执行任何未经授权的修改。
- 请勿在可拆卸的封盖被拆除或松动的情況下使用本设备。
- 请仅使用制造商提供的电源适配器以避免发生意外伤害。
- 我们对于使用本产品时可能发生的直接或间接财务损失，不承担责任。
- 本设备用于工业用途，不适用于 IT 电源系统。
- 严禁将本设备使用于生命维持系统或其他任何有安全要求的设备上。

警告

- 电击危险、请将仪器接地。本产品带有保护性接地端子。要尽量减小电击的危险，必须通过接地电源线将仪器连接到交流电源，将接地导线牢固地连接到电源插座或者交流配电箱的接地（安全接地）端。中断保护（接地）导线或断开接地保护端子的连接将导致潜在电击危险，从而可能造成人身伤害或死亡。
- 接通电源前，确认已采取了所有的安全预防措施。所有连接必须在关闭设备电源的情况下进行，并且所有连接必须由熟悉相关危险的合格人员执行。操作不正确可能会造成致命伤害和设备损坏。
- 电击危险、致命电压。本产品能输出导致人身伤害的危险电压，操作人员必须始终受到电击保护。请确保使用提供的保护罩对输入电极周围采取绝缘或盖板防护措施，以避免意外接触致命的电压。
- 关闭设备后，正负电极上可能仍存在危险电压，千万不要立即触摸电缆或电极。确保在触摸电极或感测端子之前，它们不存在危险电压。

小心

- 若未按照制造商指定的方式使用设备，则可能会破坏该设备提供的保护。
- 请始终使用干布清洁设备外壳。请勿清洁仪器内部。
- 切勿堵塞设备的通风孔。

环境条件

本系列仪器仅允许在室内以及低凝结区域使用，下表显示了本仪器的一般环境要求。

环境条件	要求
操作温度	0°C~50°C
操作湿度	20%~80%（非冷凝）
存放温度	-10°C~70 °C
海拔高度	操作海拔最高 2000 米
安装类别	安装类别 II
污染度	污染度 2



说明

为了保证测量精度，建议温机半小时后开始操作。

法规标记

	CE 标记表示产品符合所有相关的欧洲法律规定（如果带有年份，则表示批准此设计的年份）。
	UKCA 标记表示产品符合所有相关的英国法律规定（如果带有年份，则表示批准此设计的年份）。
	此仪器符合 WEEE 指令（2002/96/EC）标记要求，此附加产品标签说明不得将此电器/电子产品丢弃在家庭垃圾中。
	此符号表示在所示的时间段内，危险或有毒物质不会在正常使用中泄漏或造成损害，该产品的使用寿命为十年。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应进入回收循环系统。

废弃电子电器设备指令（WEEE）



废弃电子电器设备指令（WEEE），2002/96/EC

本产品符合 WEEE 指令（2002/96/EC）的标记要求。此标识表示不能将此电子设备当作一般家庭废弃物处理。

产品类别

按照 WEEE 指令附件 I 中的设备分类，本仪器属于监测类产品。

要返回不需要的仪器，请与您最近的 ITECH 销售处联系。

Compliance Information

Complies with the essential requirements of the following applicable European Directives, and carries the CE marking accordingly:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
- Low-Voltage Directive (Safety) 2014/35/EU

Conforms with the following product standards:

EMC Standard

IEC 61326-1:2012/ EN 61326-1:2013 ¹²³

Reference Standards

CISPR 11:2009+A1:2010/ EN 55011:2009+A1:2010 (Group 1, Class A)

IEC 61000-4-2:2008/ EN 61000-4-2:2009

IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010/ EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010

IEC 61000-4-4:2004+A1:2010/ EN 61000-4-4:2004+A1:2010

IEC 61000-4-5:2005/ EN 61000-4-5:2006

IEC 61000-4-6:2008/ EN 61000-4-6:2009

IEC 61000-4-11:2004/ EN 61000-4-11:2004

1. The product is intended for use in non-residential/non-domestic environments. Use of the product in residential/domestic environments may cause electromagnetic interference.
2. Connection of the instrument to a test object may produce radiations beyond the specified limit.
3. Use high-performance shielded interface cable to ensure conformity with the EMC standards listed above.

Safety Standard

IEC 61010-1:2010/ EN 61010-1:2010

目录

认证与质量保证.....	i
保固服务	i
保证限制	i
安全标志	i
安全注意事项.....	i
环境条件	iii
法规标记	iii
废弃电子电器设备指令（WEEE）	iii
Compliance Information	iv
第一章 快速参考.....	1
1.1 产品概览	1
1.2 选型表和选配件	1
1.3 前面板概览	4
1.4 前面板按键介绍	6
1.5 后面板概览	8
1.6 主界面概览	11
1.7 仪器尺寸	14
第二章 验货与安装.....	21
2.1 开箱与搬运	21
2.2 确认包装内容	22
2.3 连接电源线	22
2.4 连接测试线（选件）	24
第三章 入门操作.....	28
3.1 开启设备	28
3.2 触摸屏介绍	29
3.3 设置参数	29
3.4 使用 On/Off 按键	29
第四章 电源功能.....	31
4.1 使用输出功能	31
4.1.1 设置输出模式	31
4.1.2 设置输出优先模式	32
4.1.3 设置输出斜率	33
4.1.4 设置电源内阻	34
4.1.5 设置输出 On/Off 延迟	34
4.1.6 启用输出	35
4.2 保护功能	35
4.2.1 过电压保护	35
4.2.2 过电流保护	36
4.2.3 过功率保护	36
4.2.4 欠电压保护	37
4.2.5 欠电流保护	37
4.2.6 限定电压值/电流值/功率值范围	38
4.2.7 过温度保护	38
4.3 LIST 功能	38
4.3.1 ARB 功能	42
4.4 电池充电测试	45
第五章 系统功能.....	47
5.1 系统菜单概览	47
5.2 配置菜单概览	50
5.3 键盘锁功能	51

5.4 切换本地/远程操作	51
5.5 存取操作	51
5.6 截屏功能	52
5.7 系统日志查询功能	53
5.8 多机操作	53
5.8.1 串联操作(单台)	53
5.8.2 并联操作(单台)	54
5.8.3 并联操作(多台)	55
5.8.4 并联操作(1 主多从)	59
5.8.5 并联操作(机柜机型)	62
5.9 数字 I/O 功能	66
5.9.1 数字 I/O 引脚定义	66
5.9.2 I/O 控制	69
5.10 外部模拟量测试功能（选配）	71
5.11 冗余功能	75
第六章 测量功能	77
6.1 常规 Meter 模式	77
6.2 示波模式	77
6.3 数据记录功能	80
第七章 技术规格	83
7.1 补充特性	83
7.2 主要技术参数	83
7.2.1 1200V	83
7.2.1 1600V	85
7.2.3 2250V	87
第八章 远程操作	89
8.1 USB 接口	89
8.2 LAN 接口	89
8.2.1 使用 Web 服务器	90
8.2.2 使用 Telnet	91
8.2.3 使用套接字	91
8.2.4 使用 VNC 传屏	92
8.3 CAN 接口	94
8.4 GPIB 接口（选配）	95
8.5 RS232 接口（选配）	95
8.6 EtherCAT 接口（选配）	96
附录 98	
红黑测试线规格	98

第一章 快速参考

本章简要介绍本系列仪器的前面板、后面板、键盘按键功能以及前面板显示功能，以确保在操作仪器前，快速了解仪器的外观、结构和按键使用功能，本章并不详细介绍每个操作特性，它只是一份快速参考指南，帮助您快速熟悉仪器的操作特性。

1.1 产品概览

IT6600D 系列引领了新一代图形化的可编程直流电源，通过整合触摸屏设计和直观的图形操作界面，不仅简化了参数设置和波形编辑过程，而且显著提高了用户操作的便捷性。采用了先进的第三代 SiC 技术。仅 3U 的机框内实现了双通道各 21kW 的高功率密度设计，独立的两个通道通过串联&并联，输出更可高达 42kW，一台设备就能竞品 3~5 台的输出范围，满足多种高电压和大电流应用需求，提高了测试和开发的灵活性与效率。

IT6600D 系列具有 CC（恒流）/CV（恒压）优先权的特性允许用户根据被测物的特定需求来选择输出模式，这种灵活性在进行精密测量时尤其重要。配合高精高速的产品特性以及多种标准通讯接口，简化和加快了测试开发，广泛适用于在实验室、生产线和自动测试系统用满足多元的测试应用。

系统特性

- 高功率密度，3U 内最大可达 42kW
- 3U 内实现完全独立的双通道设计，通道之间可串、并联
- 主从均流，并机可达 10MW
- 5 寸触摸屏，图形化的操作界面
- 数据记录功能，详细观测趋势走向
- 示波功能，无需示波器就可以进行瞬时分析和保存
- CC/CV 优先权设置功能
- List 功能，千万点的动态工况曲线模拟
- 冗余功能，可以观测各单机或者机柜运行情况，保证整体平滑输出
- 标配通讯接口: USB/LAN/CAN/数字 IO
- 选配通讯接口: GPIB/EtherCAT/Analog&RS232

1.2 选型表和选配件

选型表

- 1 主从系列

型号	双通道输出规格	并联输出规格	串联输出规格	高度
IT6642D-1200-200	600V/100A/21kW*2ch	600V/200A/42kW*1ch	1200V/100A/42kW*1ch	3U
IT6684D-1200-400	600V/200A/42kW*2ch	600V/400A/84kW*1ch	1200V/200A/84kW*1ch	15U
IT66126D-1200-600	600V/300A/63kW*2ch	600V/600A/126kW*1ch	1200V/300A/126kW*1ch	15U

型号	双通道输出规格	并联输出规格	串联输出规格	高度
IT66168D-1200-800	600V/400A/84kW*2ch	600V/800A/168kW*1ch	1200V/400A/168kW*1ch	27U
IT66210D-1200-1000	600V/500A/105kW*2ch	600V/1000A/210kW*1ch	1200V/500A/210kW*1ch	27U
IT66252D-1200-1200	600V/600A/126kW*2ch	600V/1200A/252kW*1ch	1200V/600A/252kW*1ch	27U
IT66294D-1200-1400	600V/700A/147kW*2ch	600V/1400A/294kW*1ch	1200V/700A/294kW*1ch	27U
IT66336D-1200-1600	600V/800A/168kW*2ch	600V/1600A/336kW*1ch	1200V/800A/336kW*1ch	37U
IT66378D-1200-1800	600V/900A/189kW*2ch	600V/1800A/378kW*1ch	1200V/900A/378kW*1ch	37U
IT66420D-1200-2000	600V/1000A/210kW*2ch	600V/2000A/420kW*1ch	1200V/1000A/420kW*1ch	37U

型号	双通道输出规格	并联输出规格	串联输出规格	高度
IT6642D-1600-140	800V/70A/21kW*2ch	800V/140A/42kW*1ch	1600V/70A/42kW*1ch	3U
IT6684D-1600-280	800V/140A/42kW*2ch	800V/280A/84kW*1ch	1600V/140A/84kW*1ch	15U
IT66126D-1600-420	800V/210A/63kW*2ch	800V/420A/126kW*1ch	1600V/210A/126kW*1ch	15U
IT66168D-1600-560	800V/280A/84kW*2ch	800V/560A/168kW*1ch	1600V/280A/168kW*1ch	27U
IT66210D-1600-700	800V/350A/105kW*2ch	800V/700A/210kW*1ch	1600V/350A/210kW*1ch	27U
IT66252D-1600-840	800V/420A/126kW*2ch	800V/840A/252kW*1ch	1600V/420A/252kW*1ch	27U
IT66294D-1600-980	800V/490A/147kW*2ch	800V/980A/294kW*1ch	1600V/490A/294kW*1ch	27U
IT66336D-1600-1120	800V/560A/168kW*2ch	800V/1120A/336kW*1ch	1600V/560A/336kW*1ch	37U
IT66378D-1600-1260	800V/630A/189kW*2ch	800V/1260A/378kW*1ch	1600V/630A/378kW*1ch	37U
IT66420D-1600-1400	800V/700A/210kW*2ch	800V/1400A/420kW*1ch	1600V/700A/420kW*1ch	37U

型号	双通道输出规格	并联输出规格	串联输出规格	高度
IT6642D-2250-100	1200V/50A/21kW*2ch	1200V/100A/42kW*1ch	2250V/50A/42kW*1ch	3U
IT6684D-2250-200	1200V/100A/42kW*2ch	1200V/200A/84kW*1ch	2250V/100A/84kW*1ch	15U
IT66126D-2250-300	1200V/150A/63kW*2ch	1200V/300A/126kW*1ch	2250V/150A/126kW*1ch	15U
IT66168D-2250-400	1200V/200A/84kW*2ch	1200V/400A/168kW*1ch	2250V/200A/168kW*1ch	27U
IT66210D-2250-500	1200V/250A/105kW*2ch	1200V/500A/210kW*1ch	2250V/250A/210kW*1ch	27U
IT66252D-2250-600	1200V/300A/126kW*2ch	1200V/600A/252kW*1ch	2250V/300A/252kW*1ch	27U
IT66294D-2250-700	1200V/350A/147kW*2ch	1200V/700A/294kW*1ch	2250V/350A/294kW*1ch	27U
IT66336D-2250-800	1200V/400A/168kW*2ch	1200V/800A/336kW*1ch	2250V/400A/336kW*1ch	37U
IT66378D-2250-900	1200V/450A/189kW*2ch	1200V/900A/378kW*1ch	2250V/450A/378kW*1ch	37U
IT66420D-2250-1000	1200V/500A/210kW*2ch	1200V/1000A/420kW*1ch	2250V/500A/420kW*1ch	37U

● 多主系列

型号	双通道输出规格	并联输出规格	串联输出规格	高度
IT6684DM-1200-400	600V/200A/42kW*2ch	600V/400A/84kW*1ch	1200V/200A/84kW*1ch	15U
IT66126DM-1200-600	600V/300A/63kW*2ch	600V/600A/126kW*1ch	1200V/300A/126kW*1ch	15U
IT66168DM-1200-800	600V/400A/84kW*2ch	600V/800A/168kW*1ch	1200V/400A/168kW*1ch	27U

型号	双通道输出规格	并联输出规格	串联输出规格	高度
IT66210DM-1200-1000	600V/500A/105kW*2ch	600V/1000A/210kW*1ch	1200V/500A/210kW*1ch	27U
IT66252DM-1200-1200	600V/600A/126kW*2ch	600V/1200A/252kW*1ch	1200V/600A/252kW*1ch	27U
IT66294DM-1200-1400	600V/700A/147kW*2ch	600V/1400A/294kW*1ch	1200V/700A/294kW*1ch	37U
IT66336DM-1200-1600	600V/800A/168kW*2ch	600V/1600A/336kW*1ch	1200V/800A/336kW*1ch	37U
IT66378DM-1200-1800	600V/900A/189kW*2ch	600V/1800A/378kW*1ch	1200V/900A/378kW*1ch	37U

型号	双通道输出规格	并联输出规格	串联输出规格	高度
IT6684DM-1600-280	800V/140A/42kW*2ch	800V/280A/84kW*1ch	1600V/140A/84kW*1ch	15U
IT66126DM-1600-420	800V/210A/63kW*2ch	800V/420A/126kW*1ch	1600V/210A/126kW*1ch	15U
IT66168DM-1600-560	800V/280A/84kW*2ch	800V/560A/168kW*1ch	1600V/280A/168kW*1ch	27U
IT66210DM-1600-700	800V/350A/105kW*2ch	800V/700A/210kW*1ch	1600V/350A/210kW*1ch	27U
IT66252DM-1600-840	800V/420A/126kW*2ch	800V/840A/252kW*1ch	1600V/420A/252kW*1ch	27U
IT66294DM-1600-980	800V/490A/147kW*2ch	800V/980A/294kW*1ch	1600V/490A/294kW*1ch	37U
IT66336DM-1600-1120	800V/560A/168kW*2ch	800V/1120A/336kW*1ch	1600V/560A/336kW*1ch	37U
IT66378DM-1600-1260	800V/630A/189kW*2ch	800V/1260A/378kW*1ch	1600V/630A/378kW*1ch	37U

型号	双通道输出规格	并联输出规格	串联输出规格	高度
IT6684DM-2250-200	1200V/100A/42kW*2ch	1200V/200A/84kW*1ch	2250V/100A/84kW*1ch	15U
IT66126DM-2250-300	1200V/150A/63kW*2ch	1200V/300A/126kW*1ch	2250V/150A/126kW*1ch	15U
IT66168DM-2250-400	1200V/200A/84kW*2ch	1200V/400A/168kW*1ch	2250V/200A/168kW*1ch	27U
IT66210DM-2250-500	1200V/250A/105kW*2ch	1200V/500A/210kW*1ch	2250V/250A/210kW*1ch	27U
IT66252DM-2250-600	1200V/300A/126kW*2ch	1200V/600A/252kW*1ch	2250V/300A/252kW*1ch	27U
IT66294DM-2250-700	1200V/350A/147kW*2ch	1200V/700A/294kW*1ch	2250V/350A/294kW*1ch	37U
IT66336DM-2250-800	1200V/400A/168kW*2ch	1200V/800A/336kW*1ch	2250V/400A/336kW*1ch	37U
IT66378DM-2250-900	1200V/450A/189kW*2ch	1200V/900A/378kW*1ch	2250V/450A/378kW*1ch	37U

可选配件

本公司提供的如下可选配件是单独销售的附件，需要用户根据需要单独购买。


设备名	型号	说明
GPIB 接口卡	IT-E176	当用户需要使用 GPIB 通讯方式时，可选择购买此配件。
RS232+Analog	IT-E177	包含了 RS232 通讯接口、外部模拟量功能的接口卡。当用户需要使用 RS232 通讯方式或模拟量接口时，可选择购买此配件。
EtherCAT	IT-E1601-black	-

设备名	型号	说明
光纤模块及光纤线缆	IT-E168	用于机柜内的并联，包含一个光模块和两根长度分别为1.5米和0.3米的光纤线缆。光模块和光纤线缆为并机专属的配件，不同并机数量所需的模块、线束的数量不同。
光纤模块及光纤线缆	IT-E169	用于机柜之间的并联，包含一个光模块和一根2.5m长的光纤线缆。光模块和光纤线缆为并机专属的配件，不同并机数量所需的模块、线束的数量不同。
继电器板卡	IT-E179	-
串并联盒子	IT-E183	机柜配置，直接切换串并联。

1.3 前面板概览

● 1 主多从系列


本系列仪器 3U 的机型前面板相同，其他型号的机型前面板与 3U 机型的前面板一致，以下示意图是 3U 机型的前面板示意图和按键功能图。

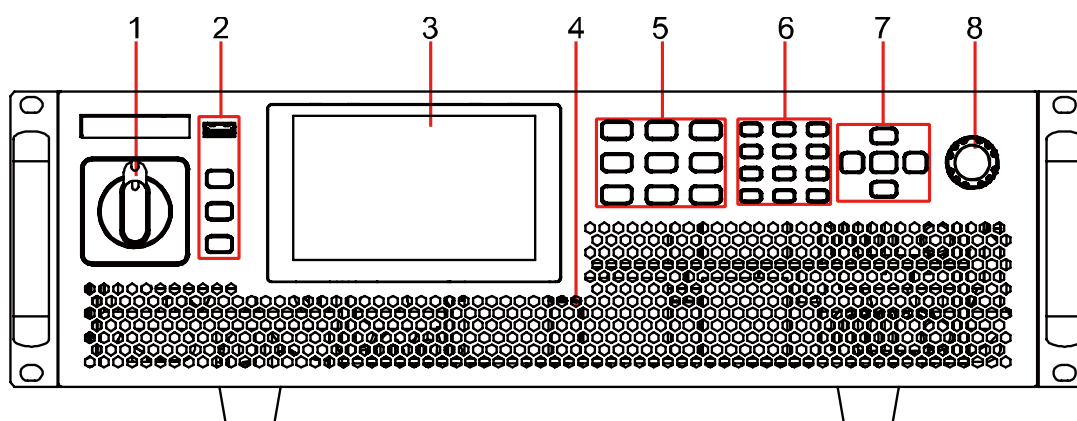


- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1 电源开关 | 2 USB 接口及 Print/View/Menu 键 |
| 3 LCD 触摸显示屏 | 4 散热孔 |
| 5 功能键 | 6 数字键 |
| 7 上、下、左、右光标移动按键和 Enter 键 | 8 可按压脉动旋钮 |

● 多主系列

本系列仪器的前面板按键相同，不同的是输出功率或机柜尺寸，以下是 27U 机型的前面板示意图和按键功能图。

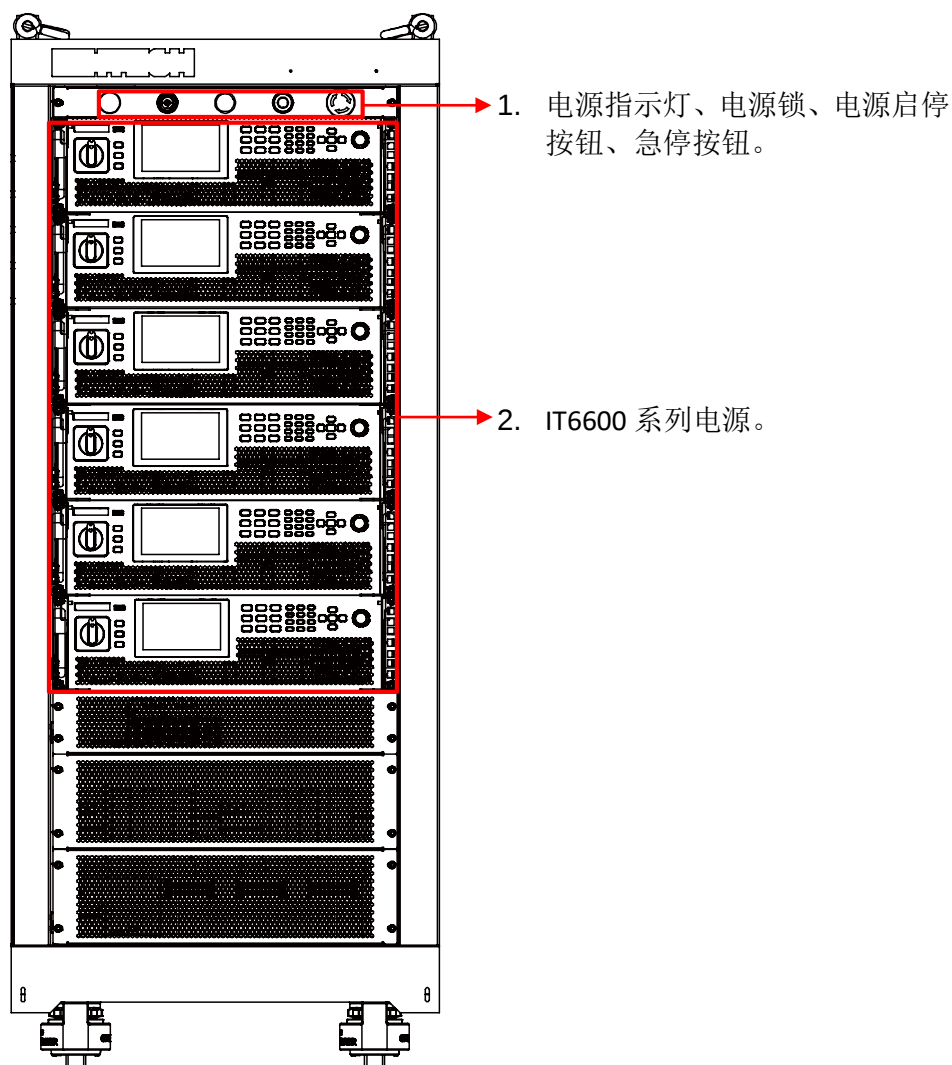


1. 电源指示灯、电源锁、电源启停按钮、急停按钮。

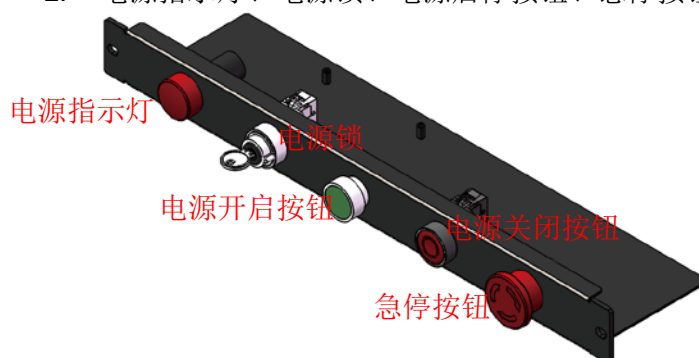

详细功能介绍如下：

- 电源指示灯，电源开启按钮按下后，电源指示灯亮起。
- 电源锁开启之后，按下绿色的电源开启按钮，机柜上电；电源锁关闭，绿色的电源开启按钮失能，机柜无法上电。
- 电源开启按钮为绿色按钮，按下电源开启按钮，机柜上电。
- 电源关闭按钮为红色按钮，按下电源关闭按钮，机柜下电。
- 急停按钮为转动复位按钮，按下急停按钮，机柜中的全部设备断电；旋转复位后，机柜上电。


2. IT6600 系列电源。

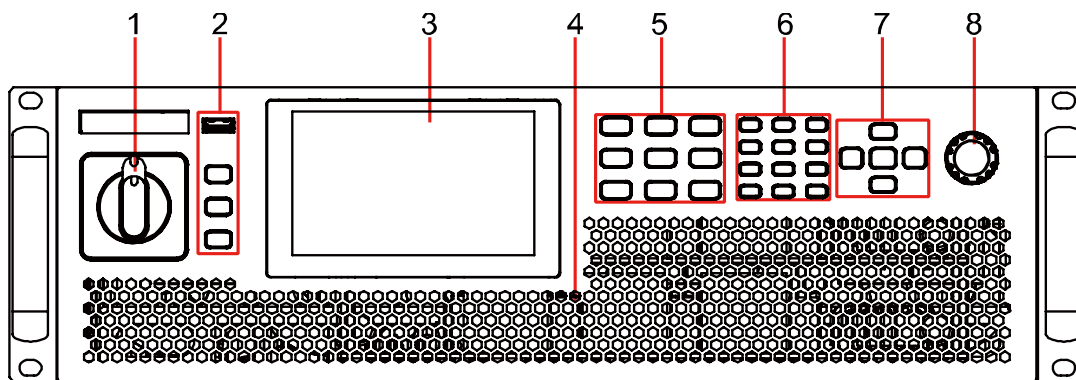

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1 电源开关 | 2 USB 接口及 Print/View/Menu 键 |
| 3 LCD 触摸显示屏 | 4 散热孔 |
| 5 功能键 | 6 数字键 |
| 7 上、下、左、右光标移动按键和 Enter 键 | 8 可按压脉动旋钮 |

1.4 前面板按键介绍

本系列的前面板按键区的按键如下图所示。

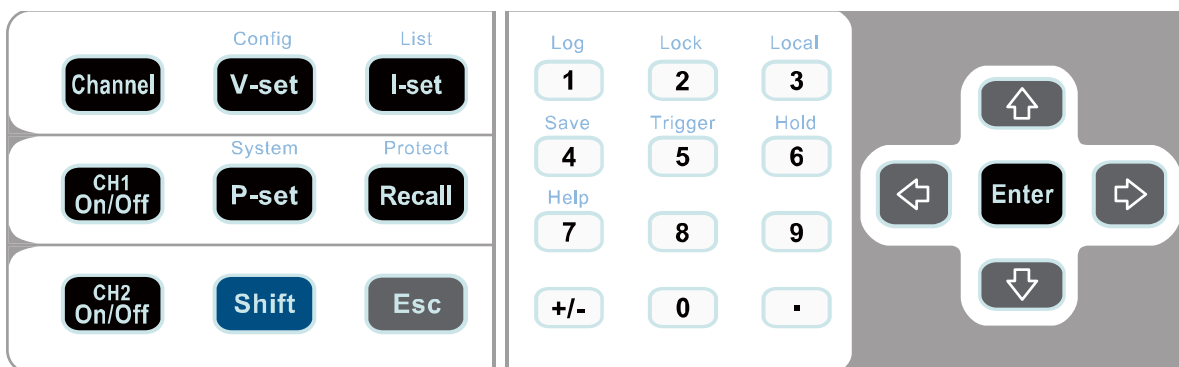

按键说明如下表：

按键标识	名称及功能
Power	电源开关。
Print	屏幕图像保存键。
View	界面显示切换键。 - 在 Normal 工作模式下，使用该按键可以在基本测量界面、示波界面和记录仪界面之间进行切换。 - 在非 Normal 工作模式下，使用该按键可以在功能界面、示波界面和记录仪界面之间进行切换。
Menu	用于返回菜单页面。
[Channel]	通道切换键。
[V-set]	电压设定键，设置电源输出电压值。
[I-set]	电流设定键，设置电源输出电流值。
[P-set]	功率设定键，设置电源输出功率值。
[Recall]	回调键，调取一个已存储的系统参数设定值。
[Shift]	复合功能键，与其他按键组合，实现位于按键上方的印字所标识的功能。
[Esc]	退出键。按下此按键，表示退出当前的操作界面。
CH1	通道 1 输出的打开/关闭键。

按键标识	名称及功能
On/Off	
CH2	通道 2 输出的打开/关闭键。
On/Off	
[0]-[9]	数字按键
+/-	正负号
.	小数点
上下方向键	上下移动导航键，用于上下翻页显示菜单项或设置项。
左右方向键	左右移动导航键，用于调整光标到指定位置或左右翻页显示设置项。
[Enter]	确认键。
可按压旋钮	脉动旋钮，用来设定参数和按压确认。

复合功能键**[Shift]**，与其他按键组合，可实现按键上方标注的功能。先按**[Shift]**键，shift 按键点亮，再按其他按键。详细介绍如下所示。

按键标识	名称及功能
[Shift]+[V-set] (Config)	进入 配置 菜单。
[Shift]+[I-set] (List)	进入 List 功能菜单。
[Shift]+[P-set] (System)	进入仪器系统功能菜单。
[Shift]+[Recall](Protect)	保护 菜单功能键。
[Shift]+[1](Log)	日志查询键。
[Shift]+ [2] (Lock)	键盘锁功能键，用来锁定和解锁面板按键。
[Shift]+[3] (Local)	切换至本地操作模式。
[Shift]+[4] (Save)	存储键，存储系统参数设定值。
[Shift]+ [5] (Trigger)	手动触发键。
[Shift]+ [6] (Hold)	按下此键，当前测量参数保持。
[Shift]+ [7] (Help)	获取帮助信息。

旋钮介绍

本系列电源前面板提供一个可按压旋钮，如下所示。



功能介绍如下：

- 调整数值设定
- 选择菜单项
- 确认设定的值或选择的菜单项

调整数值设定

在数值设定的界面中，顺时针转动旋钮将数值递增，逆时针转动旋钮将数值递减。

选择菜单项


旋钮还可以用来查看菜单项。在菜单项显示界面中，顺时针转动旋钮表示选中下一个菜单项，逆时针转动旋钮表示选中上一个菜单项。

确认设置

在完成数值设定或者选中某个菜单项之后，按压旋钮，即可确认所执行的操作，效果等同于按下[Enter]按键。

1.5 后面板概览


- 1 主多从系列
本系列仪器(3U)后面板示意图如下。

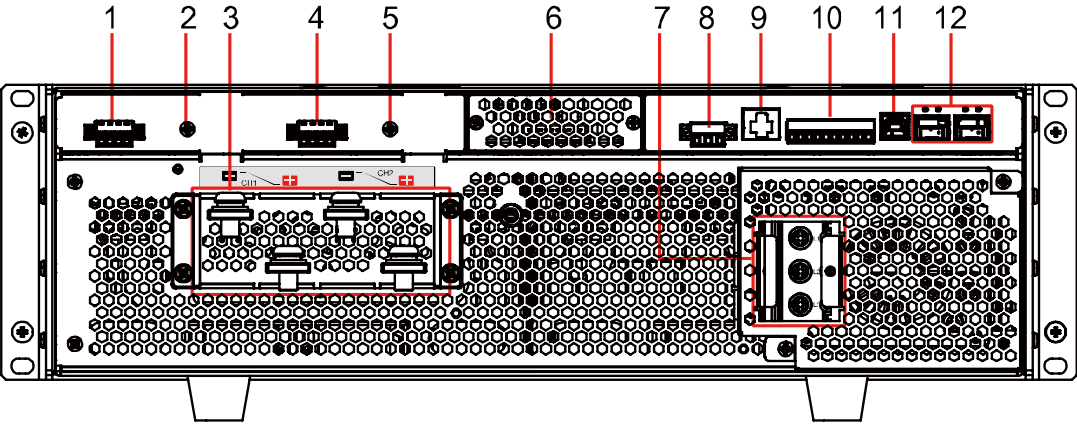

序号	名称	功能说明
1	远端量测端子 (CH1)	VS1-(左1)和VS1+(左4)是远端感测端子，用于测量精度较高的测试场景。
2/5	接地螺丝	机箱接地连接端子，用于机箱自身接地。
3	直流输出接口	用于连接待测物。
4	远端量测端子 (CH2)	VS2-(左1)和VS2+(左4)是远端感测端子，用于测量精度较高的测试场景。
6	选配件扩展槽	选配接口扩展槽，无选配接口时默认插入塑料堵件。可选配接口如下： ● GPIB ● RS232/外部模拟量接口 ● EtherCAT ● 继电器板卡
7	交流电输入端子	用于连接交流电输入启动仪器。
8	外部控制接口 CTRL	用于主机（有操作面板）和从机（无操作面板）并联的场景，将需要并联的各单机后面板的该接口进行连接，可实现主机对从机上下电的同步控制。
9	LAN 通讯接口	使用 LAN 通讯方式与 PC 互连。
10	数字 I/O 功能接口及 CAN 通讯接口 P-IO	● 数字 I/O 功能 ● CAN 通讯接口 CAN-H 和 CAN-L

- | | | |
|----|---------------|--|
| 11 | USB 通讯接口 | 使用 USB 通讯方式与 PC 互连。 |
| 12 | System bus 接口 | 用于多台仪器之间通讯，适用于并联操作。 <ul style="list-style-type: none"> ● F-TX/F-RX：内环光纤通讯接口，主机（有操作面板）和从机（无操作面板）并联。 ● TX/RX：外环光纤通讯接口，主机（有操作面板）之间并联。 |


本系列仪器(15U)后面板示意图如下，27U 和 37U 的类似仅尺寸大小不同。

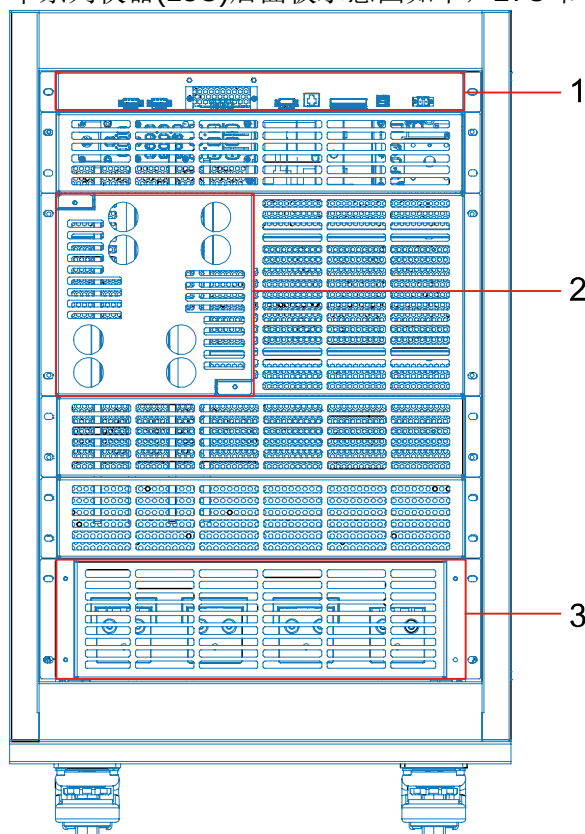

1. 机柜通讯接口，详细如下图所示，接口介绍请参考 3U 系列后背板。




2. 输出端子及保护罩。
3. 输入端子，连接仪器的供电电源。

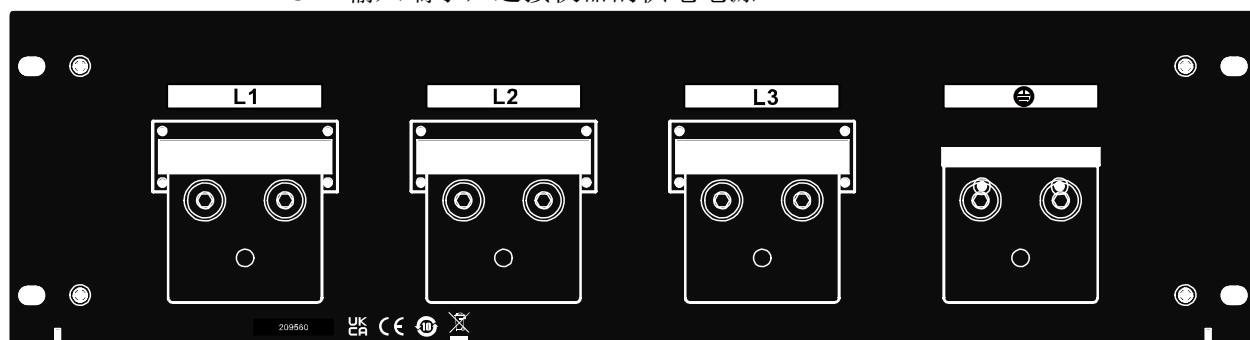


多主系列

本系列仪器除了尺寸不同之外，后面板端子完全相同，下面以 27U 机柜为例进行介绍。

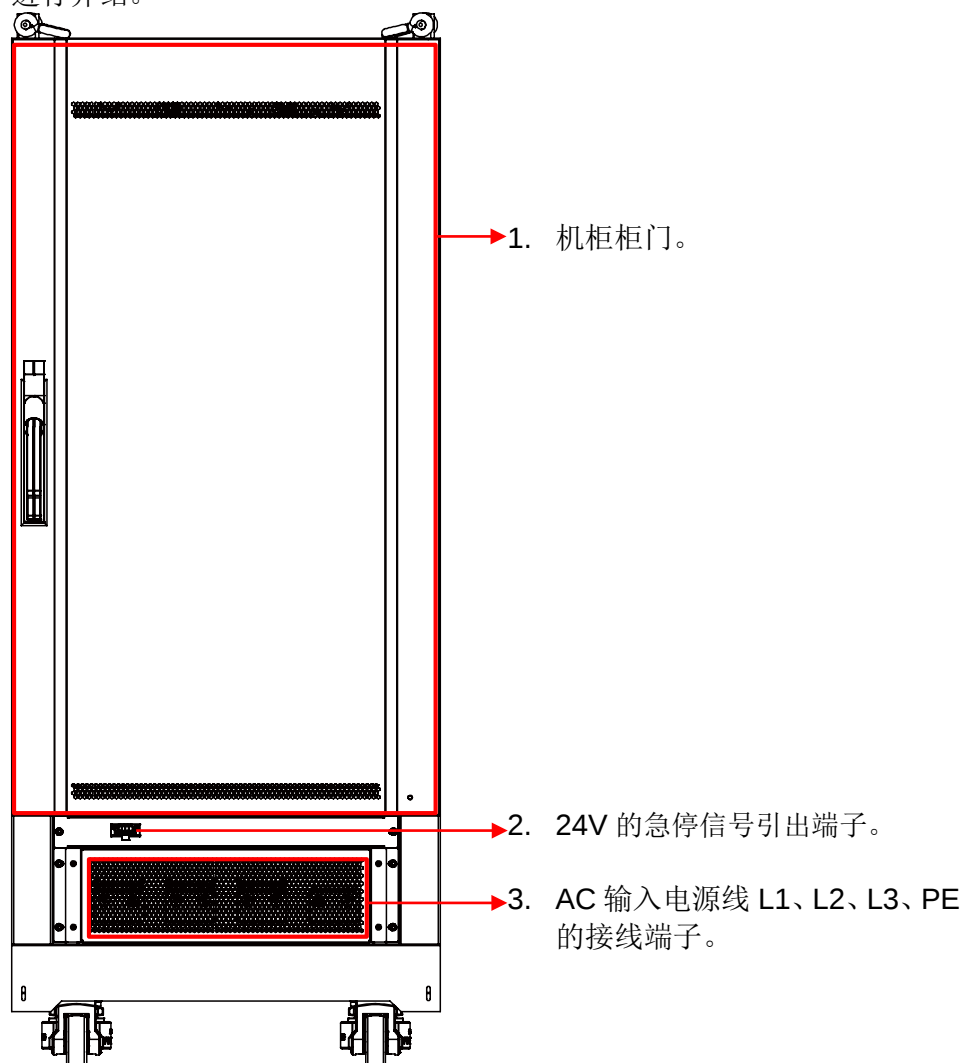


1. 机柜柜门。
 2. 24V 的急停信号引出端子。
- 机柜出厂时，端子 Pin2 和 Pin3 之间已短接，如下图所示。

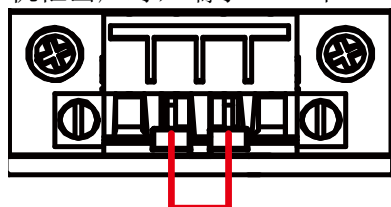

当通过机柜前面板的急停按钮控制机柜上下电时，请务必保持此处的短路夹正确安装。

当通过外部线路控制机柜的上下电急停装置，请参考如下步骤：

- a. 取下 Pin2 和 Pin3 之间的短路夹。
说明：引出 24V 电压信号。
- b. 参考下图连接到外部信号控制电路。

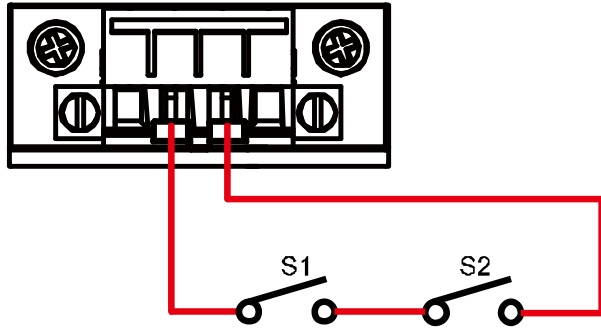


说明：S1 和 S2 处均闭合时，机柜上电；S1 或 S2 有一处断开，则触发急停，机柜下电。若需要机柜重新上电，请务必确保 S1 和 S2 处开关闭合。

3. AC 输入电源线 L1、L2、L3、PE 的接线端子。

1.6 主界面概览

本系列电源是可触摸控制显示屏，用户可直接在屏幕上按压或滑动进行选择 and 切换。主界面详细信息介绍如下。

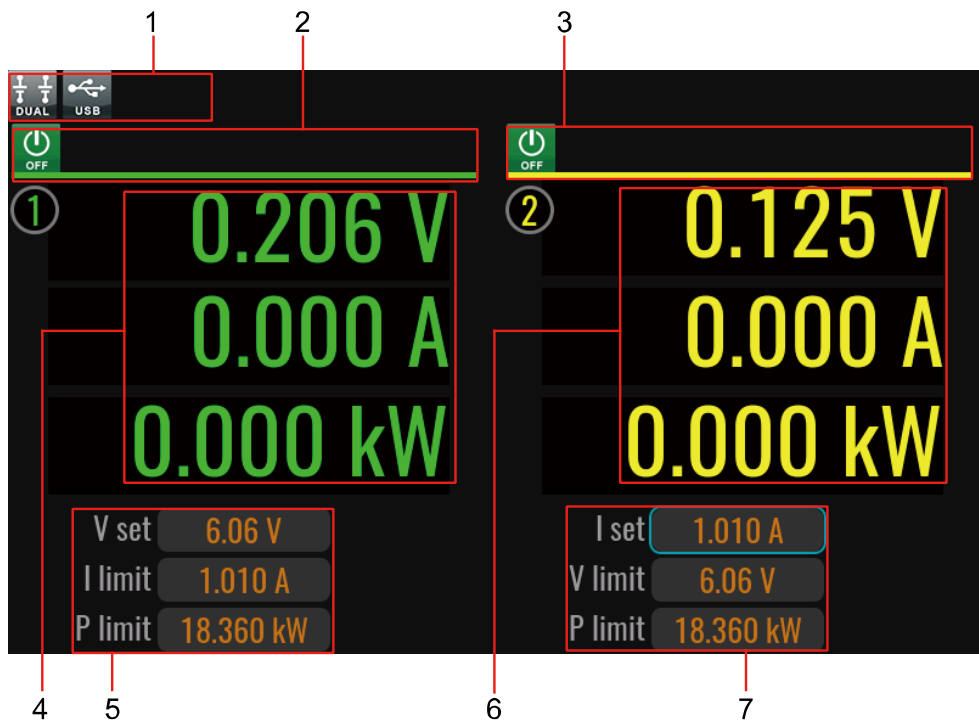

序号	名称	功能说明
1	电源状态栏	显示当前的电源输出状态。
2	CH1 状态栏	显示电源通道 1 的输出状态。
3	CH2 状态栏	显示电源通道 2 的输出状态。
4	CH1 输出值显示区	显示当前输出的电压值、电流值和功率值。
5	CH1 设置值显示区	● CV 优先时，显示电压设置值、电流上限值、功率上限值。 ● CC 优先时，显示电流设置值、电压上限值、功率上限值。

6	CH2 输出值显示区	显示当前输出的电压值、电流值和功率值。
7	CH2 设置值显示区	● CV优先时，显示电压设置值、电流上限值、功率上限值。 ● CC优先时，显示电流设置值、电压上限值、功率上限值。

界面显示符号介绍

本系列电源界面会显示如下符号标识。下表展示所有符号及符号描述。

符号	功能描述	符号	功能描述
	复合按键，搭配其他按键使用		输出关闭状态
	输出开启状态		键盘被锁定
	电源为恒电流输出的状态		电源为恒电压输出的状态
	电源为恒功率输出的状态		触摸功能关闭
	设备处于远程控制状态		Sense 测量状态
	2 通道独立输出模式		发现 USB 外围设备
	2 通道串联模式		2 通道并联模式
	LIST 正在运行状态		LIST 运行完成
	LIST 运行等待触发状态		BAT 正在运行状态
	BAT 运行完成		BAT 运行等待触发状态
	DLOG 正在运行状态		DLOG 运行完成
	DLOG 运行等待触发状态		ELOG 运行等待触发状态
	ELOG 正在运行状态		ELOG 运行完成
	SYNC 锁定		SYNC 未锁定
	光纤错误		禁止输出
	OCP 过流保护		OTP 过温保护
	OVP 过压保护		OPP 过功率保护
	Sense 发生保护		欠流保护

符号	功能描述	符号	功能描述
	欠压保护		指令错误
	提示图片折叠，点击可展开所有图标。		外部模拟量功能
	设备校准模式		数据记录功能

Menu 界面

按下[Menu]键，进入菜单设置界面。该界面包含所有功能选项图标，通过方向键或旋钮进行选择，也可以直接触摸点击图标，进入对应的功能设置页面。






1.7 仪器尺寸



本仪器需要安装在通风环境良好，尺寸合理的空间。请根据以下电源尺寸介绍选择合适的空间安装。

本系列电源详细尺寸如下图所示（单位：毫米）。


3U 机型

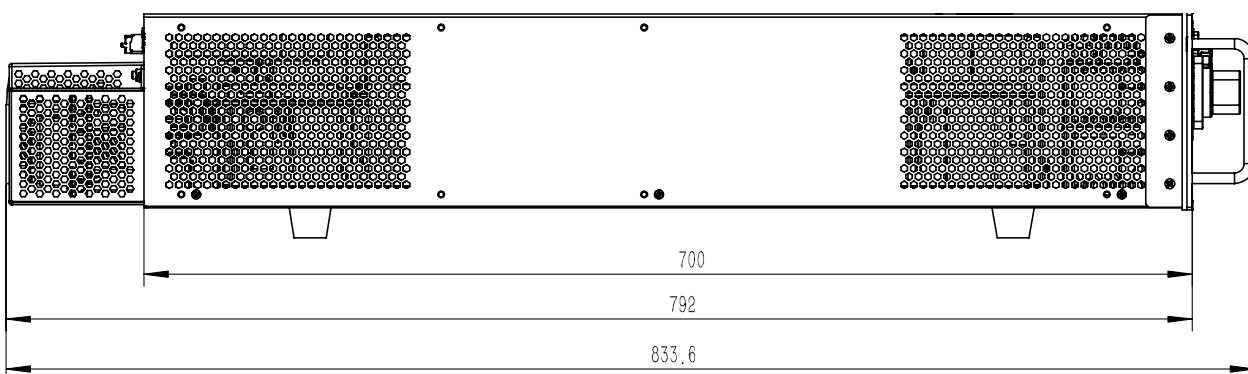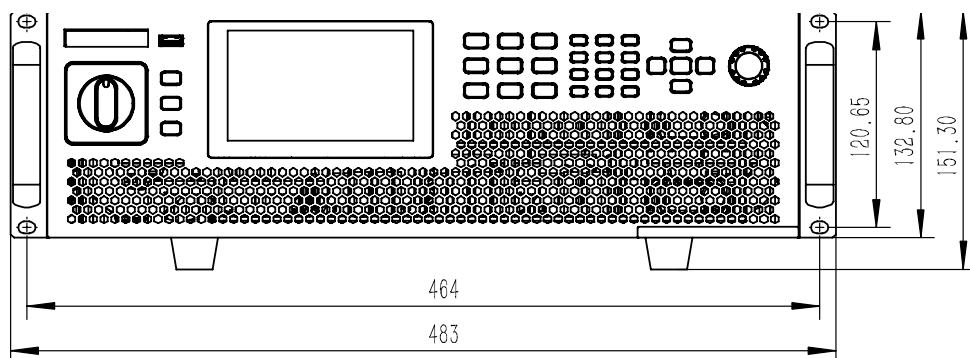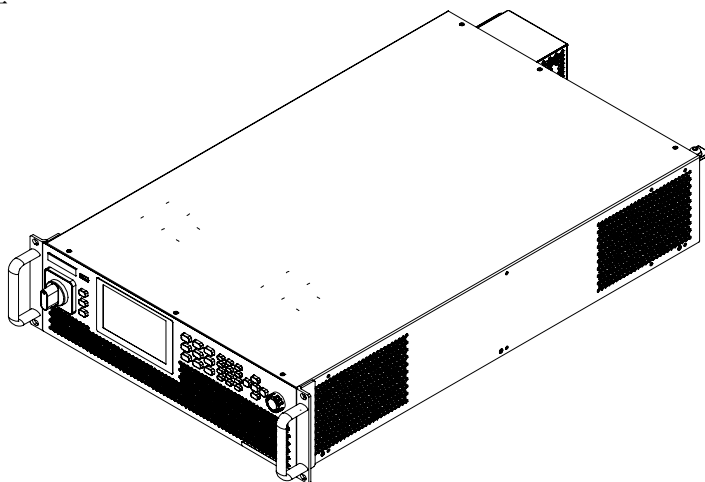


15U 机型(1 主多从系列)

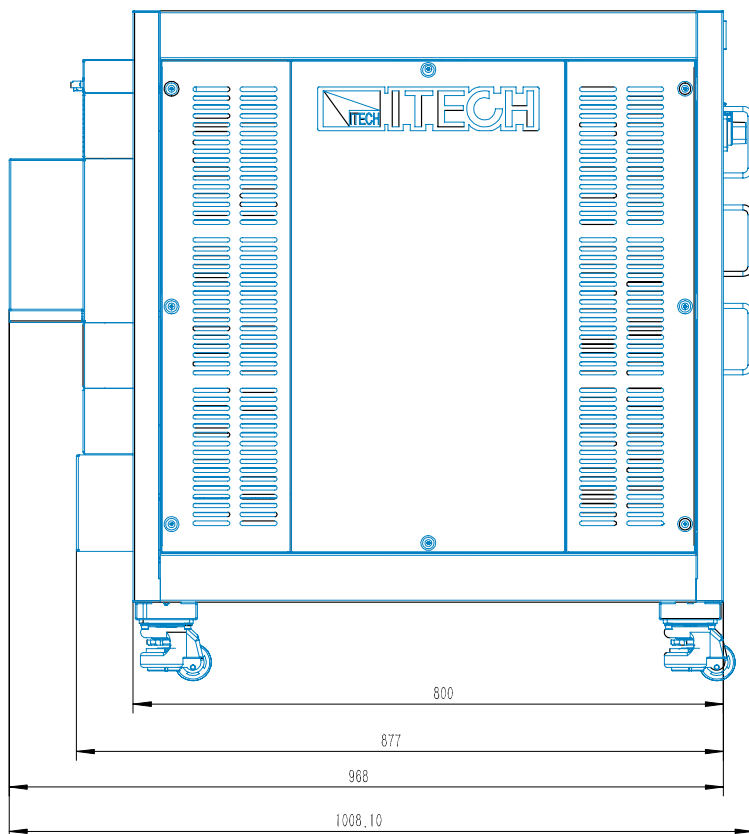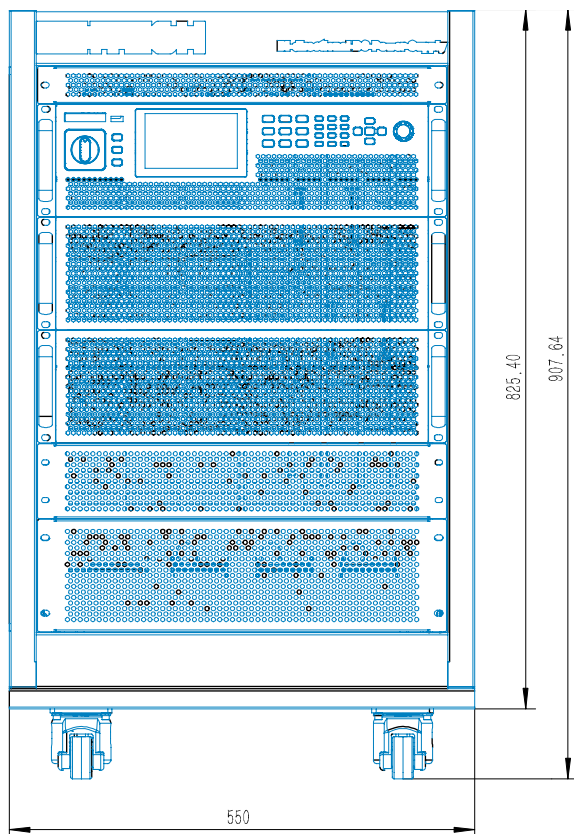



27U 机型(1 主多从系列)

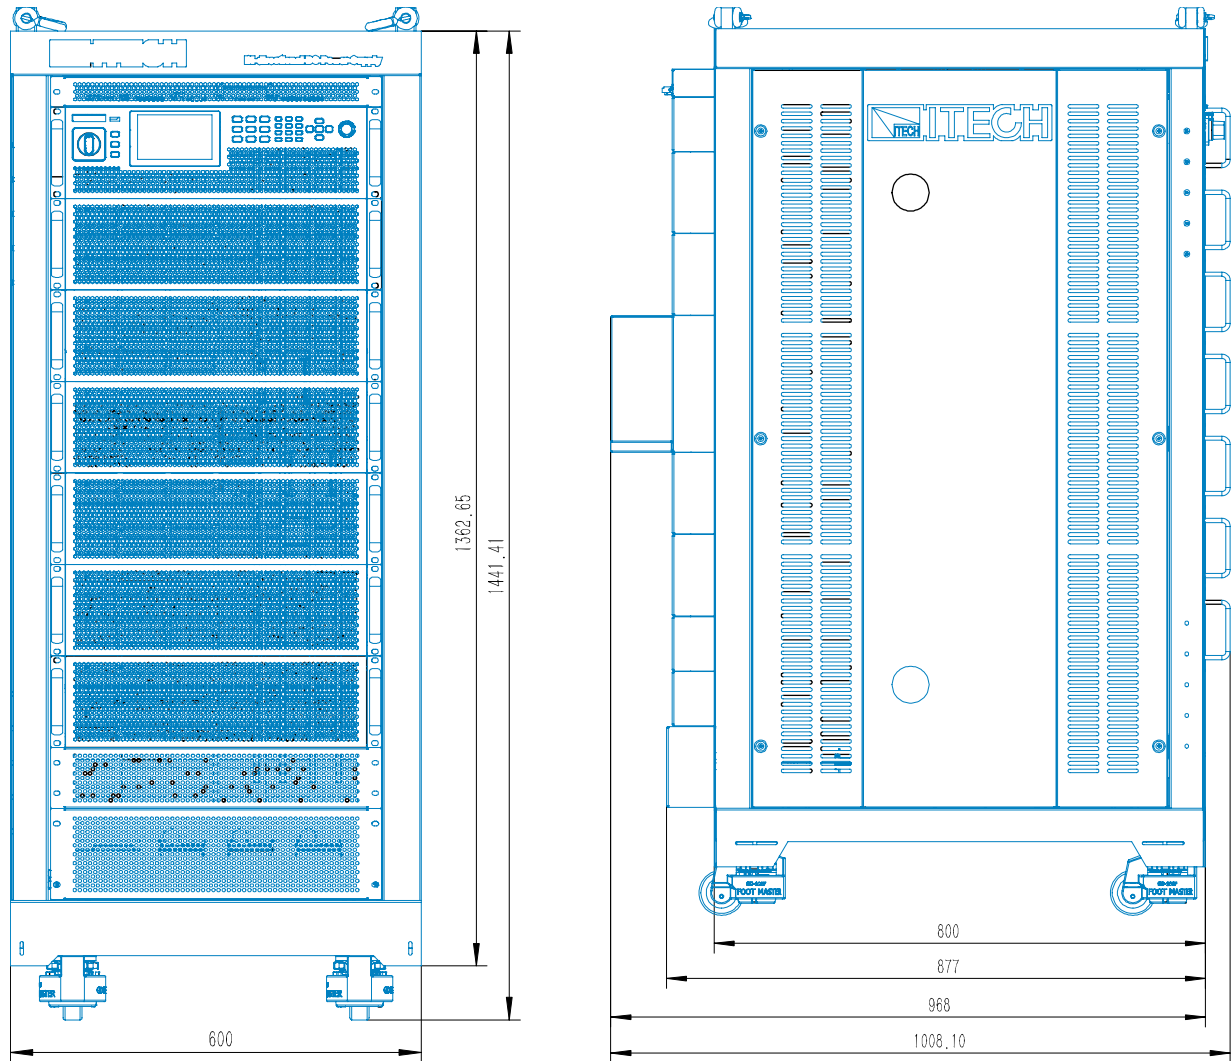


37U 机型(1 主多从系列)

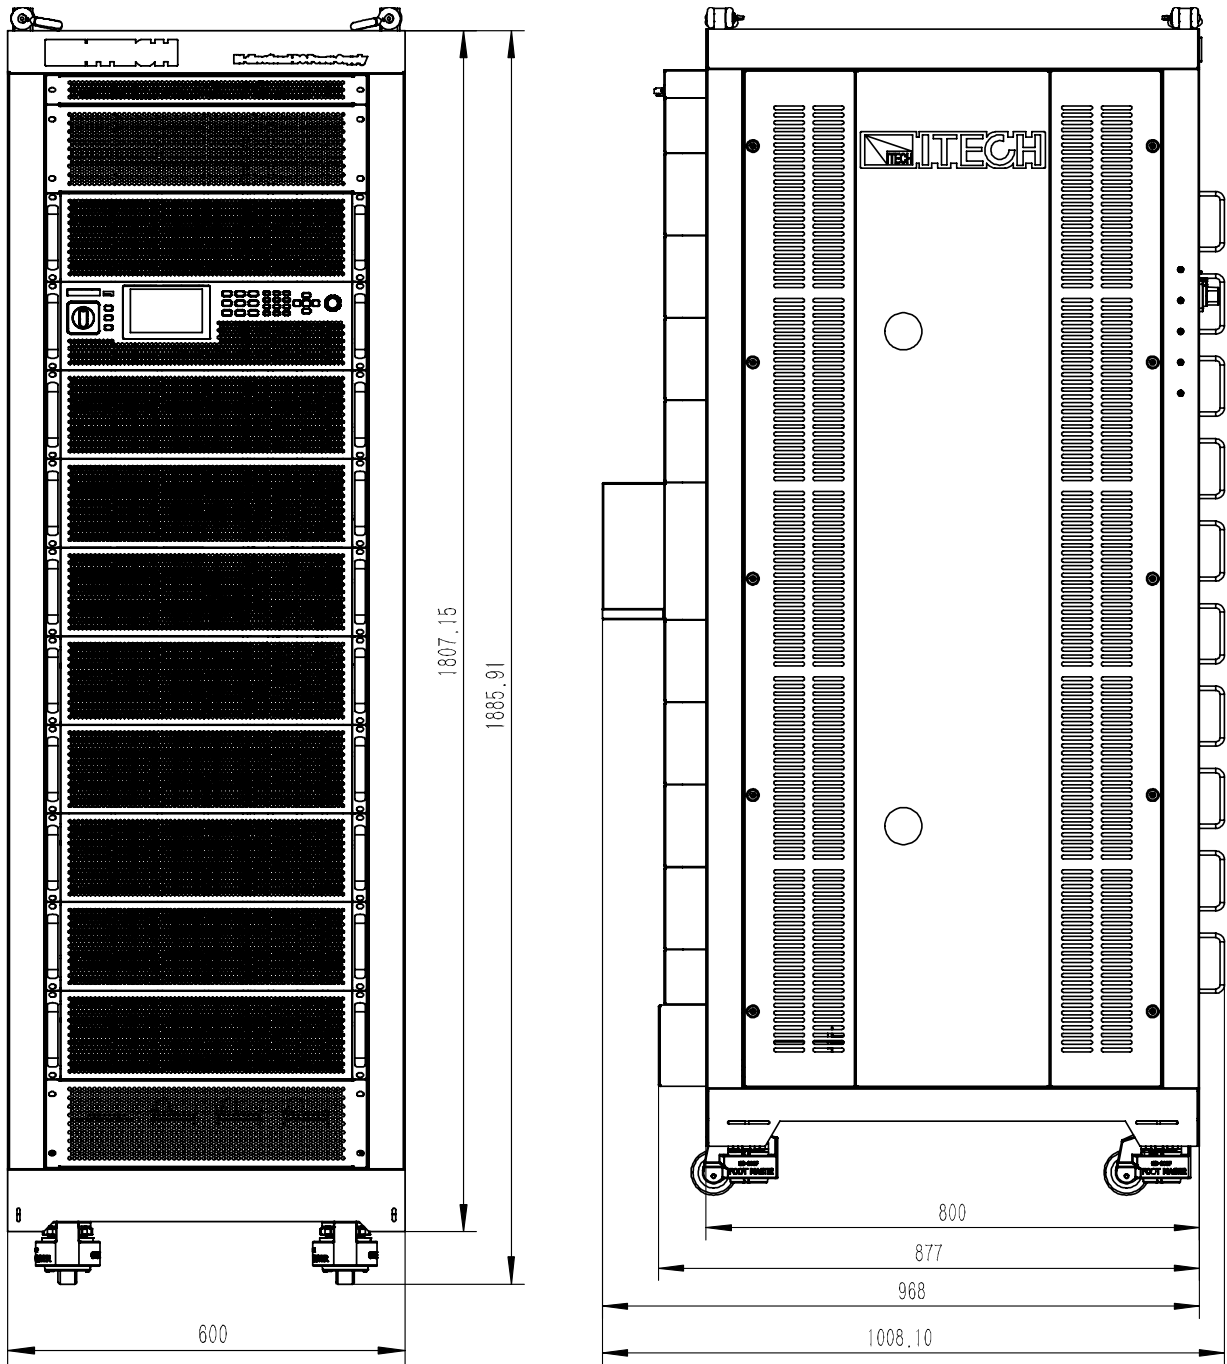


15U 机型(多主系列)

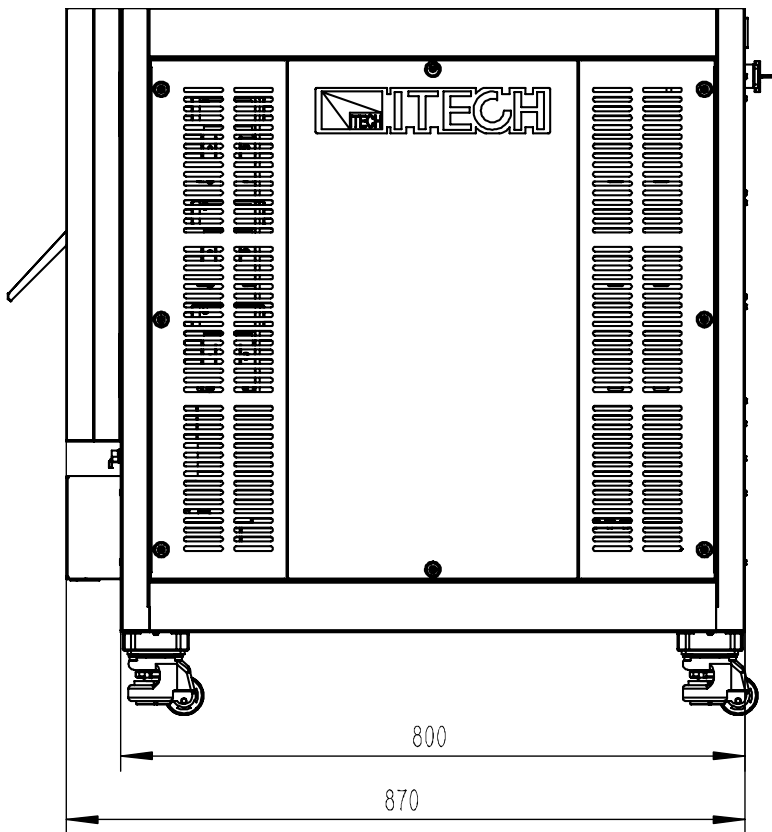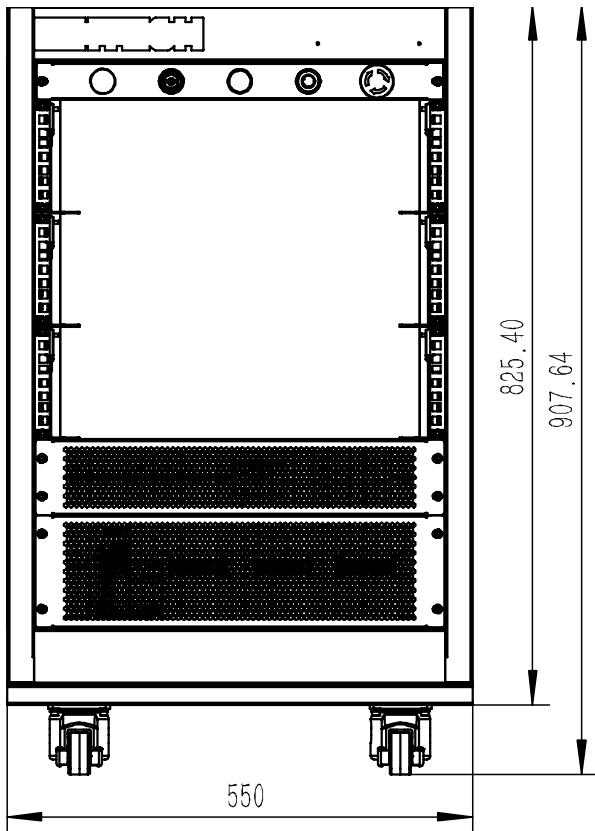

27U 机型(多主系列)

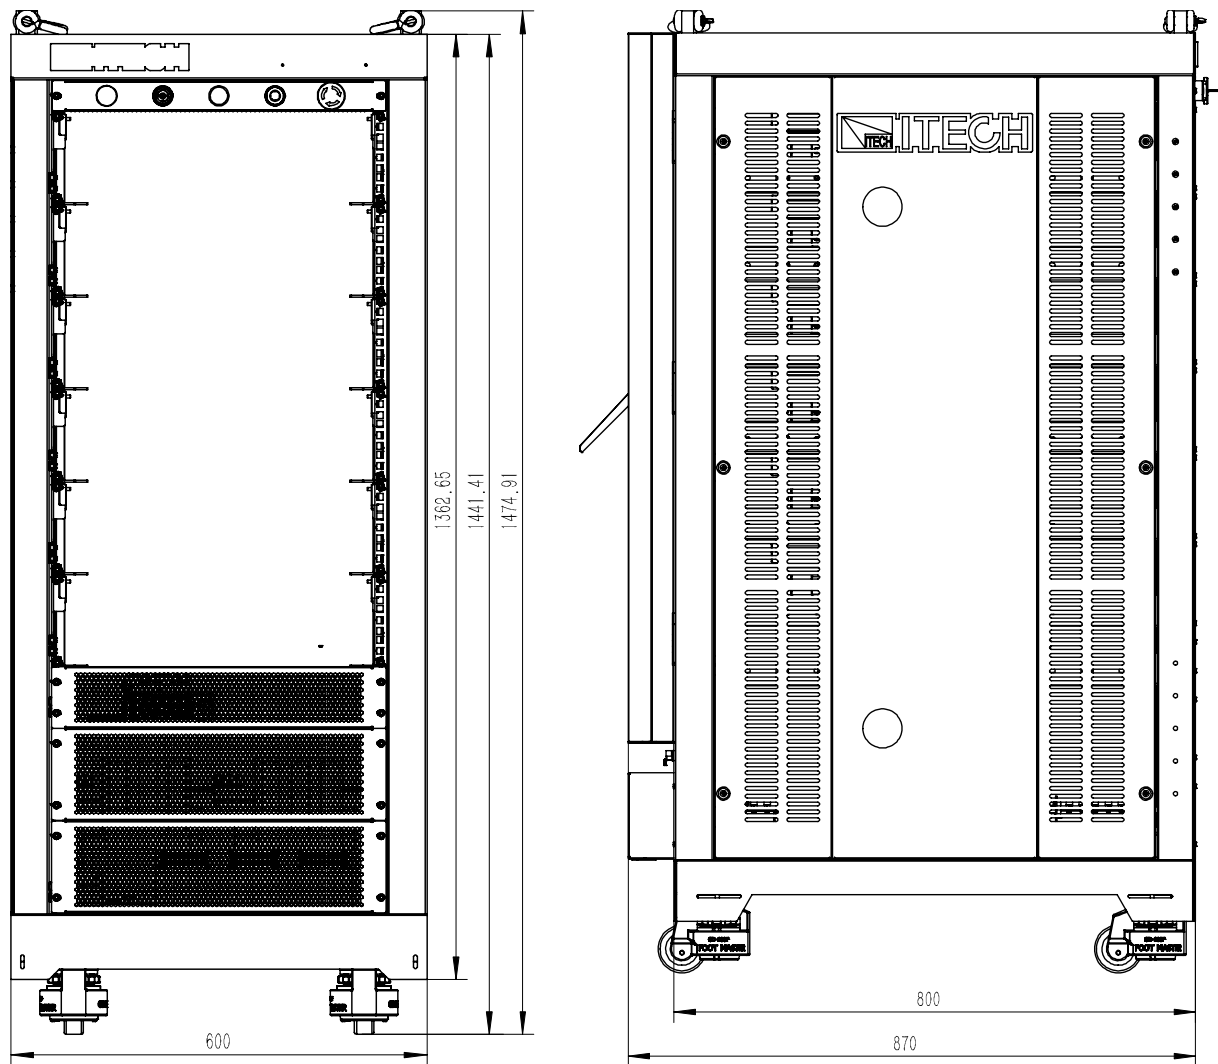

37U 机型(多主系列)

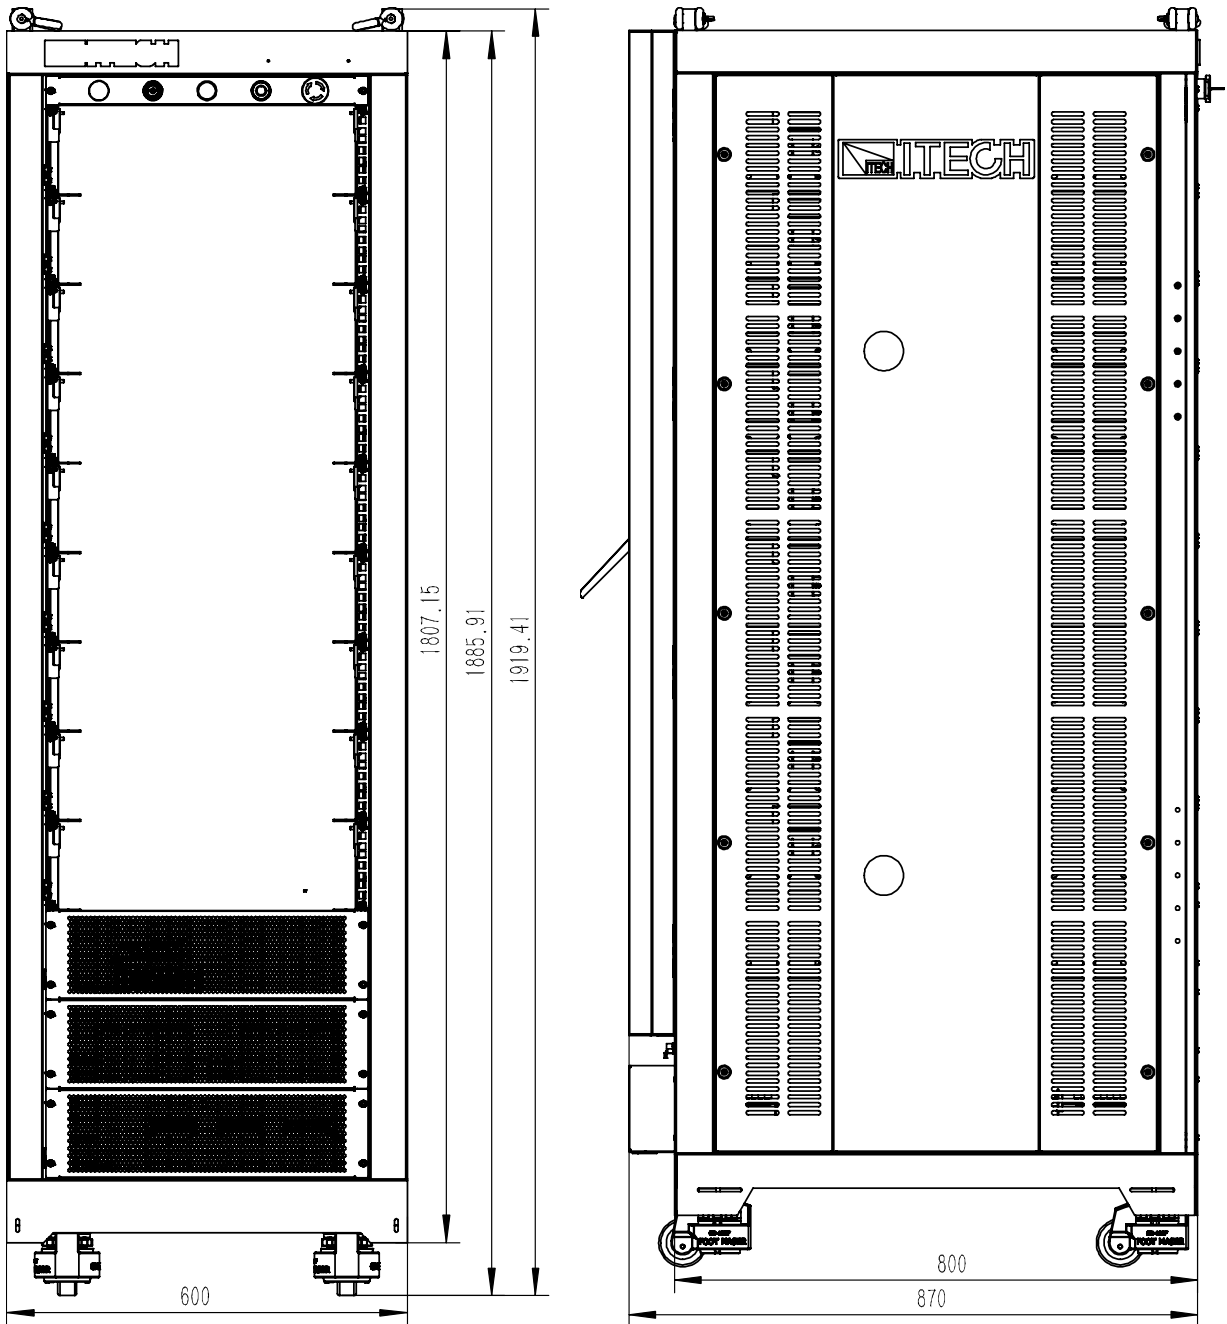

第二章 验货与安装

2.1 开箱与搬运

开箱

对于机柜类的产品，出厂时经过木箱包装，用户收到货物之后，参考随箱配置的开箱说明进行拆卸；对于纸箱包装的产品，请使用合适工具进行拆箱。

建议完整保存原厂的包装材料，以便后续返回原厂维修等运输场景使用。

搬运

非机柜类产品如需搬运，须注意以下事项以保证设备、人身等安全。


小心

- 搬运前，须确保设备即将放置的机柜或台架等已被固定好且符合承重条件，避免出现倾斜倒塌，致使人员被砸伤，仪器摔坏等问题。
- 搬运时，应做好承重的准备，避免扭伤或被重物压伤。
- 搬运时，请穿上合适的防护衣服，特别是防护鞋。一旦跌落可能造成严重后果。

机柜产品开箱后，如需移动到其他地方使用，须注意以下事项以保证设备、人身等安全。

小心

- 机柜产品较重，在推移到其他位置前，先确认地面承重是否符合条件。
- 推移过程中，建议两人或多人合作，缓慢匀速推行，如遇凹坑需特别注意，禁止快速推行，否则容易产生过大惯性导致卡轮倾倒。
- 不宜推行下斜坡，避免重心偏移倾倒，建议使用叉车或吊车移动机柜。
- ITECH 27U、37U 机柜顶部标配吊环，建议使用配备四脚吊装带结构的吊车进行水平吊装移动，且保证四根吊带同长，移动过程中避免机柜歪斜（如下图所示）。
- 移动到目的位置后，请将四个脚轮锁紧，固定机柜。
- 机柜应放置在水平地面，禁止将机柜停放在有坡度的地面。

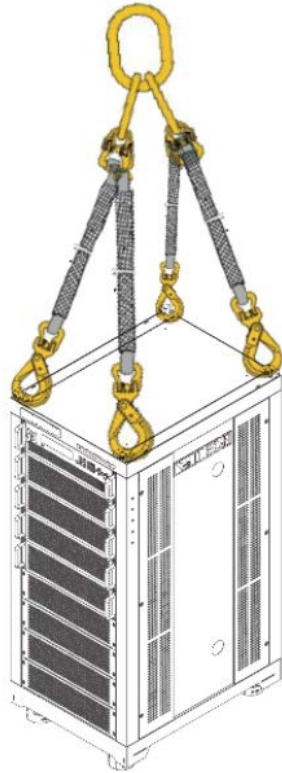

2.2 确认包装内容

打开包装，在操作仪器前请检查箱内物品，若有不符、缺失或外观磨损等情况，请立即与艾德克斯授权经销商或售后服务部门联系。

包装箱内容包括：

设备名	数量	型号	备注说明
大功率直流电压源	一台	IT6600D系列	本系列所包含的具体型号请参考 1.2 选型表和选配件 。
电源线	-	-	3U和15U机型标配1根电源线，27U和37U机型标配2组电源线。
USB 通讯线	一根	-	用于远程连接电脑。
LAN 通讯线	一根	-	用于远程连接电脑。
串并联电极套装	一套	IT-E184	用于串联或并联机器。(仅3U机型标配)
出厂校准报告	一份	-	出厂前本机器的测试报告。
合格证	一张	-	-



说明

确认包装内容一致且没有问题时，请妥善保管包装箱和相关内容物，仪器返厂服务时需要符合装箱要求。

2.3 连接电源线

连接标准配件电源线，确保已经给电源供应器正常供电。

连接电源线之前

为防止触电和损坏仪器，请遵守以下注意事项：

警告


- 在连接电源线之前，请确保供电电压与本仪器的额定输入电压相匹配。
- 在连接电源线之前，请确保电源开关处于关闭状态，并确认接线端子处不存在危险电压。
- 为预防触电和火灾，请使用由本公司提供的电源线。
- 请务必将输入电源线接入带保护接地的交流配电箱，请勿使用没有保护接地的接线板。
- 请勿使用没有保护接地线的延长电源线，否则保护功能会失效。
- 请确保使用提供的保护罩对电源线接线端子周围采取绝缘或盖板防护措施，以避免意外接触致命的电压。

小心

安全机构要求规定，必须有一种以物理方式断开交流电源线与设备的连接的方法。在最终安装中必须提供断连设备（开关或断路器）。断连设备必须接近此设备，容易接触到（以便于操作），并且必须标记为此设备的断连设备。

连接电源线

本系列 3U 机型标配的电源线如下所示。

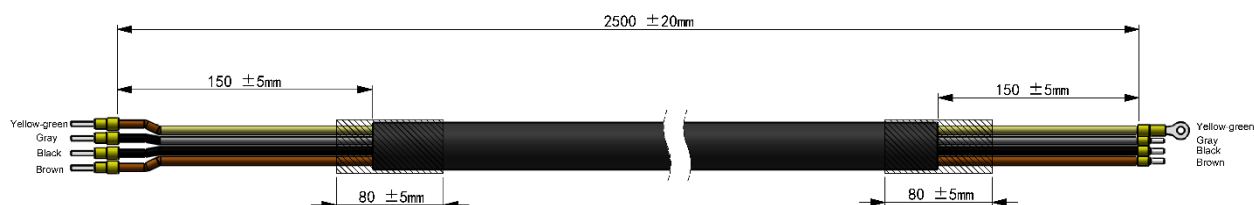

其中，黄绿色线为接地线，接入仪器后面板电源输入的 PE 端子，其余为火线，对应接入仪器后面板电源输入的 L1、L2、L3 端子。

电源的输入要求

本系列仪器的输入默认为三相交流电压（三相四线制），详细输入电压规格参考具体规格书。


请注意交流电源的输入电压。

说明

当机器输入的三相线电压为 $(198 \sim 264)\text{V}$ 时，环温为 40°C 时输出额定功率的 50%，环温为 50°C 时输出额定功率的 40%。并且当输出超过当前的额定值时，仪器进入保护，输出将被关闭。如果您希望达到满功率的输出，则必须使用大于 264V 的 AC 输入电压。

连接电源线

接线示意图如下所示：

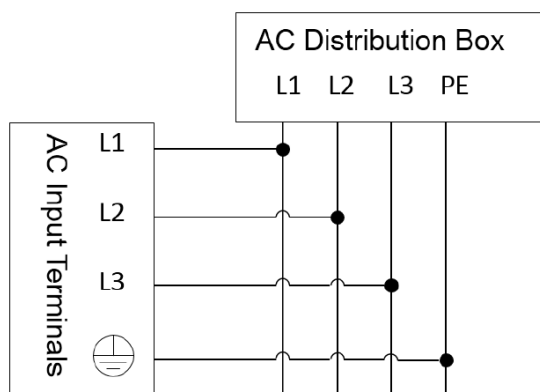

接线方法：

1. 确认配电箱的开关处于关闭状态。
2. 确认仪器电源开关处于关闭状态并确认接线端子处无危险电压。
3. 将电源线有圆型端子（接地端子）的一端连接到仪器后面板的 AC 电源输入端子上。
 - a) 棕/黑/灰三种颜色火线只需分别接入到后面板端子，与 L1、L2、L3 端子无需一一对应。
 - b) 黄绿色线为接地线，与保护性接地端子（PE）连接。



4. 参照接线要求及示意图，将电源线的另一端连接到满足要求的交流配电箱。
27U 机柜和 37U 机柜标配的两组电源线需要都接入到配电箱中。

2.4 连接测试线（选件）

测试线并不是本仪器的标准配件，请根据最大电流值选择购买单独销售的选配件红黑测试线，测试线与所能承受的最大电流值规格请参见附录中的红黑测试线规格。

警告

- 连接测试线前，请务必将仪器开关关断。Power 开关处于 Off 状态。否则接触后面板输出端子会发生触电危险。
- 为防止触电，测量之前请确认测试线的额定值，不要测量高于额定值的电流。所有测试线的容量必须能够承受电源的最大短路输出电流而不会发生过热。
- 如果有多个负载，则每对负载电线都必须能安全承载电源的满载额定短路输出电流。
- 请始终使用本公司所提供的测试线连接设备。若更换其他厂家测试线请确认测试线可以承受的最大电流。

测试线规格

连接待测物的测试线并不是本仪器的标准配件，请根据最大电流值选择购买单独销售的选配件红黑测试线，测试线与所能承受的最大电流值规格请参见附录→红黑测试线规格。


电极介绍

3U 单机的 DC 端的电极以及机柜电极的孔径均为 M8。

连接待测物（本地量测）

本仪器支持两种与待测物之间的接线方式：本地量测和远端测量，仪器默认的测试方式为本地量测，远端量测功能被关闭。请确认菜单中**远端测量**功能设置为关闭，否则当前接线方式仪器会报错。

本地量测时待测物的连接示意图和连接方法如下。

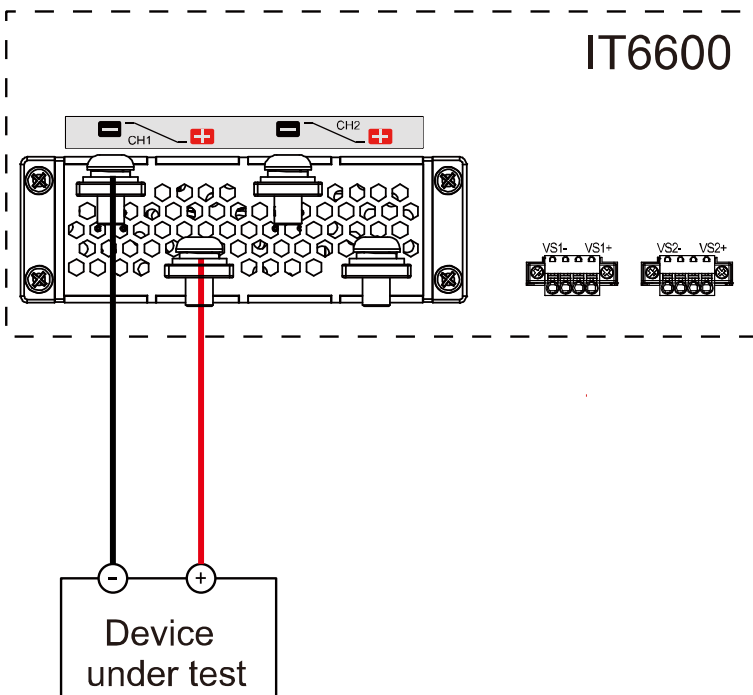

1. 确认仪器电源开关处于关闭状态并确认接线端子处无危险电压。
2. 揭开电源输出端子保护盖。
3. 旋开输出端子上的螺丝，并将红黑测试线按接线图连接到输出端子上再旋紧

螺丝。

当测试线所能承受的最大电流不满足当前额定电流，请使用多根红黑测试线。例如最大电流为 **1200A** 时，用户需要选购 **4 根 360A** 规格的红黑测试线并同时接入到仪器接线端子上。

4. 安装好电源输出端子保护盖，引出红黑测试线。
5. （可选）根据待测物的实际情况，将仪器后面板的接地端子与待测物正确连接，以保障待测物的安全接地。位置信息，详见 [1.5 后面板概览](#)。
6. 红黑测试线另一端接入到待测物接线端子处。接线时正负极务必连接正确，并连接紧固。


连接待测物（远端量测）

远端量测适用于以下场景：

当待测物消耗较大电流或导线较长时，就会在待测物到电源的连接线上产生较大的压降。为了保证测量精度，电源在后面板提供了一个远程量测端子，用户可以用该端子来测量待测物的端子电压。

实际应用中，电源用于电池充放电测试时，导线的压降会引起两端的电压不一致，电源的关断电压跟电池的实际电压不一致，导致测量不精确。

远端量测时待测物的连接示意图和连接方法如下。

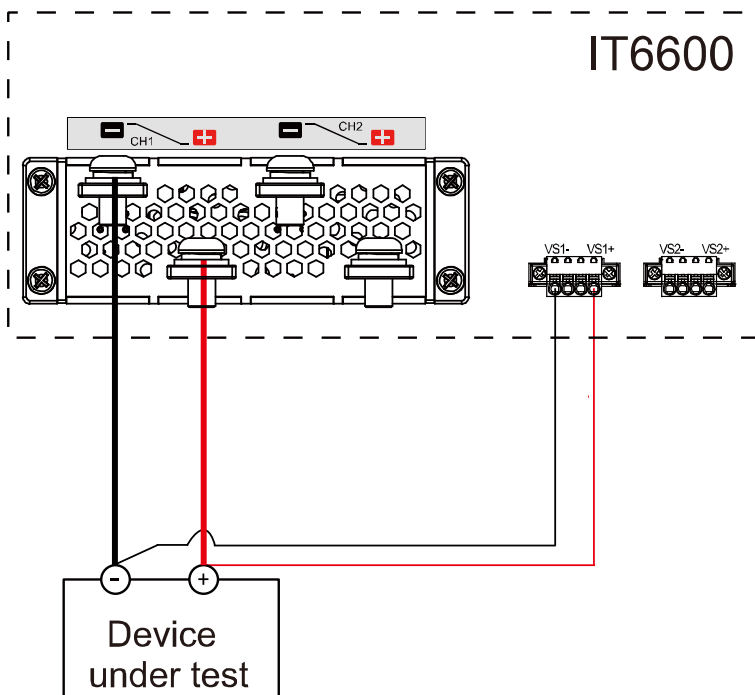

1. 确认仪器电源开关处于关闭状态并确认接线端子处无危险电压。
2. 揭开电源输出端子保护盖。
3. 旋开输出端子上的螺丝，并将红黑测试线按接线图连接到输出端子上再旋紧螺丝。

当测试线所能承受的最大电流不满足当前额定电流，请使用多根红黑测试线。例如最大电流为 **1200A** 时，用户需要选购 **4 根 360A** 规格的红黑测试线并同时接入到仪器接线端子上。

4. 安装好电源输出端子保护盖，引出红黑测试线。

5. （可选）根据待测物的实际情况，将仪器后面板的接地端子与待测物正确连接，以保障待测物的安全接地。位置信息详见 [1.5 后面板概览](#)。
6. 将连接 Sense 端子的双绞线另一端接入到待测物接线端子处。
7. 将红黑测试线另一端接入到待测物接线端子处。接线时正负极务必连接正确，并连接紧固。
8. 将仪器上电并将仪器的**远端测量**功能设置为**打开**。

第三章 入门操作

3.1 开启设备

成功的自检过程表明用户所购买的电源产品符合出厂标准，可以供用户正常使用。在操作电源之前，请确保您已经了解安全须知内容。

开启设备之前

为防止触电和损坏仪器，请遵守以下注意事项。

警告

- 在连接电源线之前，请确保供电电压与本仪器的额定输入电压相匹配。
- 在连接电源线之前，请确保电源开关处于关闭状态，并确认接线端子处不存在危险电压。
- 为预防触电和火灾，请使用由本公司提供的电源线。
- 请务必将输入电源线接入带保护接地的交流配电箱，请勿使用没有保护接地的接线板。
- 请勿使用没有保护接地线的延长电源线，否则保护功能会失效。
- 请确保使用提供的保护罩对电源线接线端子周围采取绝缘或盖板防护措施，以避免意外接触致命的电压。

小心

安全机构要求规定，必须有一种以物理方式断开交流电源线与设备的连接的方法。在最终安装中必须提供断连设备（开关或断路器）。断连设备必须接近此设备，容易接触到（以便于操作），并且必须标记为此设备的断连设备。

开关介绍

用户可以直接调节开关旋钮来打开或关闭设备。开关旋钮的状态如下。

当开关旋钮处于 OFF 位置时，可以顺时针旋转 90 度以打开设备电源；当开关旋钮处于 ON 位置时，可以逆时针旋转 90 度以关闭设备电源。



打开 POWER 开关

确认已正确连接电源线。

将 POWER 开关切换至(ON)状态以开启仪器。几秒钟后前面板显示屏将亮起。打开仪器电源后，自动进行加电自检。此测试可确保您的仪器可以正常工作。

如果出现自检错误，将在前面板中显示错误信息提示，按[Esc]按键尝试是否可以清除当前故障状态，用户也可以重新启动仪器尝试清除故障状态，重启时请等待至掉电完全后再启动，如重启后仍无法解决问题，请联系 ITECH 工程师。

关闭 POWER 开关

将 POWER 开关切换至(OFF)状态以关闭仪器，关闭时，仪器界面会提示**请等待设备关机**，仪器会将关机前的设定信息储存在第 1 组非易失性存储器中。

关闭仪器后，如需重新打开 POWER 开关，请在风扇停止后等待至少 10 秒钟。关闭后过快打开仪器会导致浪涌电流限制器电路损坏，并缩短 POWER 开关和内部输入保险丝等组件的使用寿命。

3.2 触摸屏介绍

本系列电源显示屏是一款触摸屏 LCD 界面，用户可以通过用手触摸方式选择和设定参数。触摸功能可以在系统菜单中设置。

1. 在系统菜单中选择**通用配置**。
2. 点击**触摸功能**菜单项的下拉框设置触摸屏状态。
 - 若选择**打开**：则触摸功能开启。
 - 若选择**关闭**：则触摸功能关闭。

3.3 设置参数

本仪器的电压值、电流值、功率值都可以进行编程，在规格范围内客户根据需要进行设置不同的输出参数。满足客户多种测试需求。

用户在前面板选择 Set 键设置带载参数，光标闪烁提示。可以使用以下方式进行设置参数。

- 直接按数字键设定参数值大小。
- 旋转旋钮键，用来设置光标处的数据值，顺时针转动增大设定值，逆时针转动减小设定值。旋钮旋转设置参数时，当前光标处的数值达到 10 后自动进位，达到 0 后自动借位，方便用户设置。旋钮也可以配合左右方向键使用，左右键可以移动光标位置，方便用户快速的设定数值。



说明

该旋钮也可以用来翻页显示菜单项。进入菜单界面后，转动旋钮可翻页显示菜单项。

3.4 使用 On/Off 按键

警告

- [On/Off]键在正常情况下可以启动或停止仪器输出，当仪器在远程模式下，只能 OFF 不能 ON。
- 前面板[On/Off]键灯灭，仪器输出关闭状态下，并不能表示当前仪器没有电击危险，仪器输出端子处仍然可能有危险电压会造成人身伤亡。请不要以

[On/Off]状态来判断操作电极是否安全。若需要连接测试线，请先阅读连接测试线前的相关注意事项。

[On/Off]按键控制

您可以通过按下前面板的[CH1 On/Off]键和[CH2 On/Off]键来控制仪器 2 个通道的输出开关。按下[On/Off] 按键，按键灯亮，表示当前输出打开，界面 meter 区域会显示当前回路中的电压值、电流值和功率值；再次按下[On/Off] 按键，按键灯灭，表示当前输出关闭，仪器界面显示 **OFF** 标识。

数字 IO 引脚控制

本系列仪器标配的**数字 IO** 引脚支持外部电平/脉冲信号控制输出的功能，结合外部电路，可实现对输出的急停控制。参考如下使用案例：

案例：

数字 IO 的引脚 5，具备**禁止输出**的功能，默认**反向(关闭)**、**禁止输出-自动**的设置下，可通过向引脚 5 输入低电平（0V）禁止机器输出，此时[On/Off]按键灯亮，实际无输出。恢复引脚 5 为高电平，则机器恢复输出。

1. 进入**系统→数字 IO→引脚 7:禁止输出**菜单。
2. 选择**反向(关闭)**、**禁止输出-自动**选项，按[Enter]确认。
3. 连接**数字 IO** 的 Pin5（正极）和 Pin8（负极）到外部信号控制回路。
此时 Pin5 和 Pin8 之间输出 5V。
4. 连接 DUT 后，打开[On/Off]。
5. 向 Pin5（正极）和 Pin8（负极）输入 0V，或直接短接 Pin5 和 Pin8。
此时，输出被禁用。
6. 向 Pin5（正极）和 Pin8（负极）输入 5V，或断开 Pin5 和 Pin8 之间的短接线。
此时，输出恢复。

第四章 电源功能

本章将详细描述电源的功能和特性。

4.1 使用输出功能

4.1.1 设置输出模式

本系列电源支持 DC 输出模式。输出模式在配置菜单中进行选择。

1. 在前面板按下复合按键[Shift] + [V-set] (Config)进入配置菜单界面。
2. 通过上下键或转动旋钮，找到菜单项**输出耦合模式**。
 - i. 按上下方向键，将光标移动至**模式**功能设置处，并按[Enter]键确认。旋转旋钮，设置 DC 输出模式，并按[Enter]键确认。
3. 按[Esc]键，退出菜单界面。


DC 模式

当 DC 模式开启时，此时仪器作为一台直流电源使用。在该模式下，仪器产生直流输出。

设置输出电压/电流/功率

- CV 优先（默认）模式下，主界面显示 Vset（电压设定值）、Ilimit（电流上限值）、和 Plimit（功率上限值）。
- CC 优先模式下，主界面显示 Iset（电流设定值）、Vlimit（电压上限值）、和 Plimit（功率上限值）。

按上下方向键，将光标移动至参数设置处，并按[Enter]键确认。在参数输入区域，使用数字键或调整旋钮输入具体参数值，按[Enter]键后，此值即可生效。

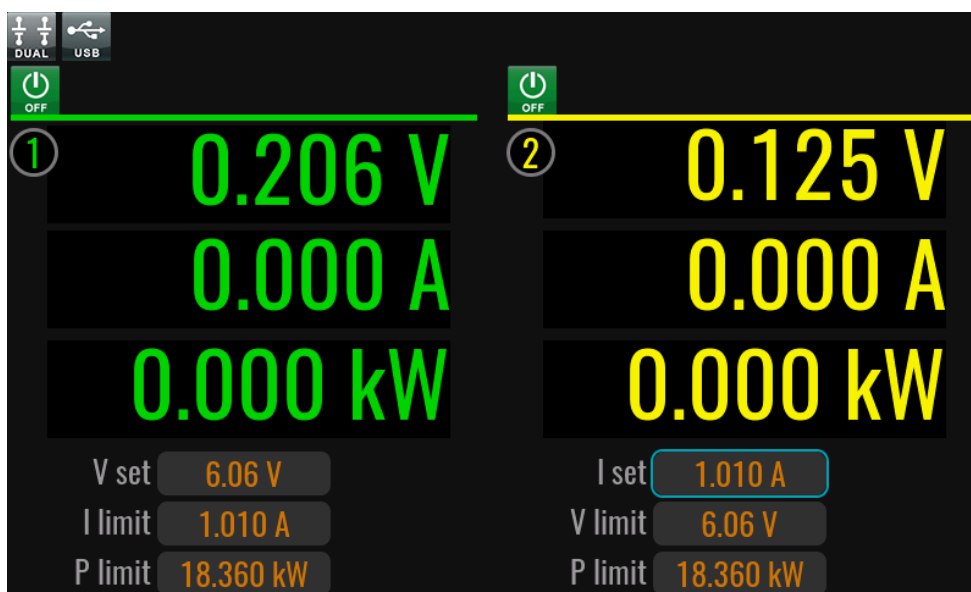


4.1.2 设置输出优先模式

CV 优先

在 CV 优先模式下，输出由恒定电压反馈回路控制，因此只要负载电流处于设置的电流限制范围内，便可将输出电压维持在其已编程的设置。CV 优先模式适用于电阻或高阻抗负载，以及对电压超调量敏感的负载。请勿将 CV 优先模式用于低阻抗源（如电池、电源或大型带电电容器）。

在 CV 优先模式下，应将输出电压编程为所需值。此外，还应设置电流限制值。应该总是将电流限制设置为高于外部负载的实际输入电流要求。下图显示了 CV 优先模式下输出的运行轨迹。

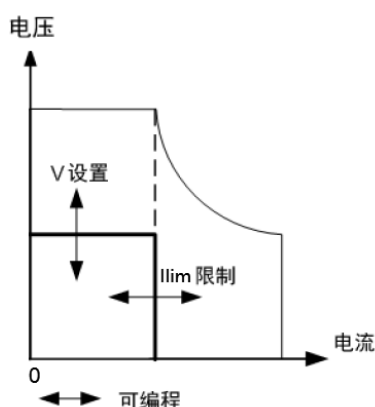


较粗实线表示输出功能的可能运行点轨迹。如此线的水平部分所示，只要负载电流保持在电流限制设置范围内，输出电压就会保持按其设定的设置进行调节。CV 状态标记表示正在调节输出电压，并且输出电流处于其限制范围内。

在输出电流达到电流限制时，设备不再处于恒电压模式下运行，并且输出电压不再保持恒定，而是电源现在按其电流限制设置调节输出电流。

CC 优先

在 CC 优先模式中，输出由恒定电流反馈回路控制，该反馈回路可按其已设定设置维持输出电流。只要负载电压处于电压限制设置范围内，就可将输出电流维持在其已编程的设置。CC 优先模式适用于电池、电源、大型带电电容器和对电流超调量敏感的负载。

在 CC 优先模式中，应该将输出电流编程设定为所需的值。还应该设置正电压限制范围。应该总是将电压限制设置为高于外部负载的实际输入电压要求。下图显示了 CC 优先的输出运行轨迹。

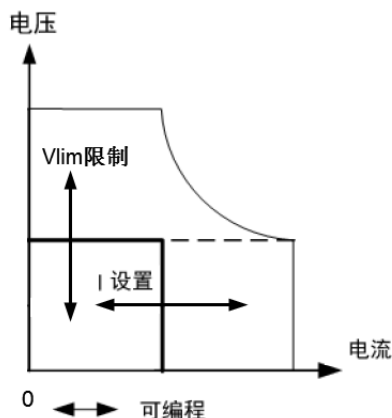

较粗实线表示输出功能的可能运行点轨迹。如此线的垂直部分所示，只要输出电压保持在电压限制设置范围内，输出电流就会保持按其设定的设置进行调节。**CC**（恒定电流）状态标记表示正在调节输出电流，并且输出电压处于其限制设置范围内。

如果输出电压达到电压限制，则设备不再在恒定电流模式下运行，并且输出电流不再保持恒定。而是电源现在按其电压限制设置调节输出电压。

如何设置

CC、CV 优先权选择的操作步骤如下。

1. 在前面板按下复合按键[Shift] + [V-set] (Config)进入配置菜单界面。
2. 通过上下键或转动旋钮，找到菜单项**优先模式**。
 - i. 按上下方向键，将光标移动至**模式**功能设置处，并按[Enter]键确认。旋转旋钮，设置 **CC** 优先或 **CV** 优先，并按[Enter]键确认。
 - ii. 按上下方向键，将光标移动至**环路速度**功能设置处，并按[Enter]键确认。使用数字键，设置 **CC** 或 **CV** 环路响应速度，并按[Enter]键确认。
3. 按[Esc]键，退出菜单界面。

4.1.3 设置输出斜率

本仪器可以设置电源功能下的电压上升/下降斜率(CV 优先时)或电流上升/下降斜率(CC 优先时)。电压/电流的变化斜率是指电源从当前的输出电压/电流变化为一个新的设定值的速率。

本仪器提供两种斜率方式：时间斜率和标准斜率。标准斜率会受到串联和并联的影响，相关的斜率参数请参考下表。

斜率	优先模式	单位	最小值	最大值 (Num为并联或串联的机器数量)	默认值
时间	CV	ms	0.2ms	-	0.500ms
	CC	ms	0.2ms	-	0.500ms
标准	CV	V/ms	-	● 并联&双通道: $V_{max}/0.2ms$ ● 串联: $V_{max}/0.4ms$	$V_{max}/0.5ms$
	CC	A/ms	-	● 并联: $I_{max}/(0.4ms*Num)$ ● 串联&双通道: $I_{max}/(0.2ms*Num)$	$I_{max}/0.5ms$

仪器根据当前 CV 优先或 CC 优先模式的设置而显示不同的斜率参数。

- 当 CV 优先时：界面显示 V-Rise 和 V-Fall 设置参数。
- 当 CC 优先时：界面显示 I-Rise 和 I-Fall 设置参数。

以 CV 优先模式为例，设置输出斜率。CC 优先模式设置方法相同。

1. 在前面板按下复合按键[Shift] + [V-set] (Config)进入配置菜单界面。
2. 通过上下键或转动旋钮，找到菜单项**优先模式**。
 - i. 按上下方向键，将光标移动至 **Mode** 功能设置处，并按[Enter]键确认。转动旋钮，选择 **CV 优先**，并按[Enter]键确认。
 - ii. 按上下方向键，将光标移动至**环路速度**功能设置处，并按[Enter]键确认。使用左右键和旋钮，设置 CV 环路响应速度，并按[Enter]键确认。
3. 通过上下键或转动旋钮，找到菜单项**斜率设置**。
 - i. 按上下方向键，将光标移动至**模式**功能设置处，并按[Enter]键确认。转动旋钮，设置斜率单位，并按[Enter]键确认。
 - ii. 按上下方向键，将光标移动至**电压上升**功能设置处，并按[Enter]键确认。使用左右键和旋钮，设置电压上升斜率值，并按[Enter]键确认。
 - iii. 按上下方向键，将光标移动至**电压下降**功能设置处，并按[Enter]键确认。使用左右键和旋钮，设置电压下降斜率值，并按[Enter]键确认。
4. 按[Esc]键，退出菜单界面。

4.1.4 设置电源内阻

本系列仪器支持设置电源的内阻值（仅限 CV 优先模式下）。操作步骤如下。

1. 在前面板按下复合按键[Shift] + [V-set] (Config)进入配置菜单界面。
2. 通过上下键或转动旋钮，找到菜单项**输出电阻**。
 - i. 按上下方向键，将光标移动至**设定值**功能设置处，并按[Enter]键确认。使用数字键输入内阻值，再按[Enter]键确认。
3. 按[Esc]键，退出菜单界面。

4.1.5 设置输出 On/Off 延迟

可以设置开启/关闭输出（即[On/Off]）的延时时间。值范围为 0 秒到 60 秒。

- **打开延迟+延迟偏置**：表示电源从收到开启[On/Off]的命令到实际开启[On/Off]之间的延迟时间。
- **关闭延迟+延迟偏置**：表示电源从收到关闭[On/Off]的命令到实际关闭[On/Off]之间的延迟时间。

输出延时设置的操作步骤如下。

1. 在前面板按下复合按键[Shift] + [V-set] (Config)进入配置菜单界面。
2. 通过上下键或转动旋钮，找到菜单项**打开/关闭延迟**。
 - i. 按上下方向键，将光标移动至**打开延迟**功能设置处，并按[Enter]键确认。使用数字键，设置输出开启的延时值，并按[Enter]键确认。
 - ii. 按上下方向键，将光标移动至**关闭延迟**功能设置处，并按[Enter]键确认。使用数字键，设置输出关闭的延时值，并按[Enter]键确认。

3. 按[Esc]键，退出菜单界面。

4.1.6 启用输出

您可以通过按下前面板的[CH1 On/Off]键和[CH2 On/Off]键来控制仪器 2 个通道的输出开关，当仪器接收到开启输出指令后，会根据 On/Off 延时设置启动输出。On/Off 延迟设置默认为 0，电源输出立即启动或立即关闭。有关输出启动和关闭的延迟设置请参见 4.2.5 设置输出 On/Off 延迟。

- 当[On/Off]键灯亮，表示输出开启，仪器显示界面出现当前仪器的运行模式标识。
- 当[On/Off]按键灯灭，表示输出关闭，仪器显示界面出现 OFF 标识。

4.2 保护功能

按[Shift]+[Recall] (Protect) 进入保护配置菜单页面，关于保护功能的菜单列表及介绍如下所示。

过压保护		
	状态	设置保护状态：打开、关闭。
	值	设置过电压保护点。
	延时	设置保护延迟时间。
过流保护		
	状态	设置保护状态：打开、关闭。
	值	设置过电流保护点。
	延时	设置保护延迟时间。
过功率保护		
	状态	设置保护状态：打开、关闭。
	值	设置过功率保护点。
	延时	设置保护延迟时间。
欠压保护		
	状态	设置保护状态：打开、关闭。
	温机时间	设置仪器预热时间。
	值	设置欠电压保护点。
	延时	设置保护延迟时间。
欠流保护		
	状态	设置保护状态：打开、关闭。
	温机时间	设置仪器预热时间。
	值	设置欠电流保护点。
	延时	设置保护延迟时间。
最大电压限制		设置最大电压值。
	值	最大电压值
最大电流限制		设置最大电流值。
	输出	最大输出电流值。
	吸收	最大输入电流值。
最大功率限制		设置最大功率值。
	输出	最大输出功率值。
	吸收	最大输入功率值。

4.2.1 过电压保护

过电压保护功能允许用户开启保护，并设置过电压保护点和保护延迟时间。该功

能主要是保护测试中连接的待测物，使之不会过压，不会因过压而受损。

如何设置

1. 按[Shift]+[Recall] (Protect) 复合键，进入**保护**配置菜单页面。
2. 按上下方向键，将光标移动至**过压保护**功能设置处。
3. 依次设置保护状态、保护点和延迟时间，按[Enter]确认。

清除过电压操作

当发生过电压后，仪器发生如下响应：

- 机器以 3s 为周期发出报警声音；
- 主界面状态栏显示 OVP 图标；
- 状态寄存器，OVP 状态位置 1。

要清除过电压并恢复正常运行状态，请先删除导致保护故障的条件。按[Shift]和[Esc]键（或发命令 PROTECT:CLEAR）清除保护状态，仪器前面板保护字样消除，仪器退出 OVP 状态。

4.2.2 过电流保护

过电流保护功能允许用户开启保护，并设置过电流保护点和保护延迟时间。该功能主要是保护测试中连接的待测物，使之不会过载，不会因过载而受损。

如何设置

1. 按[Shift]+[Recall] (Protect) 复合键，进入**保护**配置菜单页面。
2. 按上下方向键，将光标移动至**过流保护**功能设置处。
3. 依次设置保护状态、保护点和延迟时间，按[Enter]确认。

清除过电流操作

当发生过电流后，仪器发生如下响应：

- 机器以 3s 为周期发出报警声音；
- 主界面状态栏显示 OCP 图标；
- 状态寄存器，OCP 状态位置 1。

要清除过电流并恢复正常运行状态，请先删除导致保护故障的条件。按[Shift]+[Esc]键（或发命令 PROTECT:CLEAR）清除保护状态，仪器前面板保护字样消除，仪器退出保护状态。

4.2.3 过功率保护

过功率保护功能允许用户开启保护，并设置过功率保护点和保护延迟时间。该功能主要是保护测试中连接的待测物，使之不会过载，不会因过载而受损。

如何设置

1. 按[Shift]+[Recall] (Protect) 复合键，进入**保护**配置菜单页面。
2. 按上下方向键，将光标移动至**过功率保护**功能设置处。
3. 依次设置保护状态、保护点和延迟时间，按[Enter]确认。

清除过功率操作

当发生过功率后，仪器发生如下响应：

- 机器以 3s 为周期发出报警声音；
- 主界面状态栏显示 OPP 图标；
- 状态寄存器，OPP 状态位置 1。

要清除过功率并恢复正常运行状态，请先删除导致保护故障的条件。按 **[Shift]+[Esc]** 键（或发命令 **PROTECT:CLEAR**）清除保护状态，仪器前面板保护字样消除，仪器退出保护状态。

4.2.4 欠电压保护

用户开启欠电压保护功能并设置仪器预热时间、欠电压保护点和保护延迟时间，当电路中的电压（即 **Meter** 值）低于此保护点、且超出预热时间和延迟时，电源将进入欠电压保护的状态。

如何设置

1. 按 **[Shift]+[Recall]** (Protect) 复合键，进入**保护配置**菜单页面。
2. 按上下方向键，将光标移动至**欠压保护**功能设置处。
3. 依次设置保护状态、仪器预热时间、保护点和延迟时间，按 **[Enter]** 确认。

清除欠电压操作

当发生欠电压后，仪器发生如下响应：

- 机器以 3s 为周期发出报警声音；
- 主界面状态栏显示 UVP 图标；
- 状态寄存器，UVP 状态位置 1。

要清除欠电压并恢复正常运行状态，请先删除导致保护故障的条件。同时按 **[Shift]** 和 **[Esc]** 键（或发命令 **PROTECT:CLEAR**）清除保护状态，仪器前面板保护字样消除，仪器退出 **UVP** 状态。

4.2.5 欠电流保护

用户开启欠电流保护功能并设置仪器预热时间、欠电流保护点和保护延迟时间，当电路中的电流（即 **Meter** 值）低于此保护点、且超出预热时间和延迟时，电源将进入欠电流保护的状态。

如何设置

1. 按 **[Shift]+[Recall]** (Protect) 复合键，进入**保护配置**菜单页面。
2. 按上下方向键，将光标移动至**欠流保护**功能设置处。
3. 依次设置保护状态、仪器预热时间、保护点和延迟时间，按 **[Enter]** 确认。

清除欠电流操作

当发生欠电流后，仪器发生如下响应：

- 机器以 3s 为周期发出报警声音；
- 主界面状态栏显示 UCP 图标；

- 状态寄存器，UCP 状态位置 1。

要清除欠电流并恢复正常运行状态，请先删除导致保护故障的条件。同时按[Shift]和[Esc]键（或发命令 PROTECT:CLEAR）清除保护状态，仪器前面板保护字样消除，仪器退出 UCP 状态。

4.2.6 限定电压值/电流值/功率值范围

电压输出值可在 Vmax 的 1%至 100%之间调节，电流输出值和功率输出值可在 0%至 100%之间调节。您可以在**保护**菜单中设定输出电压、电流和功率的上限值。操作步骤如下：

1. 按[Shift]+[Config] (Protect) 复合键，进入**保护**配置菜单页面。
2. 按上下方向键，将光标移动至**最大电压限制**、**最大电流限制**和**最大功率限制**功能设置处。
3. 依次设置电压、电流和功率等输出值的最大值，按[Enter]确认。

4.2.7 过温度保护

当电源内部功率器件超过约 95℃时，电源过温度保护。此时电源会自动 OFF，LCD 会显示过温度保护的 OTP 图标。同时状态寄存器中的 OT 位会被设置，它会一直保持，直到被复位。

清除过温度保护的操作：

当电源温度降到保护点后，当按下前面板 [Shift]+[Esc] 键（或发送命令 PROTECTION:CLEAR），电源前面板过温度保护的图标消失，即可退出 OTP 状态。

4.3 LIST 功能

用户可使用 List 功能来编辑由多个步骤组成的测试程序。每个 List 文件中最多可配置 10 万个步骤。用户需编辑每个步骤的电压/电流、斜率以及持续时间，可以将每个 List 文件设置重复特定的次数、最终的状态等。完成 List 文件编辑之后，您可以根据设置的触发方式，将选中的 List 文件触发运行。

List 界面介绍



1. CH1 状态栏：显示电源通道 1 的输出状态。

2. CH2 状态栏：显示电源通道 2 的输出状态。
3. CH1/CH2：通道选择，CH1 或 CH2。
4. 列表文件名：显示当前打开的 List 文件名称。
5. List 显示区域：此区域主要显示编辑好的 List 列表，可通过上下滑动浏览此列表。
6. 输出值显示区：显示当前通道的输出电压值、输出电流值和输出功率值。
7. 设置值显示区（Normal 模式）：CV 优先时，显示电压设置值、电流上限值、功率上限值。CC 优先时，显示电流设置值、电压上限值、功率上限值。
8. List 编辑按钮，功能说明如下。
 - 运行/停止：启动/停止 List 运行。
 - 暂停/继续：暂停/继续 List 运行。
 - 打开：调取 List 文件。
 - 编辑：编辑当前的 list 文件。
9. 显示 List 功能的相关参数，可通过上下滑动浏览此列表。

编辑 List 文件

下面以 CV 优先模式为例，介绍编辑 3 个测试步骤的操作。

1. 按前面板的[Shift]+[I-set](List)键，进入 List 功能主界面。
2. 点击屏幕上的编辑键，进入 List 文件编辑界面。



List 编辑区域参数解释如下：

参数	功能说明
描述	当前编辑的 List 文件名称。
List 文件属性参数	
优先模式	List 运行优先模式。
重复	当前 List 文件循环的次数。可以选择无限和数量，当选择数量时还需要设置总循环次数，设置范围：1-99999999。

参数	功能说明
触发输出	触发信号输出的功能开关。 ● 关闭: 关闭此功能。 ● 打开: 打开此功能。当 IO-4 配置为触发输出时, 触发 List 功能时将从 IO-4 输出脉冲信号。
斜率模式	设置斜率单位。 ● 时间: 用时间来描述设备的斜率。 ● 标准: 标准斜率, 单位为 V/ms 或 A/ms。
结束模式	当前 List 文件运行结束后, 保持的状态 (当 Repeat 选择 Count 时才显示)。 ● 输出最后步: 保持最后一步参数输出。 ● 输出关闭: 关闭输出。 ● 输出常设值: 跳转到 Normal 模式。
触发源	选择该 list 文件运行的触发源。 ● 立即: 立即执行一次触发操作。 ● 手动: 表示通过前面板按键手动触发, 即按一次复合按键[Shift]+[Channel](Trig), 进行一次触发操作。 ● 总线: 总线触发。当仪器接收到触发命令*TRG 时, 进行一次触发操作。 ● 外部: 表示通过数字 I/O 接口 (P-IO) 的引脚 4 进行触发。关于 I/O 引脚的介绍, 详见 5.9 数字 I/O 功能。
List 文件步骤参数	
序号	List 波形步骤编号, 点击(出现"..."时)可显示操作动作。如复制/黏贴/剪切/插入/删除。
设定值	当前步骤的电压值/电流值。
斜率	当前步骤的斜率。
保持时间	当前步骤的持续时间。范围: 0.001s~21000s。
按钮说明	
保存	保存当前编辑的 list 文件, 可以保存到仪器内存或外部 U 盘中。
配置	配置 list 文件, 使文件起效。
全部清除	删除所有步骤数据。

3. 在 List 编辑区域中填写相应的参数, 按保存键进行保存。

在 list 编辑界面, 单击单步的序号(出现"..."时), 界面显示复制/黏贴/剪切/插入/删除键, 选择对应的按键执行单步的增删操作。

4. 按[Esc]键, 返回 List 功能界面, List 显示区域显示已编辑的 List 文件。

调用/运行 List 文件

如果已经编辑好了多个 List 文件, 调用操作可调出需要测试的 List 文件。具体操作步骤如下:

1. 按前面板的[Shift]+[I-set](List) 键, 进入 List 功能主界面。
2. 点击屏幕上的打开键, 选择已存储的 7.csv 文件, 点击打开键确认调用。
3. 按前面板 [On/Off]键, 开启电源输出。
4. 在 List 界面中点击运行。

- 根据已设置的触发方式，触发 List 文件的运行。

以面板触发为例，在前面板按下[Shift]+[5](Trigger)，被选中的 List 文件开始运行。

停止 List 文件运行

在 List 文件运行过程中，若点击**停止**，表示停止当前的运行，可等待下次触发运行；若点击**暂停**，表示暂停当前文件的运行，后续可通过点击**重新开始**继续往下运行。

导入/导出 List 文件

● 导入 List 文件

本系列支持外部导入 List 文件功能，用户可以用 Excel 编辑完成 List 文件后导入到机器中。该功能简化了 List 文件编辑过程，方便客户操作。


为了方便用户定义 Excel 文件格式，请直接从 list 界面导出一个 CSV 格式的模板，再填写步骤参数。

具体操作步骤举例如下：

- 在本地 PC 上新建 Excel 文档，命名为 5.csv。
- 打开 Excel 文档，将其另存为其他格式，保存类型选择为 (*.csv) 格式。
- 打开 5.csv 文件，编辑 List。设置 List 的每一步及相关参数值，将文件保存在 U 盘内。

	A	B	C	D	E
1	Model	IT6600			
2	Version	123			
3	File Type	List			
4	Priority	McCV			
5	Repeat	Mc Count			
6	Repeat Co	2			
7	End	OFF			
8	Slew Mode	Standard			
9	Trig Source	Manual			
10	Trig Out	OFF			
11	Step total	3			
12	Step Index	Level(V)	Slew(V/ms)	Keep Time(S)	
13	1	5	1	5	
14	2	7	1	5	
15	3	3	1	5	
16					

- 双通道输出模式和并联输出模式的 list 文件需要放在 U 盘的 listParallel 文件夹中。
- 串联输出模式的 list 文件需放在 U 盘的 listSeries 文件夹中。



- 将 U 盘插入到前面板的 USB 接口处，按前面板的 [Shift]+[I-set](List) 键，进入 List 功能主界面。
- 点击屏幕上的**打开**键，进入 list 调用界面。
- 点击**U 盘**，选择**U 盘**里的 5.csv 文件，点击**打开**键确认。即完成该 List

文件的导入，界面出现配置好的 5.csv 文件。

● 导出 List 文件

用户编辑完 List 文件后，可以直接保存在仪器内部也可以导出到外围存储盘中进行保存，导出的 List 以 (*.csv) 文件格式进行保存。具体操作步骤如下：

1. 将 U 盘插入到前面板的 USB 接口处。(USB 端口选择要设为前面板 USB.)
2. 按前面板的 [Shift]+[I-set](List) 键，进入 List 功能主界面。
3. 点击屏幕上的编辑键，进入 list 编辑页面。
4. 点击保存键，进入 list 保存界面。
5. 点击 U 盘，设置导出文件的 FileName，点击保存确认导出。即完成将编辑界面的 list 文件导出到 U 盘中。

4.3.1 ARB 功能

本系列仪器标配 ARB（任意波形）功能，即允许输出生成用户自定义的任意复杂电压或电流波形。可通过以下方式来操作：

通过 U 盘导入

仪器支持通过前面板的 USB 接口导入已编辑的.csv 格式文件(模板可联系 ITECH 获取)，解析后生成电压或电流值，再根据用户指定的时间宽度输出复杂的电压或电流波形。用户可以编辑一个包含高达八千万个电压或电流点的.csv 文件，导入仪器运行，实现任意波形输出或工况模拟。仪器具有快速解析数据的能力，几十兆的.csv 文件，在 5S 内可以完成导入和解析，让测试更便捷更高效。

本仪器支持导入以下几种波形对应的.csv 文件：

● CDWELL：恒定驻留任意波形

.csv 模板文件包含的字段解释如下：

Model	设备型号，保持默认设置即可，无需修改。
Firmware Version	固件版本号，保持默认设置即可，无需修改。
Serial Number	设备序列号，保持默认设置即可，无需修改。
File Type	文件类别，保持默认设置即可，无需修改。
Waveform Type	波形类型，保持默认设置即可，无需修改。
Value Unit	CV 优先设置为 V，CC 优先设置为 A。
Offset Unit	偏置值单位，CV 优先设置为 V，CC 优先设置为 A。
Time Unit	时间单位，固定设置为 S。
Mode	电源模式，CV 优先设置为 CV，CC 优先设置为 CC。
Repeat	重复次数，设置范围 1~65535。
End State	结束状态，Last（运行结束维持在最后一个点的电压或电流）或者 Normal（运行结束返回到 CDWELL 执行前的模式）。
Total Point	波形总点数。
Keep Time	每个点的脉宽。范围：0~3600。单位：秒。
Value	每个点的电压/电流值。

● List：用户自定义波形

.csv 模板文件包含的字段解释如下：

Model	设备型号，保持默认设置即可，无需修改。
-------	---------------------

Firmware Version	固件版本号，保持默认设置即可，无需修改。
Serial Number	设备序列号，保持默认设置即可，无需修改。
File Type	文件类别，保持默认设置即可，无需修改。
Waveform Type	波形类型，保持默认设置即可，无需修改。
Value Unit	CV 优先设置为 V，CC 优先设置为 A。
Slope Unit	斜率单位，固定设置为 S。
Time Unit	时间单位，固定设置为 S。
Mode	电源模式，CV 优先设置为 CV，CC 优先设置为 CC。
Step Count	总步数，最高可编辑千万个点。
Repeat	重复次数，设置范围 1~65535。
End State	结束状态，Last（运行结束维持在最后一步的电压或电流）或者 Normal（运行结束返回到 List 执行前的 normal 模式）。
Step Index	单步的序号。
value	单步的电压/电流值。
slope	单步的斜率。
Keep Time	单步的脉宽。

● Sine: 正弦波

.csv 模板文件包含的字段解释如下：

Model	设备型号，保持默认设置即可，无需修改。
Firmware Version	固件版本号，保持默认设置即可，无需修改。
Serial Number	设备序列号，保持默认设置即可，无需修改。
File Type	文件类别，保持默认设置即可，无需修改。
Waveform Type	波形类型，保持默认设置即可，无需修改。
Amp Unit	峰峰值单位，CV 优先设置为 V，CC 优先设置为 A。
Offset Unit	偏置值单位，CV 优先设置为 V，CC 优先设置为 A。
Frequency Unit	频率单位，Hz。
Mode	电源模式，CV 优先设置为 CV，CC 优先设置为 CC。
Repeat	重复次数，设置范围 1~65535。
Amp	峰峰值
Offset	偏置值
Frequency	频率值，默认最大 250Hz。
End State	结束状态，Last（运行结束维持在最后一步的电压或电流）或者 Normal（运行结束返回到 Sine 执行前的 normal 模式）。

● Sweep: 扫频波


.csv 模板文件包含的字段解释如下：

Model	设备型号，保持默认设置即可，无需修改。
Firmware Version	固件版本号，保持默认设置即可，无需修改。
Serial Number	设备序列号，保持默认设置即可，无需修改。
File Type	文件类别，保持默认设置即可，无需修改。
Waveform Type	波形类型，保持默认设置即可，无需修改。
Amp Unit	峰峰值单位，CV 优先设置为 V，CC 优先设置为 A。
Offset Unit	偏置值单位，CV 优先设置为 V，CC 优先设置为 A。
Time Unit	时间单位，S。
Frequency Unit	频率单位，Hz。

Mode	电源模式，CV 优先设置为 CV，CC 优先设置为 CC。
Repeat	重复次数，设置范围 1~65535。
Amp	峰峰值
Offset	偏置值
Start Frequency	起始频率
End Frequency	终止频率
Step DwellH	运行总时长
Step time	单步脉宽。单步脉宽和单步重复次数二选一设置。
Step Repeat	单步重复次数。单步脉宽和单步重复次数二选一设置。
Step mode	运行模式，设置为 0 或者 1，当设置为 0，表示以运行总时长 Step DwellH 和单步脉宽 Step time 作为运行结束条件；设置为 1，表示以单步重复次数 Step Repeat 作为运行结束条件。
End State	结束状态，Last（运行结束维持在最后一步的电压或电流）或者 Normal（运行结束返回到 Sweep 执行前的 normal 模式）。

操作步骤如下：

1. 在 PC 端编辑模板对应的 8.csv 格式的文件，并保存。
2. 将编辑好的 8.csv 格式文件保存于 U 盘中。
 - 双通道输出模式和并联输出模式的 ARB 文件需要放在 U 盘的 listParallel 文件夹中。
 - 串联输出模式的 ARB 文件需放在 U 盘的 listSeries 文件夹中。



3. 将 U 盘插入仪器前面板。(USB 端口选择要设为前面板 USB.)
4. 在 Menu 菜单界面中点击**复杂波形**，进入 ARB 主界面。
5. 点击屏幕上的**打开**键，进入 ARB 调用界面。
6. 点击 **U 盘**，选择 **U 盘**里的 8.csv 文件，点击**打开**键确认。即完成该 ARB 文件的导入。
7. 按前面板**[On/Off]**键，开启电源输出。
8. 在 ARB 界面中点击**运行**。
9. 根据已设置的触发方式，触发 ARB 文件的运行。

以面板触发为例，在前面板按下**[Shift]+[5](Trigger)**，被选中的 ARB 文件开始运行。

通过 SCPI 指令编程

详细的指令和参数介绍，请参见编程指南中 ARB 子系统的指令。

通过上位机软件 PV6600 实现

详细的功能使用，请参见 PV6600 用户手册。

4.4 电池充电测试

本系列电源具备充电测试功能，适用于对各类便携式电池进行充电测试。

警告

- 连接待测物（电池/电容）时，请勿使电池/电容短路。
- 执行电池测试前，您需要将 Sense 线连接到电池两端，如果未接 Sense 线，则仪器无法检测到 Sense 电压，提示 Wait Sense Link!, 无法运行电池测试。

电池充电功能

1. 在 Menu 菜单界面中点击**电池测试**，进入电池充/放电功能页面。



参数	功能说明
模式	模式选择：充电（电池充电模式）。
充电电压	电池充电电压
充电电流	电池充电电流
截止时间	电池充电的截止时间
截止电压	电池测试截止的电压。
截止电流	电池测试截止的电流。
截止容量	电池测试截止的容量。
截止电能	电池测试截止的电能。
运行时间	测试运行时间
按钮说明	
运行/停止	启动/停止 Battery 运行。
打开	调取 Battery 文件。
保存	保存当前编辑的 Battery 文件，可以保存到仪器内存或外部 U 盘中。

2. 设置电池充电相关参数，按**保存**键保存。
3. 按前面板**[On/Off]**键，开启电源输出。
4. 在 Battery 界面中点击**运行**。

5. 按下前面板**[Shift]+[5](Trigger)**键，触发电池充电测试的运行。
6. 点击**停止**，停止当前的运行。

第五章 系统功能

5.1 系统菜单概览

按[Shift] + [P-set] (System) 进入系统菜单功能页面，此时 LCD 显示出可选择菜单，使用上下左右键或触摸方式进行选择与编辑。具体菜单项如下所示。

源配置：

源配置	输出模式	设置输出模式。	
		模式	● 串联: 配置仪器为 2 个通道串联模式。 ● 并联: 配置仪器为 2 个通道并联模式。 ● 双通道: 配置仪器为 2 个通道独立输出模式。当机器的输出模式被配置双通道时，可以进一步配置两个通道的同步参数。
		同步	● 打开: 开启 2 个通道同步模式。 ● 关闭: 关闭同步模式。
		同步模式	同步模式
			跟踪: 设置 2 个通道之间 On/Off 同步且电压设置值成比例变化。 ● 关联: 设置 2 个通道之间电压值的变化比例关系。
			输出状态: 表示 2 个通道之间，仅输出 On/Off 同步。
			全同步: 表示 2 个通道的参数完全同步。
	远端测量	Sense 测量功能设置。	
		状态	● 打开: 开启远端量测功能。 ● 关闭: 关闭远端量测功能。
	输出电压归零	用于控制当输出关闭后是否将电压快速归零。	
		状态	● 打开: 是 ● 关闭: 否
	外部模拟量	外部模拟量控制功能。（当选配外部模拟量接口时才可设） 详细的菜单以及功能介绍请参见 5.10 外部模拟量测试功能。	
	测量	测量速度设置	
		低速	低速，每 200ms 测量一次。
		中速	中速，每 100ms 测量一次。
		高速	高速速，每 20ms 测量一次。
	功率单位设置	设置功率单位：瓦或千瓦。	

通用配置和通信：

通用配置	声音设置	设置蜂鸣器的状态。	
		按键声音	设置按键蜂鸣器开关。
		预警声音	设置警告状态蜂鸣器开关。
		保护声音	设置保护状态蜂鸣器开关。
	亮度	LCD 屏幕亮度设置。	
		1-10	设置亮度等级。
	出厂默认设置	恢复出厂值。	

		恢复	确认恢复出厂设置
	上电设置	设置仪器上电时的状态。	
		重置	初始化系统设置和状态。
		上一次	上次关机前的设置和状态。
		上一次+关闭	上次关机前的设置和输出关闭状态。
	并联设置	并联设置	
		角色	● 单机：单机模式 ● 主机：主机模式 ● 从机：从机模式
		个数	并机数量，包含主机。当角色设置为主机时显示。
	触摸功能	触摸屏功能锁	
		状态	打开或关闭触摸屏功能锁。
	旋钮立即生效	旋钮立即生效设置。设置为打开时，旋转旋钮后输出值立即生效。设置为关闭时，调节旋钮后，输出值只有在按 Enter 键确认后才会生效。	
	语言	语言设置	
		English	英文
		Chinese	中文
	软键盘	软键盘设置	
		打开	开启软键盘。当编辑框处于编辑状态时，会弹出软键盘。
		关闭	关闭软键盘
	悬浮按钮		
		打开	使用悬浮按钮进行全触摸操作。
		关闭	关闭悬浮按钮。
通信	USB 端口选择		
		后面板 USB：当前 USB 设备是用于通讯的通讯接口。	
		前面板 USB：当前 USB 设备是用于存储的外围设备。	
	USB 设备类型	USB 通信配置	
		VCP	虚拟串口协议通讯
		TMC	USB_TMC 协议通讯
	网络配置	LAN 通信配置	
		模式	● DHCP：自动配置IP地址等参数。 ● 手动：手动配置IP地址等参数。
		IP	IP 地址配置
		子网掩码	子网掩码配置
		网关	网关配置
		端口	Tcp 端口号配置
	串口配置	串口通信配置（只有选配 IT-E177 接口卡时显示）	
		波特率	串口通信波特率
		数据位	数据 bit 位
		停止位	停止 bit 位
		奇偶校验	奇偶校验位
		地址	地址
	GPIB 配置	GPIB 通信配置（只有选配 IT-E176 接口卡时显示）	
		地址	GPIB 地址配置

	CAN 配置	CAN 通信配置。	
		协议	协议类型 ● Canopen: CAN 总线的高级协议。 ● CAN2.0: ITECH CAN2.0 版本协议。
		地址	地址
		波特率	波特率

数字 IO 和信息：

数字 IO	引脚 1: 保护清除	设置数字 I/O 功能，详细的菜单以及功能介绍请参见 5.9 数字 I/O 功能 。
	引脚 2: 保护状态	
	引脚 3: 输出状态	
	引脚 4: 触发功能	
	引脚 5: 远端禁止输入	
	引脚 6: 同步打开	
	引脚 7: 同步关闭	
信息	产品型号	产品型号
	序列号	SN 序列号
	软件版本	软件版本
	MAC 地址	MAC 地址
	Rbf 版本	Rbf 版本
	控制板 1 版本	Ctrl1 版本
	控制板 2 版本	Ctrl2 版本
	内环数量	内环并机数量
	开机时间	机器开机时间
	当前输出时间	机器当前输出时间。
	输出时间	可查看机器历史输出时间。

设置蜂鸣器声音

用户可根据需要对本仪器的蜂鸣器提示音的类型和开/关进行自定义设置。

- 若菜单中选择**按键声音**为**打开**选项时，有按键按下时蜂鸣器鸣叫；若为**关闭**选项时，蜂鸣器不鸣叫。出厂设置为**打开**选项。
- 若菜单中选择**保护声音**为**打开**时，当发生保护时蜂鸣器鸣叫；若为**关闭**选项时，蜂鸣器不鸣叫。出厂设置为**打开**选项。
- 若菜单中选择**预警声音**为**打开**时，当发生警告时蜂鸣器鸣叫；若为**关闭**选项时，蜂鸣器不鸣叫。出厂设置为**打开**选项。

屏幕亮度设置

该菜单项可以设置屏幕的亮度。可通过按取前面板的数字键设置，设置的范围为 1~10，数字越大表示屏幕亮度越高，也可以通过旋转前面板旋钮进行设置。默认设置为 **5**。

恢复出厂设置

该菜单项用于将机器的各项设置恢复为出厂默认值。

1. 在系统菜单中选择**通用配置**。
2. 点击**出厂默认设置**菜单项下的**恢复**。

电源开机参数设定

该菜单项可以设置电源重新上电后参数。

1. 在系统菜单中选择**通用配置**。
2. 点击**上电设置**菜单项的下拉框设置电源开机参数。
 - **重置**：默认值，表示仪器开机上电时显示出厂默认值。
 - **上一次**：设置为该值，表示仪器在开机上电时显示上次关机前的参数设置和输出状态。
 - **上一次+关口**：设置为该值，表示仪器在开机上电时显示上次关机前的参数设置，且输出状态为**关闭**。

旋钮功能设置

旋钮设定值立即生效设置，若设置为**打开**，则旋钮设定值立即生效，若设置为**关闭**，则旋钮设定完成后，需要按**[Enter]**键确认才生效。

语言选择

用户可以在菜单中选择当前仪器使用的语言类型。

软键盘设置

用户可以在菜单中开启软键盘，当该参数设置为**打开**时，在界面上设置参数时，会出现触摸屏的数字键盘。方便用户直接选择数字进行设置。

5.2 配置菜单概览

按**[Shift] + [V-set] (Config)**键，进入配置菜单页面。在此界面，用户可以设置电源输出参数，详细参数如下所示。

参数配置	配置菜单		
	优先模式	CC/CV 优先权选择	
		模式	模式选择
			恒定电压: CV 环路优先。
			恒定电流: CC 环路优先。
		环路速度	设置环路响应速度。
			高速
			中速
			低速
	斜率设置		
		模式	选择斜率单位。
			时间: 用时间来描述设备的斜率。
			标准斜率: 单位为 V/ms 或 A/ms。
		电压上升/电流上升	根据选择的优先模式，显示电压/电流的上升斜率设置。如选择CC优先模式，此处将显示 电流上升 的参数设置。

		电压下降/电流下降	根据选择的优先模式，显示电压/电流的下降斜率设置。如选择CC优先模式，此处将显示 电流下降 的参数设置。
	输出耦合模式	设置输出耦合模式。	
		模式	
			直流: 直流模式
	输出电阻	设置电源内阻值。(该项仅在CV优先时显示)	
	打开/关闭延迟		
		打开延迟	设置开启输出的延迟时间。
			延迟偏置: 设置输出延时偏置时间。
		关闭延迟	设置关闭输出的延迟时间。

5.3 键盘锁功能

可通过电源前面板复合按键 **[Shift] + [2]** (Lock) 键，锁定电源前面板按键，此

时 LCD 上显示  图标。在此功能状态下，面板上的所有按键均无效。再次按复合按键 **[Shift] + [2]** (Lock) 键可以取消锁定。

5.4 切换本地/远程操作

用户可以通过 **[Shift] + [3]** (Local) 按键从远程模式切换到本地模式。

在电源上电后，电源供应器自动为本地操作模式。在本地操作模式下，所有的按键都可以被使用。当电源为远程操作模式时，**[Shift] + [3]** (Local) 键可用，可以触摸切换测量界面，面板其他按键均不起作用。本地操作模式切换到远程操作模式可以通过 PC 机来控制切换。当操作模式改变时，不会影响电源的输出参数。

5.5 存取操作

电源支持将一些常用的参数分别保存在 100 组 (编号 1~100) 非易失性存储器中。

保存数据包括:

- 当前操作模式和输出参数
- 参数配置菜单中的所有设置值

存储操作

将参数保存到存储器中，操作方法如下:

1. 按复合按键**[Shift]+[4](Save)**，进入参数保存界面。
2. 选择存储位置，总共可以选择 100 个存储位置。



3. 按存储，参数保存。

保存完成，界面右方会显示当前保存的详细参数。

调用操作

将保存在存储器中的数据取出并作为当前设置值使用。

1. 按[Recall]键，进入参数调用界面。
2. 选择参数存储位置。

转动旋钮或直接触摸或按方向键选择文件名称，选择后，界面下方会显示当前文件中存储的详细参数信息。



3. 按选中，参数被调用。

5.6 截屏功能

本系列电源提供截屏功能，在仪器前面板的 USB 接口中插入 USB 存储设备，电源前面板按[Print] 键，将当前屏幕图片截图并保存到 USB 外围设备存储盘中。

当你需要截屏功能时，系统菜单中的 **USB 端口选择** 需要设置为 **前面板 USB**。

5.7 系统日志查询功能

本系列电源提供仪器系统日志查询功能，在仪器前面板的 Menu 菜单界面中点击日志或直接按 **[Shift]+[1](Log)**，进入系统日志查询界面。在该界面可以查看系统历史操作记录。

5.8 多机操作


5.8.1 串联操作(单台)

本系列电源可以通过串联一台仪器的两个通道来增加输出电压和功率。串联时，电压设置范围的上限为单通道额定值的两倍，此时仪器作为单通道电源使用。


操作步骤

1. 设置电源的两个通道为**串联**模式。
 - a) 在前面板按下复合按键 **[Shift] + [P-set] (System)** 进入系统菜单界面。
 - b) 选择**源配置**页签，再通过上下键或转动旋钮，找到菜单项**输出模式**。
 - c) 按上下方向键，将光标移动至**模式**功能设置处，并按 **[Enter]** 键确认。旋转旋钮，设置**串联**输出模式，并按 **[Enter]** 键确认。
2. 参考下图连接待测物，禁止带电接线。

- 本地量测

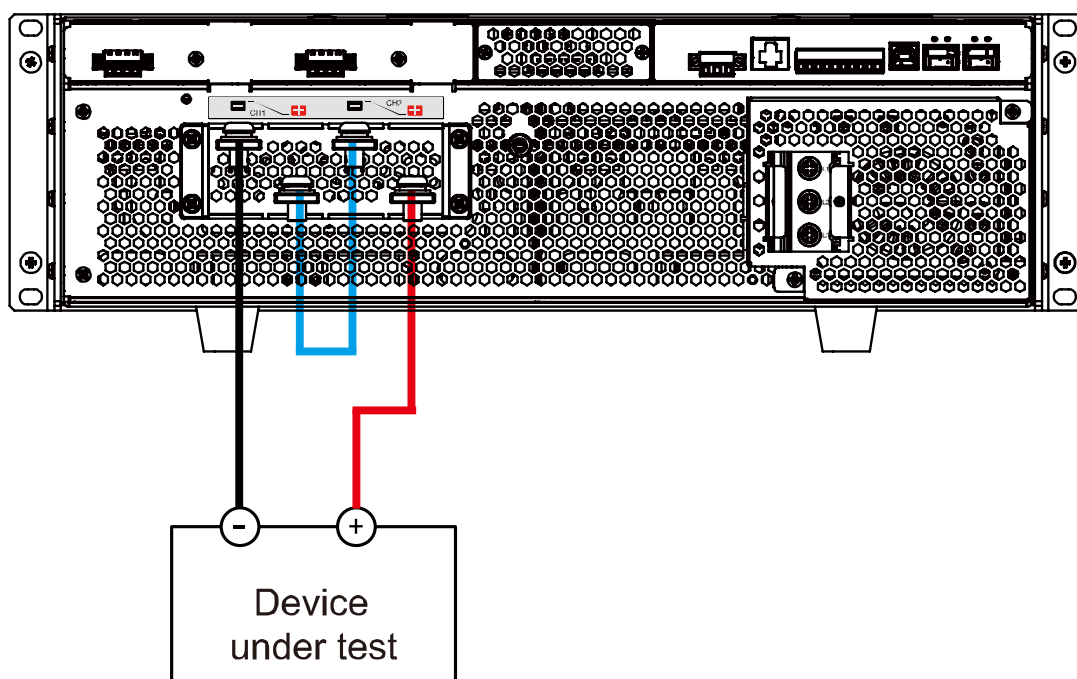

- 远端量测

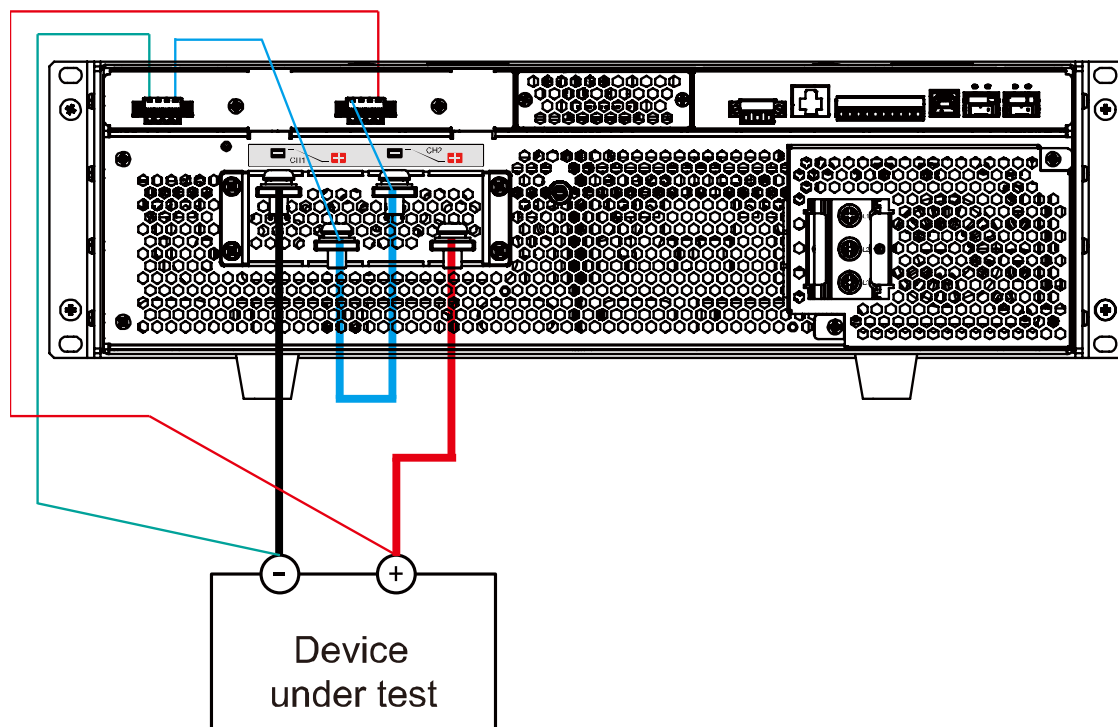


5.8.2 并联操作(单台)


本系列电源可以通过并联一台仪器的两个通道来增加输出电流和功率。并联时，电流设置范围的上限为单通道额定值的两倍，此时仪器作为单通道电源使用。

操作步骤

1. 设置电源的两个通道为**并联**模式。
 - a) 在前面板按下复合按键[Shift] + [P-set] (System)进入系统菜单界面。
 - b) 选择**源配置**页签，再通过上下键或转动旋钮，找到菜单项**输出模式**。
 - c) 按上下方向键，将光标移动**模式**功能设置处，并按[Enter]键确认。旋转旋钮，设置**并联**输出模式，并按[Enter]键确认。
2. 参考下图连接待测物，禁止带电接线。
 - 本地量测

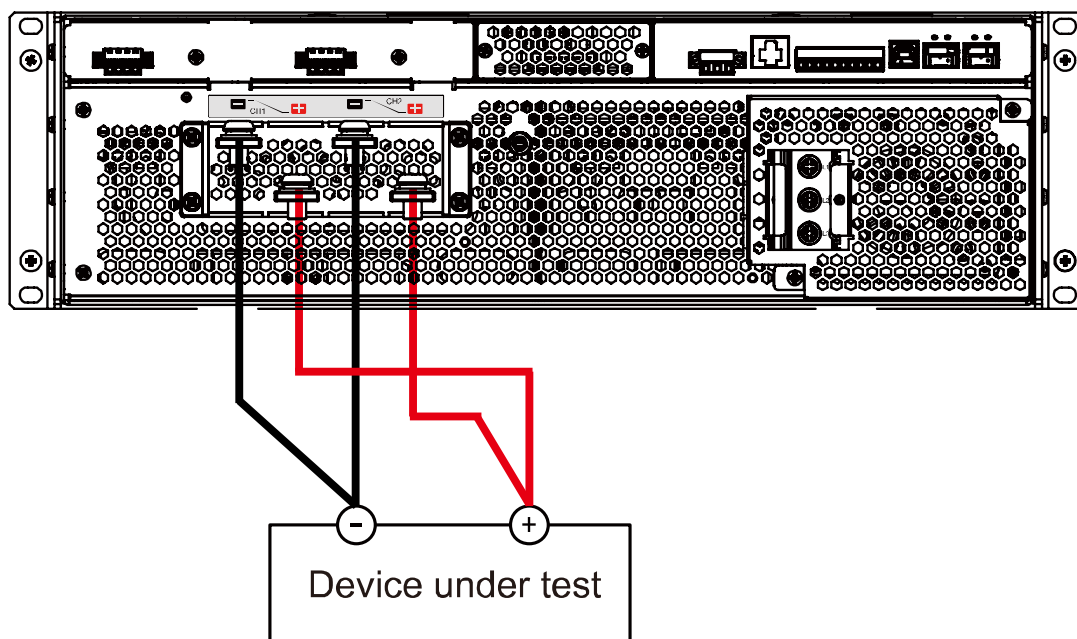

● 远端量测

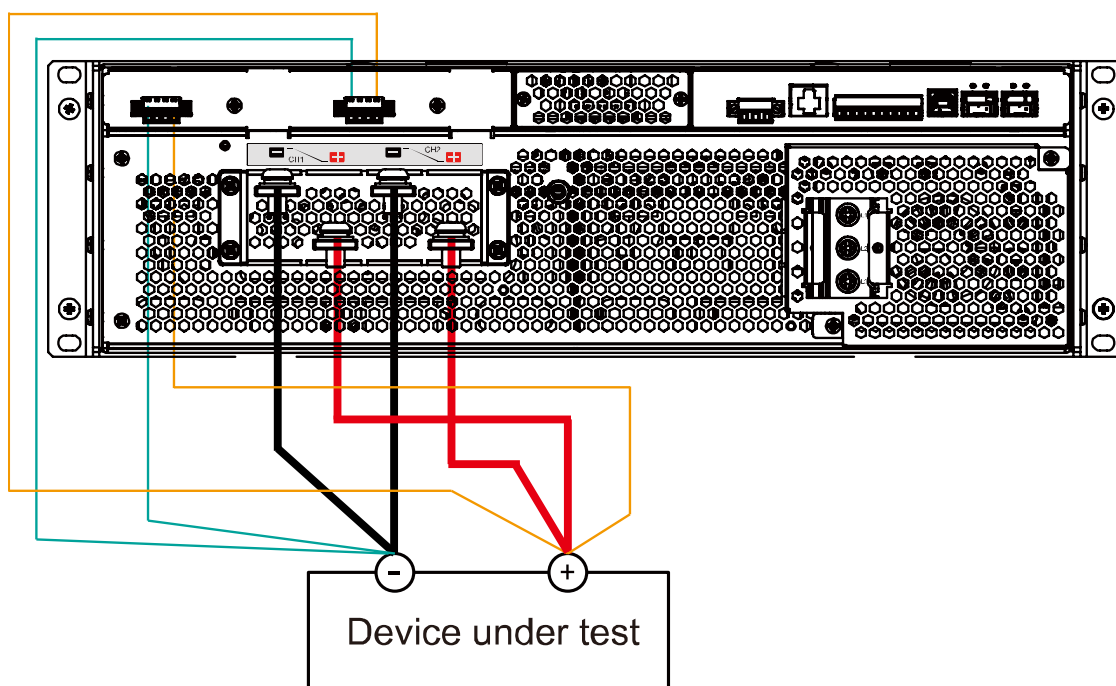

5.8.3 并联操作(多台)

本系列电源支持多台仪器以并联，以提供更大功率和电流的输出能力。并联模式下，用户仅需操作主机即可，通过操作主机实现对其他从机的同步操作。

本章节以 3 台带有操作面板的仪器并联为例，介绍如何将单机实现并联，以及如何从并联模式恢复为单机模式。


设置并联模式

警告


- 在连接线路时，请务必确保仪器电源开关处于关闭状态，且 AC 电源输入端总开关为关闭状态。

- 将多台仪器分别接入交流配电箱之前，请务必确保配电箱容量足够。单机的AC输入参数详见对应型号的规格书。
- 连接系统总线之前，必须保证每台仪器为单机模式。
- 光纤线缆不能被强力弯曲和折叠。当线束过长需要整理时，请轻轻将线束环绕成圆形，再进行绑扎。



1. 确保 3 台单机的电源开关以及交流配电箱的总开关为关闭状态。
2. 按下图接线方式布线。
 - 在双通道模式下，接线示意图如下。

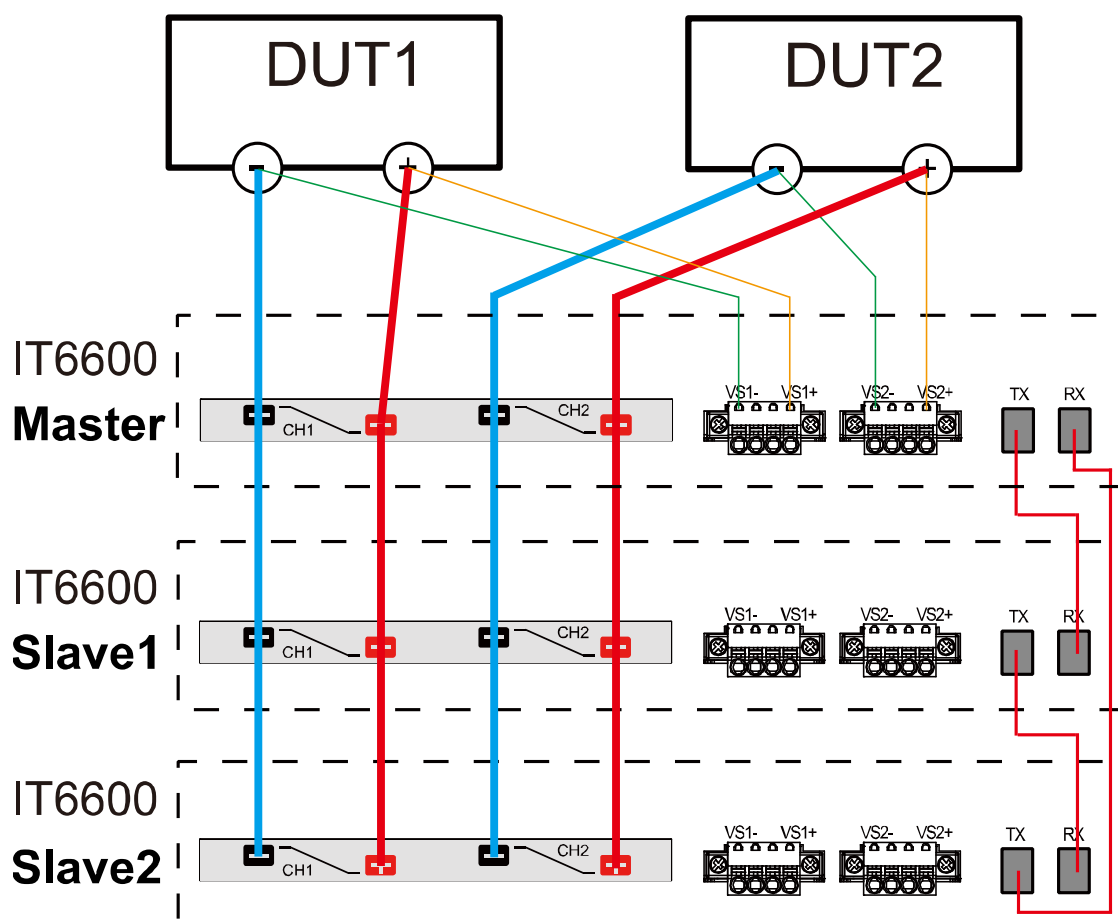


- 在串联模式下，接线示意图如下。

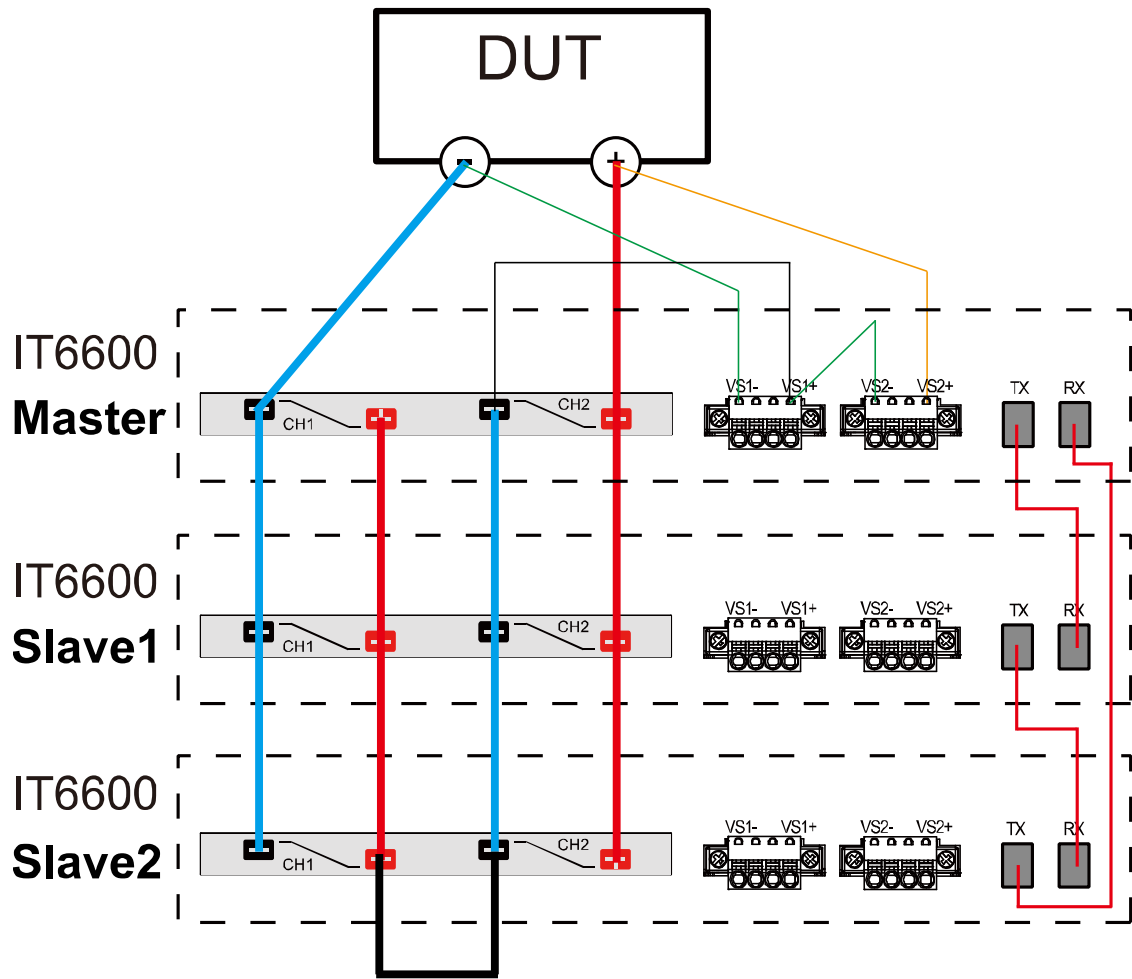

- 在并联模式下，接线示意图如下。

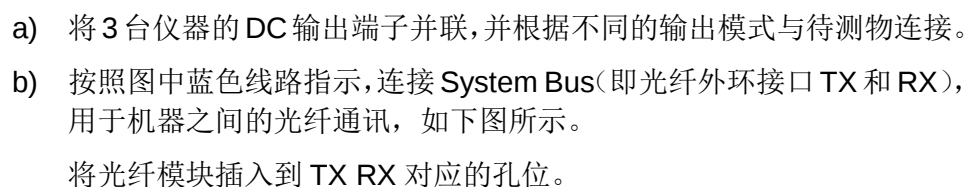

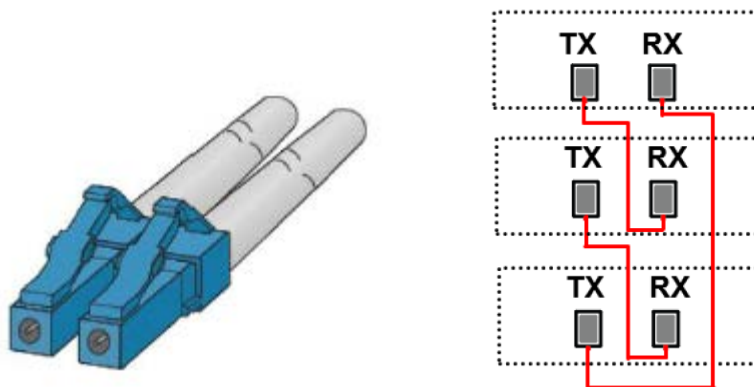

3. 按上图布线完成后，配置一台电源作为主机（Master），其他电源作为从机（Slave）。
 - a) 在前面板按下复合按键[Shift] + [P-set] (System)进入系统菜单界面。
 - b) 通过上下键或转动旋钮，找到菜单项通用配置->并联设置。
 - c) 设置角色参数，将仪器设置为主机或从机，每个并联关系中，只能存在一个主机，多个从机，根据需要确定主从关系。
 - 单机：默认值，表示仪器为单机模式。
 - 主机：表示将当前单机设置为并联模式中的主机。
个数：表示并联关系中的机器总数，当仪器角色设置为主机时，还需要设置该参数，例如 3 台并联，个数设置为 3。
 - 从机：表示将当前单机设置为并联模式中的从机。
 - d) 按[Esc]键，退出菜单界面。
4. 主从设置完成后，需重启电源才能正常工作。

恢复为单机模式

若用户希望将并机模式改为单机模式，可执行如下步骤：

1. 分别将 3 台设备切换为单机模式。
 - a) 在前面板按下复合按键[Shift] + [P-set] (System)进入系统菜单界面。
 - b) 通过上下键或转动旋钮，找到菜单项通用配置->并联设置。
 - c) 设置角色参数，将仪器设置为单机模式。
2. 分别将 3 台仪器关机下电，并关闭交流配电箱的总开关。
3. 拆除仪器之间的 System Bus、输出端子的线路连接。
4. 分别将 3 台仪器开机上电。此时 3 台仪器工作在单机模式。

5.8.4 并联操作(1 主多从)

“一主 N 从”是指并机系统中仅有一台带有操作面板的仪器（即主机），其他均为不带操作面板的仪器（即从机）。在“一主 N 从”系统中，您只需操作主机的前面板即可。


本章节以 3 台仪器为例，介绍 1 主 2 从的并联步骤。其他数量仪器的并机，其种类和组装方法相同。

警告


- 在连接线路时，请务必确保仪器电源开关处于关闭状态，且 AC 电源输入端总开关为关闭状态。
- 将多台仪器分别接入交流配电箱之前，请务必确保配电箱容量足够。单机的 AC 输入参数详见对应型号的规格书。
- 光纤线缆不能被强力弯曲和折叠。当线束过长需要整理时，请轻轻将线束环绕成圆形，再进行绑扎。

1. 确保主机的电源开关以及交流配电箱的总开关为关闭状态。
2. 按下图接线方式布线。


- 在双通道模式下，接线示意图如下。

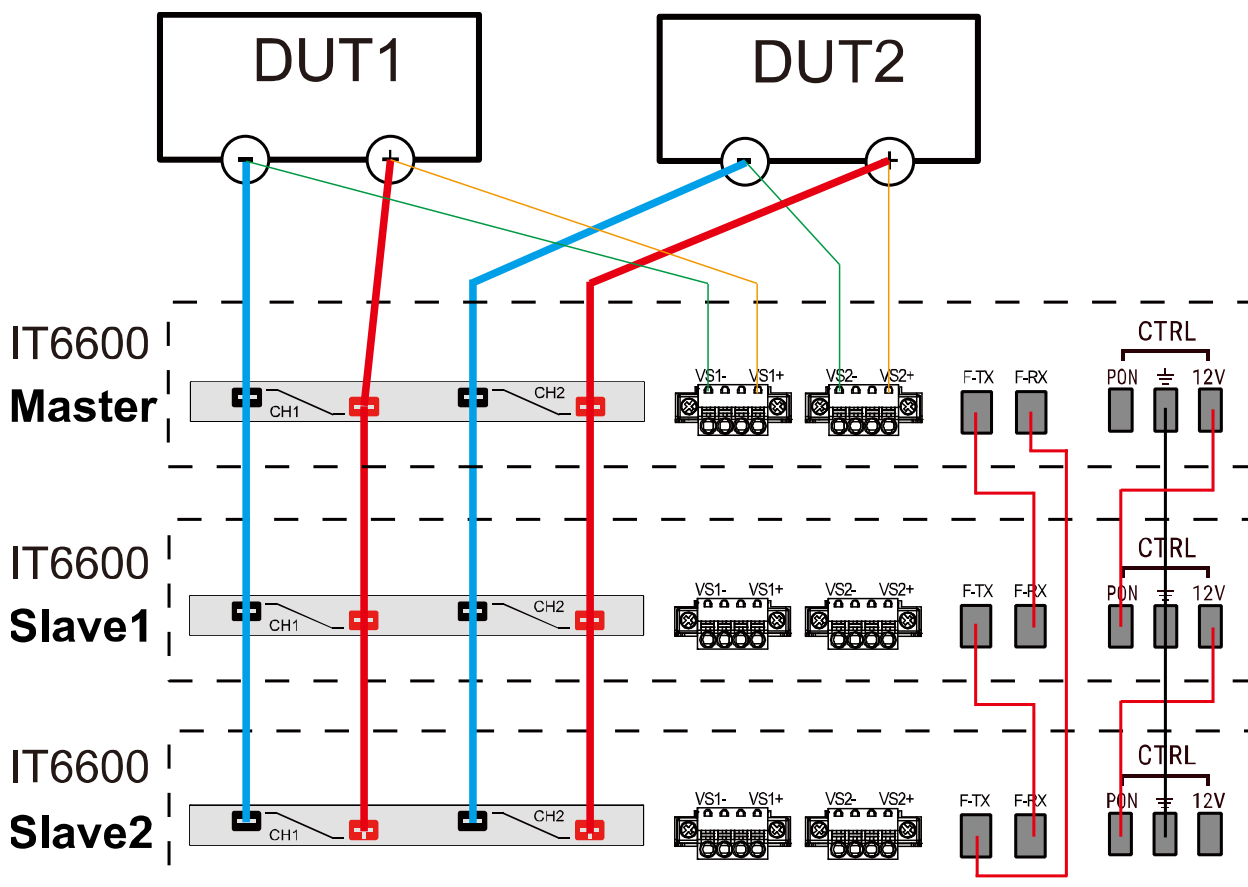

- 在串联模式下，接线示意图如下。

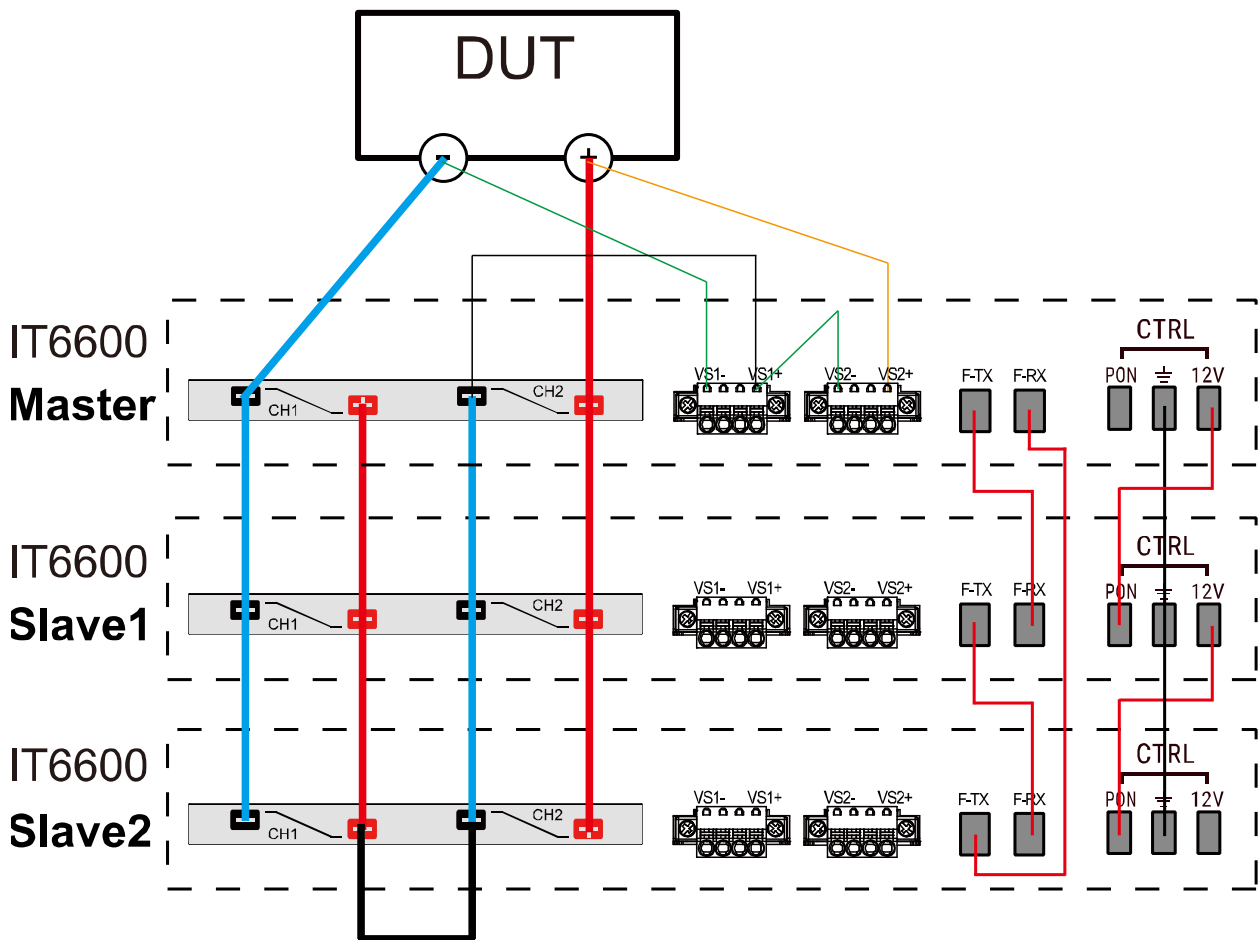

- 在并联模式下，接线示意图如下。

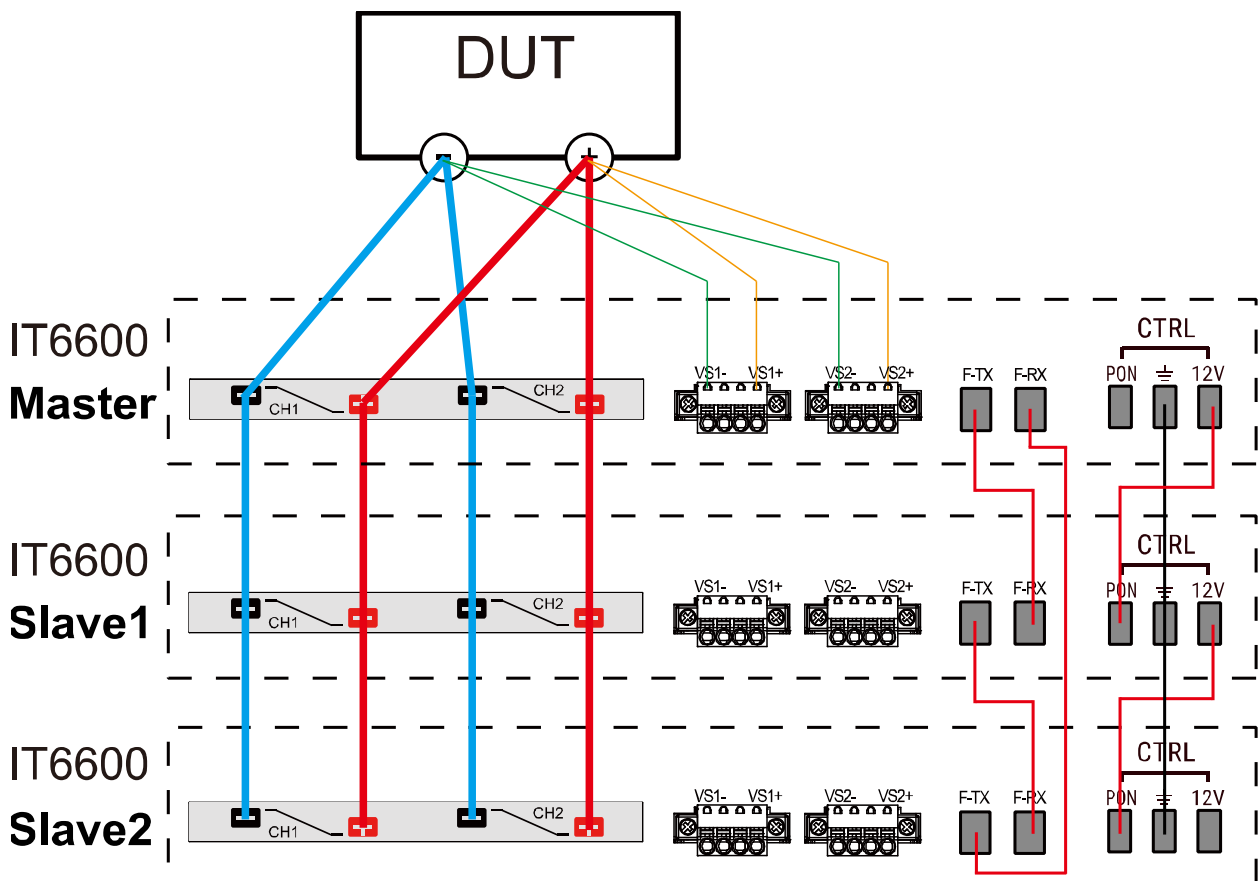


- a) 将 3 台仪器的 DC 输出端子并联, 并根据不同的输出模式与待测物连接。
- b) 连接控制线。

接线规则为: 第一台单机的 GND/12V 连接到第二台的 GND/PON, 第二台单机的 GND/12V 连接到第三台的 GND/PON, 以此类推, 直到连接至最后一台。

- c) 按照图中线路指示, 连接 System Bus(即光纤内环接口 F-TX 和 F-RX), 用于机器之间的光纤通讯。

将光纤模块插入到 F-TX、F-RX 对应的孔位。将光纤线的插头插入到光纤模块中, 听到咔哒声音表示插入到位。

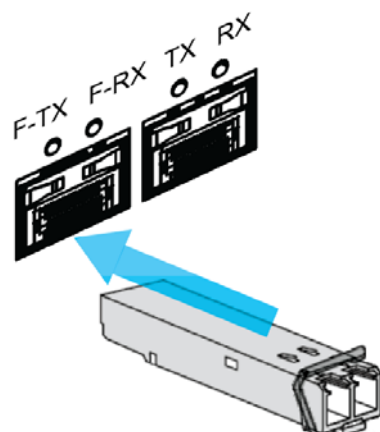

3. 配置主从。

- a) 打开主机前面板上的电源开关。
- b) 在前面板按下复合按键[Shift] + [P-set] (System)进入系统菜单界面。
- c) 通过上下键或转动旋钮, 找到菜单项通用配置->并联设置。

设置角色参数, 将主机设置为单机模式。

- d) 在信息界面, 按下[Shift] + [,] + [3] + [8]的组合按键。

设置内环并机数量, 如 Inner Number = 3, 并按[Enter]。

- e) 关闭主机前面板上的电源开关, 待彻底关机之后, 再重新打开电源开关。

4. 仪器重新启动后, 并机操作才算真正完成。


5.8.5 并联操作(机柜机型)

对于机柜机型的单机, 相同电压等级的单机可以进行并联。以 2 个 15U (带操作面板) 的单机为例, 并联操作的步骤如下。


警告

- 在连接线路时, 请务必确保仪器电源开关处于关闭状态, 且 AC 电源输入端总开关为关闭状态。
- 将多台仪器分别接入交流配电箱之前, 请务必确保配电箱容量足够。单机的 AC 输入参数详见对应型号的规格书。
- 连接系统总线之前, 必须保证每台仪器为单机模式。
- 光纤线缆不能被强力弯曲和折叠。当线束过长需要整理时, 请轻轻将线束环绕成圆形, 再进行绑扎。


1. 确保 2 个机柜的电源开关以及交流配电箱的总开关为关闭状态。
2. 按下图接线方式布线。
 - 在双通道模式下，接线示意图如下。

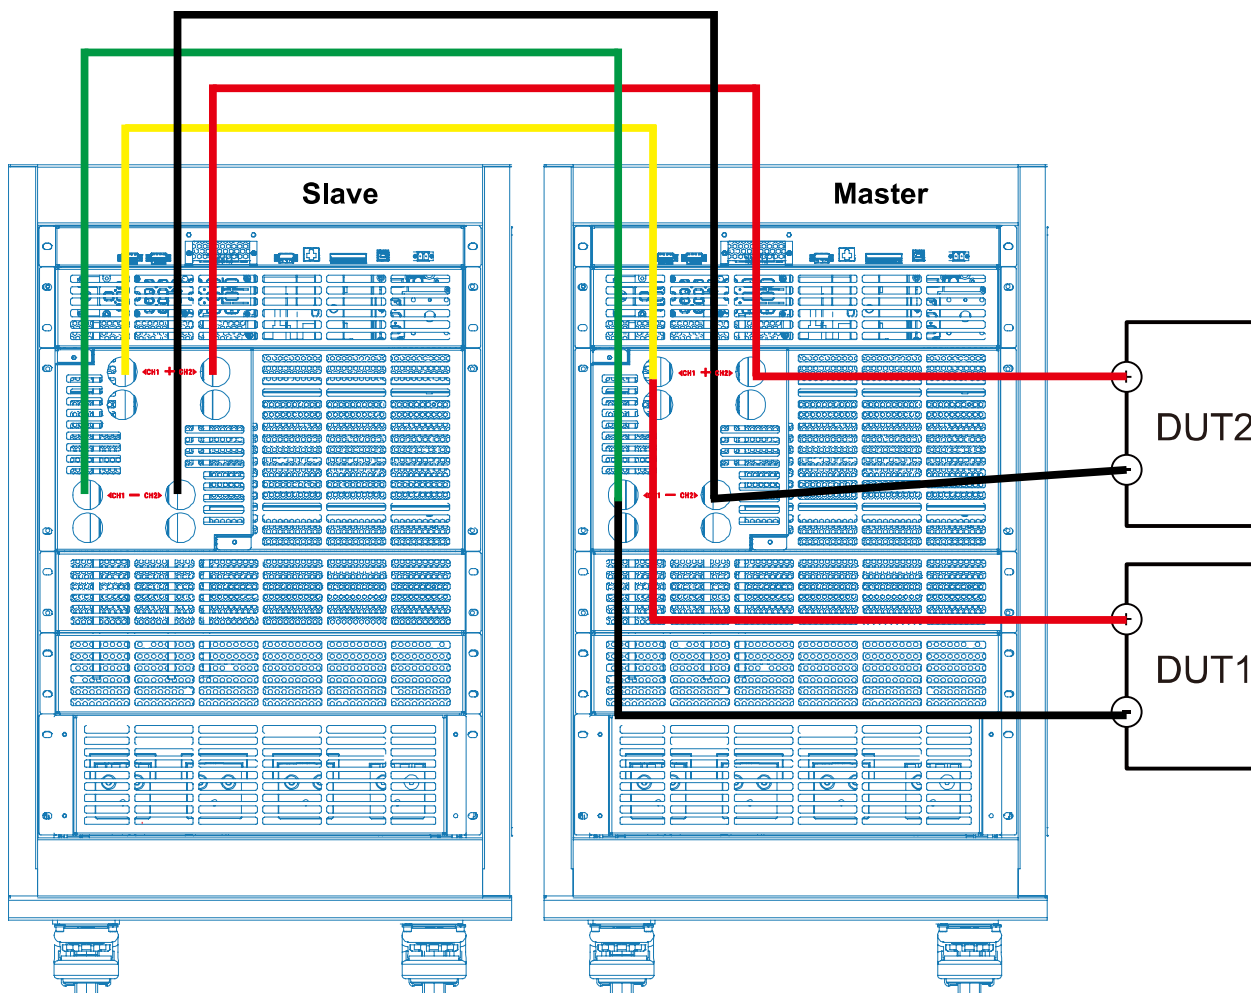

- 在串联模式下，接线示意图如下。

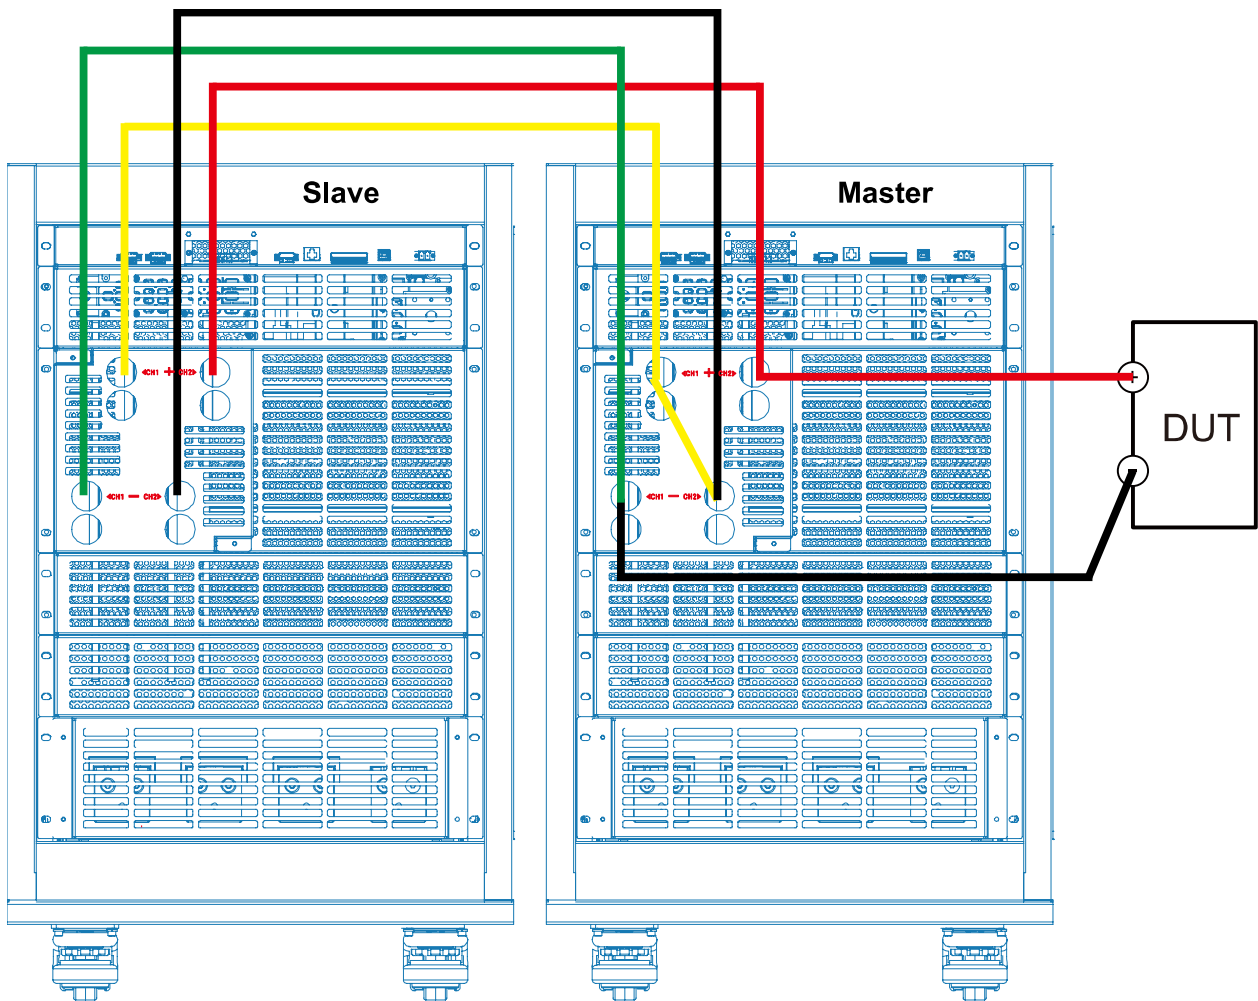


- 在并联模式下，接线示意图如下。


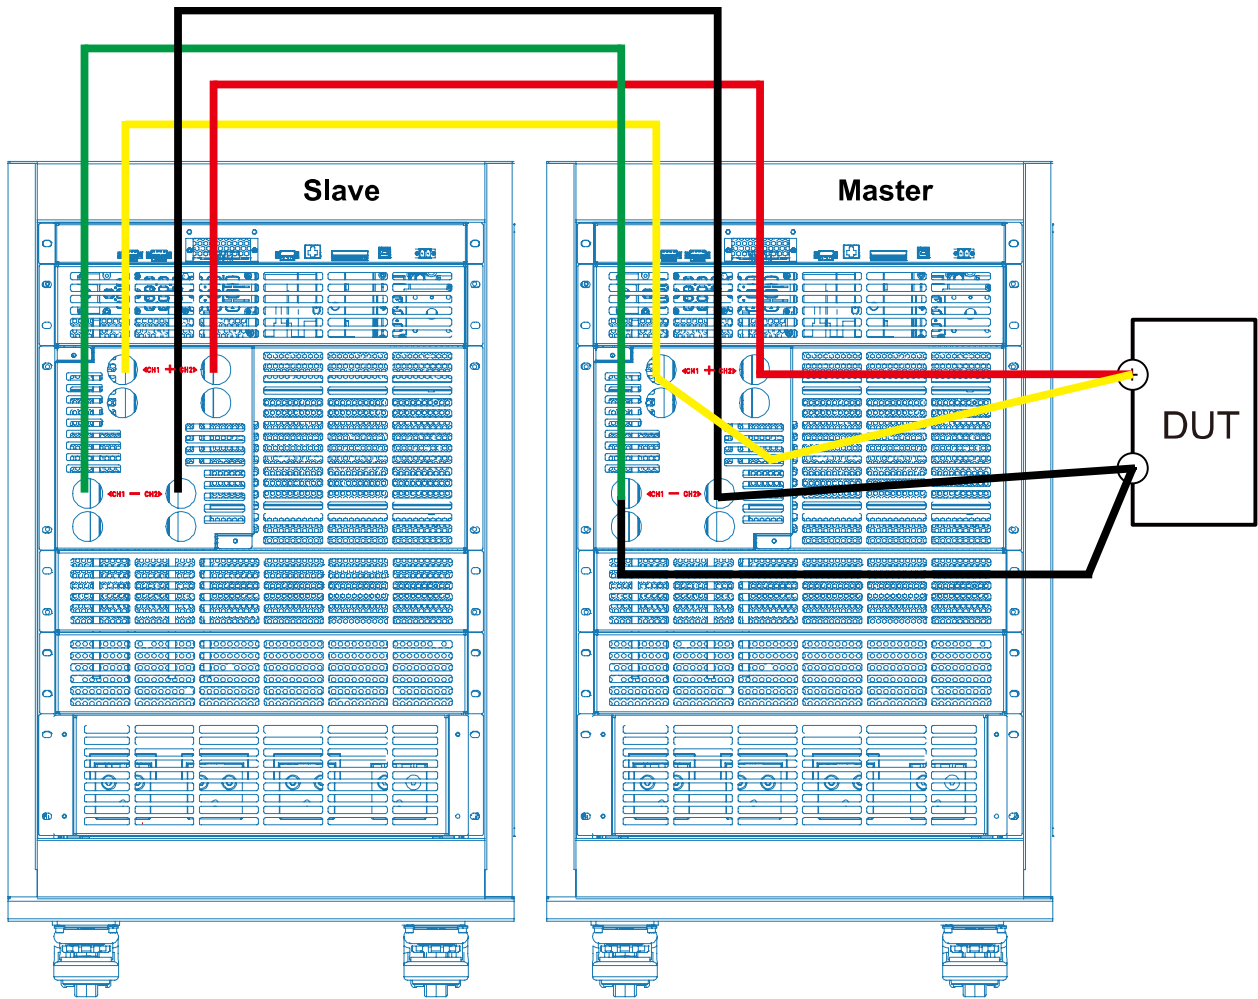


- a) 将 2 台机柜的 DC 输出端子并联, 并根据不同的输出模式与待测物连接。
- c) 按照下图, 连接 System Bus (即光纤外环接口 TX 和 RX), 用于机柜之间的光纤通讯, 如下图所示。

将光纤模块插入到 TX RX 对应的孔位。

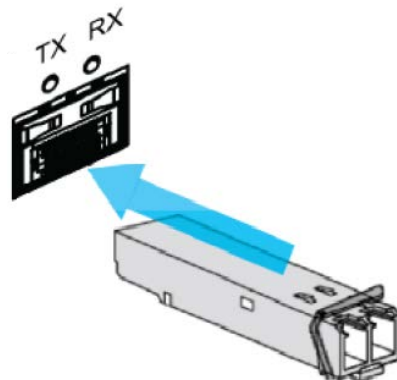


将光纤线的插头插入到光纤模块中, 听到咔哒声音表示插入到位。光纤线连接示意图如下:

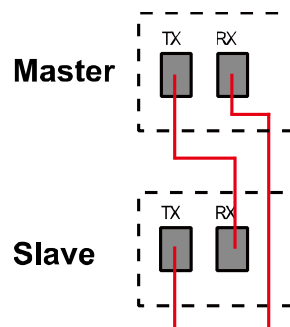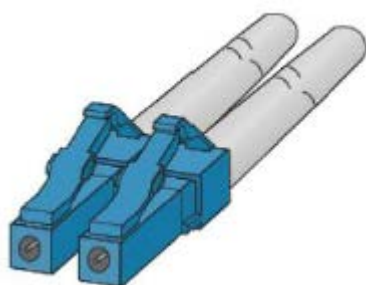

3. 按上图布线完成后，配置一台机柜作为主机（**Master**），其他机柜作为从机（**Slave**）。
 - a) 在前面板按下复合按键[Shift] + [P-set] (System)进入系统菜单界面。
 - b) 通过上下键或转动旋钮，找到菜单项**通用配置->并联设置**。
 - c) 设置**角色**参数，将机柜设置为主机或从机，每个并联关系中，只能存在一个主机，多个从机，根据需要确定主从关系。
 - **单机**：默认值，表示机柜为单机模式。
 - **主机**：表示将当前单机设置为并联模式中的主机。
个数：表示并联关系中的机柜总数，当机柜角色设置为**主机**时，还需要设置该参数，例如 2 台并联，**个数**设置为 2。
 - **从机**：表示将当前单机设置为并联模式中的从机。
 - d) 按[Esc]键，退出菜单界面。
4. 依次关闭机柜前面板上的电源开关，待彻底关机之后，再重新打开电源开关。
机柜重新启动后，并机操作才算真正完成。

5.9 数字 I/O 功能

本系列电源支持数字 I/O 功能，用户可通过系统菜单中的相关配置项，实现对信号输入或输出的逻辑控制。端子外观如下图所示。

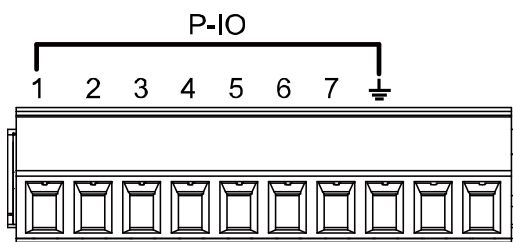

5.9.1 数字 I/O 引脚定义

数字控制端口由 7 个 I/O 针脚组成，用于实现各种控制功能。用户可对每个针脚进行配置。

以 3 号引脚为例，IO-3 包含 3 种功能选项，其中第一个功能选项**输出状态**为默认功能，也是该引脚独有的特殊定制功能（7 个引脚各自对应一个定制功能）；第二、第三选项（**Input** 和 **Output**）为通用的数字 I/O 功能，且 7 个引脚对应的参数设置、功能相同。

数字 IO 引脚参数说明

按下[Shift] + [P-set] (System)，进入系统菜单功能页面，然后选择 IO 页签，进行相关参数的设置。

IO	引脚 1: 保护清除	数字 IO-1 的功能设置	
	功能	反向	打开/关闭，选择信号是否反转。若选择打开，则使能信号进行反转。
		功能	● 保护清除：默认的功能项，表示当仪器产生保护时，通过该引脚对保护状态进行清除。 ● 输入：由外部向 1 号引脚输入数字信号对应的电平。 ● 输出：由 1 号引脚向外部输出数字信号（1,0）对应的电平。 ● PWM：由 1 号引脚向外部输出 PWM 信号。
	引脚 2: 保护状态	数字 IO-2 的功能设置	
	功能	反向	打开/关闭，选择信号是否反转。若选择打开，则使能信号进行反转。
		功能	● 保护状态：默认的功能项，表示由 2 号引脚的输出电平显示仪器是否处于保护状态。 ● 输入：由外部向 2 号引脚输入数字信号对应的电平。 ● 输出：由 2 号引脚向外部输出数字信号（1,0）对应的电平。 ● PWM：由 2 号引脚向外部输出 PWM 信号。
		通道 (仅功能设置为保护状态时显示)	● CH1：将配置应用于 CH1。 ● CH2：将配置应用于 CH2。 ● CH1&CH2：将配置应用于 CH1 和 CH2。
	引脚 3: 输出状态	数字 IO-3 的功能设置	
	功能	反向	打开/关闭，选择信号是否反转。若选择打开，则使能信号进行反转。
		功能	● 输出状态：默认的功能项，用于指示仪器当前的[On/Off]状态。 ● 输入：由外部向 3 号引脚输入数字信号对应的电平。 ● 输出：由 3 号引脚向外部输出数字信号（1,0）对应的电平。
		通道 (仅功能设置为输出状态时显示)	● CH1：将配置应用于 CH1。 ● CH2：将配置应用于 CH2。 ● CH1&CH2：将配置应用于 CH1 和 CH2。
	引脚 4: 触发功能	数字 IO-4 的功能设置	
	功能	反向	打开/关闭，选择信号是否反转。若选择打开，则使能信号进行反转。
		功能	● 触发输出：将 IO-4 配置为触发输出，并开启 List 的触发输出。当 List 被触发运行时，IO-4 将输出一个脉冲

			信号。 ● 输入触发：将示波功能、数据记录 and List 功能的触发源配置为外部。当仪器接收来自外部的脉冲信号后，将会触发示波功能、数据记录或List功能的运行。 ● 输入：由外部向 4 号引脚输入数字信号对应的电平。 ● 输出：由 4 号引脚向外部输出数字信号（1,0）对应的电平。
		通道 (仅功能设置为触发时显示)	● CH1：将配置应用于 CH1。 ● CH2：将配置应用于 CH2。 ● CH1&CH2：将配置应用于 CH1 和 CH2。
	引脚 5：远端禁止输入	数字 IO-5 的功能设置	
		反向	打开/关闭，选择信号是否反转。若选择打开，则使能信号进行反转。
		功能	● 禁止输出-自动：电源以Living方式进行工作。 ● 禁止输出-锁定：电源以Latch方式进行工作。 ● 输入：由外部向 5 号引脚输入数字信号对应的电平。 ● 输出：由 5 号引脚向外部输出数字信号（1,0）对应的电平。
		通道 (仅功能设置为禁止输出时显示)	● CH1：将配置应用于 CH1。 ● CH2：将配置应用于 CH2。 ● CH1&CH2：将配置应用于 CH1 和 CH2。
	引脚 6：同步打开	数字 IO-6 的功能设置	
		反向	打开/关闭，选择信号是否反转。若选择打开，则使能信号进行反转。
		功能	● 同步On：默认的功能项，表示由6号引脚对仪器[On/Off]的打开进行双向的同步控制。 ● 输入：由外部向 6 号引脚输入数字信号对应的电平。 ● 输出：由 6 号引脚向外部输出数字信号（1,0）对应的电平。
	引脚 7：同步关闭	数字IO-7的功能设置	
		反向	打开/关闭，选择信号是否反转。若选择打开，则使能信号进行反转。
		功能	● 同步Off：默认的功能项，表示由7号引脚对仪器[On/Off]的关闭进行双向的同步控制。 ● 输入：由外部向 7 号引脚输入数字信号对应的电平。 ● 输出：由 7 号引脚向外部输出数字信号（1,0）对应的电平。

信号定义：

数字 I/O 功能涉及输入电平和输出电平以及脉冲信号。输入信号是外部提供给 IT6600 的控制信号，输出信号是 IT6600 对外提供的电平信号，脉冲信号是高低电平之间切换的沿信号。引脚信号定义如下。

输入信号定义	高电平信号	典型值：5V 范围：1.6V-15V 电流：小于等于 100mA
	低电平信号	典型值：0V 最大值：-5V-0.8V 电流：小于等于 100mA
输出信号	高电平信号	电压 5V
	低电平信号	电压 0V
脉冲信号	电平上升斜率	10us
	电平下降斜率	1us
	维持时间	30us-500us

信号反转：

在 IO 设置菜单中可以选择是否反转(反向)，若选择**关闭**不反转，则默认的电平有效。若选择**打开**反转，则将有效信号进行反转。例如，IO-5 引脚默认为禁止输出功能，并且高电平有效，当选择信号反转后，低电平有效，仪器输出被禁止。

5.9.2 I/O 控制

通用 IO 功能

- 数字输入(Input)

IO-1~IO-7 针脚可以专门配置为数字输入。针脚 8 用作数字输入针脚的共用端。当将 1~7 号引脚配置为**输入**功能时，可以将外部信号输入到这些引脚，从而使仪器能够检测外部信号的状态。

- 数字输出(Output)

当 1~7 引脚配置为**输出**功能时，可输出高电平（False）和低电平（True）。

- PWM 输出

只有 IO-1 和 IO-2 引脚可以配置为 PWM 功能，此时可以通过这些引脚向外部设备输出 PWM 信号。在配置为 PWM 功能时，需要设置频率（Freq）和占空比（Duty）的值。

数字 IO-1 功能介绍

IO-1 可以被配置为**保护清除**、**输入**、**输出**、**PWM**

默认功能是**保护清除**清除保护，当机器产生保护时，通过该 IO 引脚对机器的保护进行清除，以便机器能继续正常输出使用。

数字 IO-2 功能介绍

IO-2 可以被配置为**保护状态、输入、输出、PWM**

默认功能是标识机器的保护状态（是否为保护状态）。此时 IO-2 为输出。端口悬空时，该 IO 口的电平为高电平，当产生了保护后，该 IO 口的电平会被拉低。清除保护之后，IO 口电平又会被拉高。

数字 IO-3 功能介绍

IO-3 可以被配置为**输出状态、输入、输出**

默认功能是用于指示机器当前的输出状态，逻辑电平 0 代表仪器处于 On 状态，逻辑电平 1 代表仪器处于 Off 状态。

数字 IO-4 功能介绍

IO-4 可以被配置为**输入触发、触发输出、输入、输出**

- **输入触发：**表示配置为触发输入，此时外部可以将脉冲信号送入 IO-4，作为机器的触发源。

将示波功能、数据记录和 List 功能的触发源配置为**外部**。当仪器接收来自外部的脉冲信号后，将会触发示波功能、数据记录或 List 功能的运行。

- **触发输出：**将 IO-4 配置为输出触发，并开启 List 的**触发输出**。当 List 被触发运行时，IO-4 将输出一个脉冲信号。

数字 IO-5 功能介绍

IO5 可以被配置为**禁止输出-自动、禁止输出-锁定、输入、输出**

默认功能是禁止机器输出。当 IO 引脚被配置为**禁止输出**功能且电平信号为低电平时，机器的输出将被关闭。

禁止输出功能时，还需要选择模式：**自动**或者**锁定**。

- **禁止输出-自动：**当控制信号禁止输出后，机器的输出被关闭，屏幕状态栏显示 INH 警告图标并且输出标识为 OFF。若机器先前处于 ON 状态时，禁止输出后 On/Off 按键灯亮，当 IO-5 上的电平撤销（由 0 变 1）后，机器的输出恢复正常。此功能用来控制仪器输出开关操作。
- **禁止输出-锁定：**当控制信号禁止输出后，机器的输出被关闭，面板 On/Off 按键灯灭，LCD 屏幕提示 INH 保护并且仪器蜂鸣报警，该保护需要解除控制信号并手动按[Shift]+[Esc]按键清除报警后，再按 On/Off 按键再次输出。


数字 IO-6 功能介绍

IO-6 可以被配置为**同步 On、输入、输出**

默认功能是用于控制和监视电源输出 On 的状态。在电源输出处于 Off 状态时，如果向引脚 6 输入脉冲信号，系统将触发电源输出为 On 状态。同时，当电源输出从 Off 状态切换至 On 状态时，引脚 6 会产生脉冲信号作为反馈。该功能主要用于同步多台仪器的输出开启。

以 3 台仪器为例，介绍使用方法如下：

1. 进入**系统→数字 IO→引脚 6:同步**打开菜单。
2. 分别将 3 台仪器引脚 6 的功能设置为**反向(关闭)**，并且为**同步 On**。
3. 参考下图，连接 3 台仪器的引脚 6。

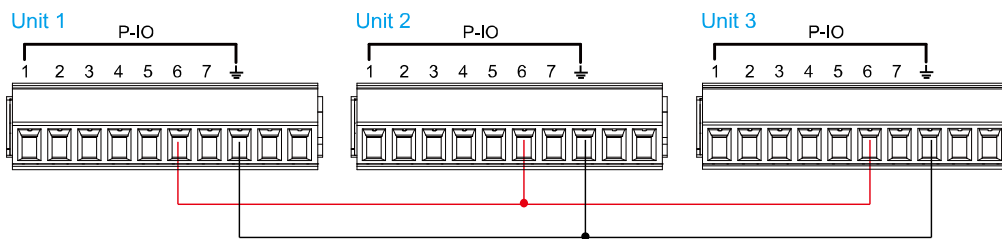

4. 按下任意一台仪器的[On/Off]键，使其输出从 **Off** 状态切换至 **On** 状态。此时另外 2 台仪器输出也会同步开启。


数字 IO-7 功能介绍

IO-7 可以被配置为**同步 Off**、**输入**、**输出**

默认功能是用于控制和监视电源输出 **Off** 的状态。在电源输出处于 **On** 状态时，如果向引脚 7 输入脉冲信号，系统将触发电源输出为 **Off** 状态。同时，当电源输出从 **On** 状态切换至 **Off** 状态时，引脚 7 会产生脉冲信号作为反馈。该功能主要用于同步多台仪器的输出关闭。

以 3 台仪器为例，介绍使用方法如下：

1. 进入**系统**→**数字 IO**→**引脚 7:同步 Off** 菜单。
2. 分别将 3 台仪器引脚 7 的功能设置为**反向(关闭)**，并且为**同步 Off**。
3. 参考下图，连接 3 台仪器的引脚 7。

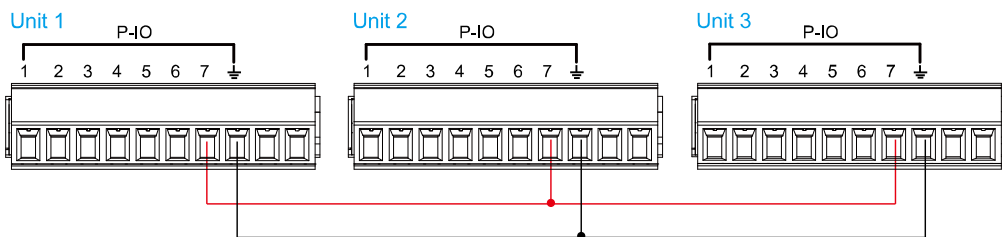

4. 按下任意一台仪器的[On/Off]键，使其输出从 **On** 状态切换至 **Off** 状态。此时另外 2 台仪器输出也会同步关闭。


5.10 外部模拟量测试功能（选配）

本系列后面板预留可扩展卡槽，当用户选配 IT-E177 (RS232+Aanlog) 模拟量接口时，可以使用模拟量接口实现：

- 远程控制电压/电流设定值
- 远程控制电压/电流上限值
- 远程监控电压/电流值

模拟量接口定义

接口定义如下：

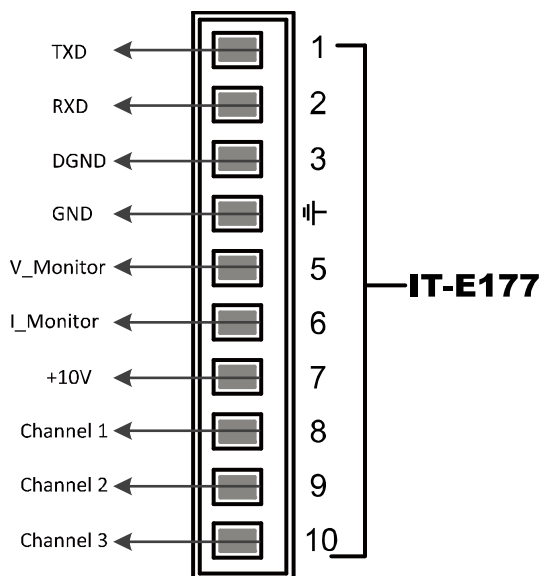

引脚	名称	说明
4 脚	GND	模拟输入和输出端接地。
5 脚	V_Monitor	电压监视端子
6 脚	I_Monitor	电流监视端子
7 脚	+10V	仪器自身输出的+10V参考电压，可以连接一个电阻分压，用于模拟量控制。
8 脚	Channel 1	用于输出电压/电流值的设定，与菜单中的 电压设定/电流设定 对应。 ● CV优先：指定Vs的值。 ● CC 优先：指定 Is 的值。
9 脚	Channel 2	用于电压/电流上限值的设定，与菜单中的 电压上限/电流上限 对应。 ● CV优先：指定电流上限I+的值。 ● CC 优先：指定电压上限 Vh 的值。
10 脚	Channel 3	IT6600D系列机型无需设置。

启用/停止外部模拟量功能

在使用此功能时，用户需要在 **System** 菜单中选择对应的功能设置。若外部模拟量接口未选配，该功能默认 **Off**，并且无法设置。

外部模拟量	外部模拟量测试功能。（当选配外部模拟量接口时才可设）	
	状态	开启或关闭外部模拟量测试功能。
	通道	选择模拟控制通道。
CV 优先时显示	电压设定 Mx	电压设定值的斜率系数。
	电压设定 Mb	电压设定值的偏移量。
	电流上限 Mx	电流上限值的斜率系数。
	电流上限 Mb	电流上限值的偏移量。
	电流下限 Mx	IT6600D 系列机型无需设置。
	电流下限 Mb	
CC 优先时显示	电流设定 Mx	电流设定值的斜率系数。
	电流设定 Mb	电流设定值的偏移量。
	电压上限 Mx	电压上限值的斜率系数。

	电压上限 Mb	电压上限值的偏移量。
	电压下限 Mx	IT6600D 系列机型无需设置。
	电压下限 Mb	

以上参数可通过配置菜单来进行选择。

1. 在前面板按下复合按键[Shift] + [P-set] (System)进入系统菜单界面。
2. 通过上下键或转动旋钮，找到菜单项**源配置->外部模拟量**。
 - i. 依次设置设定 Mx、设定 Mb、上限 Mx、和上限 Mb，按[Enter]确认。
 - ii. 按上下方向键，将光标移动至**状态**功能设置处，并按[Enter]键确认。旋转旋钮，选择**打开**，开启外部模拟量测试功能。
3. 按[Esc]键，退出菜单界面。

模拟量换算关系介绍

外部模拟量具有 3 个通道，每个通道的参数配置都遵循一次线性函数 $y=kx+b$ 。参数说明如下：

- 自变量 x：外部模拟量通道的实际输入电压值。
- 斜率系数 k：与菜单中的 Mx 相同，由客户设定。
- 偏移量 b：与菜单中的 Mb 相同，由客户设定。
- y：机器的实际输出值。(CV 优先时为电压，CC 优先时为电流)

以 Channel 1(电压设定/电流设定)编程设定为例，用户需要根据以下公式换算出 Mx 和 Mb 的值，然后通过前面板按键将这两个值分别设置。



说明

Channel 1 和 Channel 2 的参数设定原理相同，因此不再重复介绍。

- CV 优先

$$M_x = \frac{(V_{out2} - V_{out1})}{(V_{in2} - V_{in1})}$$

$$M_b = V_{out2} - V_{in2} \times M_x$$

- CC 优先

$$M_x = \frac{(I_{out2} - I_{out1})}{(V_{in2} - V_{in1})}$$

$$M_b = I_{out2} - V_{in2} \times M_x$$


公式参数说明：

名称	说明
Vin1	向引脚8输入电压的最小值。设置范围为：-10V~10V。
Vin2	向引脚8输入电压的最大值。设置范围为：-10V ~10V，并且 Vin2>Vin1。
Vout1	CV 优先模式下，仪器输出电压的最小值。
Vout2	CV优先模式下，仪器输出电压的最大值，并且 Vout2>Vout1。
Iout1	CC优先模式下，仪器输出电流的最小值。
Iout2	CC优先模式下，仪器输出电流的最大值，并且Iout2>Iout1。

模拟量控制

下面以 CC 优先模式为例，说明电压和电流控制的连接和使用方法。

1. 参考下图将引脚完成连接。

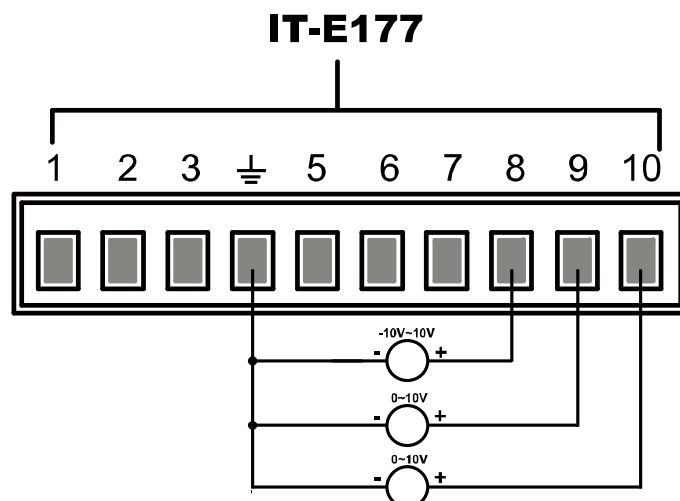

2. 根据上述的公式换算关系，分别计算出**电流设定**、**电压上限**对应菜单下的 **Mx** 和 **Mb**。本手册使用的数据示例如下表所示。

引脚输入电压		电源输出电压/ 电流	Mx	Mb	说明
8 脚	Vin1 = 0	Iout1=0	3	0	通过向引脚8输入 0V~10V的电压，来控制仪器实际输出电流Is为 0A~30A。
	Vin2 = 10	Iout2=30			
9 脚	Vin1 = 0	V+out1 = 0	100	0	通过向引脚9输入 0V~5V的电压，来控制仪器实际输出电压上限V+为 0~500V。
	Vin2 = 5	V+out2 = 500			

3. 设置对应引脚的 **Mx** 和 **Mb**。
 - 1) 在前面板按下复合按键[Shift] + [P-set] (System)进入系统菜单界面。
 - 2) 通过上下键或转动旋钮，找到菜单项 **源配置->外部模拟量**。
 - 3) 依次设置电流设定 **Mx**、电流设定 **Mb**、电压上限 **Mx** 和电压上限 **Mb**，按


[Enter]确认。

- 4) 按上下方向键，将光标移动至**状态**功能设置处，并按[Enter]键确认。旋转旋钮，选择**打开**，开启外部模拟量测试功能。
4. 控制**引脚 8** 的输入为 0V~10V，控制**引脚 9** 的输入为 0V~5V。

例如，当引脚 8 中输入的电压为 1V 时，本仪器输出电流设定值为 3A；当引脚 9 中输入的电压为 2V 时，本仪器输出电压上限设定值为 200V。

电压电流监控

通过模拟量接口可以监视当前输出电压和输出电流。在模拟量接口的引脚 5、引脚 6 和地线 4 之间连接一个数字电压表。0V~10V 的电压读数与仪器的零到满刻度电压电流相对应，连线示意图如下所示。

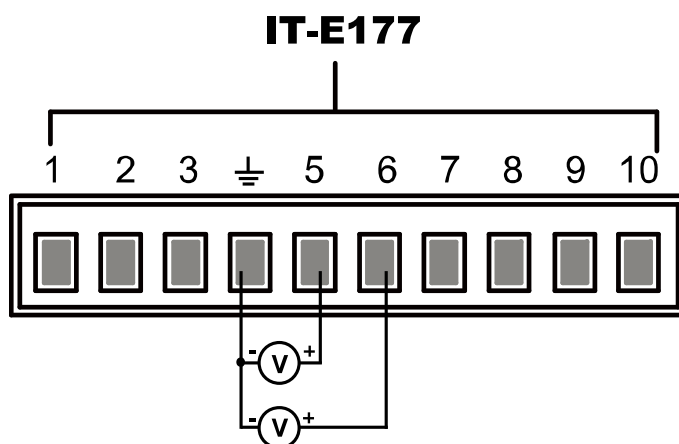


5.11 冗余功能

IT6600D 系列配备了冗余功能，可以在并机状态下观测各机柜、单机的工作运行情况。当有机器发生故障时，IT6600D 电源系统会自动判别，让此冗余机器退出测试，并在总容量范围内进行调配，保证整体平滑的对外输出。

这就意味着只要剩余的电力可以满足测试需要，即使其中一台机器出现故障，IT6600D 电源系统也将继续为其电源总线提供全部电力，这也就是所谓的 100% 电源可用性，此功能尤其适用于电源可靠性要求高的场合。

用户在 Menu 菜单界面中点击**冗余**，进入冗余功能界面。

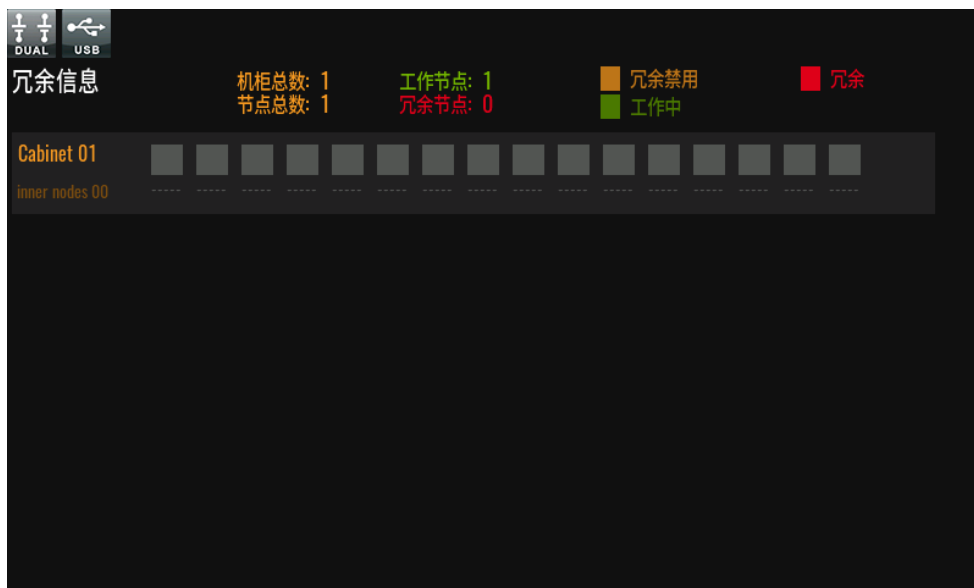


- 机柜总数: 机柜总数。
- 节点总数: 并联运行的机器总数。
- 工作节点: 正常工作的机器数量。
- 冗余节点: 发生故障的机器数量。
- 冗余禁用: 表示当前节点的冗余功能已被禁用。当前节点显示为 .
- 冗余: 表示当前节点的机器发生故障。当前节点显示 .
- 工作中: 表示当前节点的机器运行正常。当前节点显示 .
- Inner nodes: 内部节点数，即单个机柜中包含的机器数量。

第六章 测量功能

本章将详细描述本系列仪器的基础测量功能特性和使用方法。测量功能可以是常用的数据显示模式，也可以是波形显示模式。

6.1 常规 Meter 模式

在 Menu 显示界面中，点击**交流测量**进入测量显示界面。如下图所示。

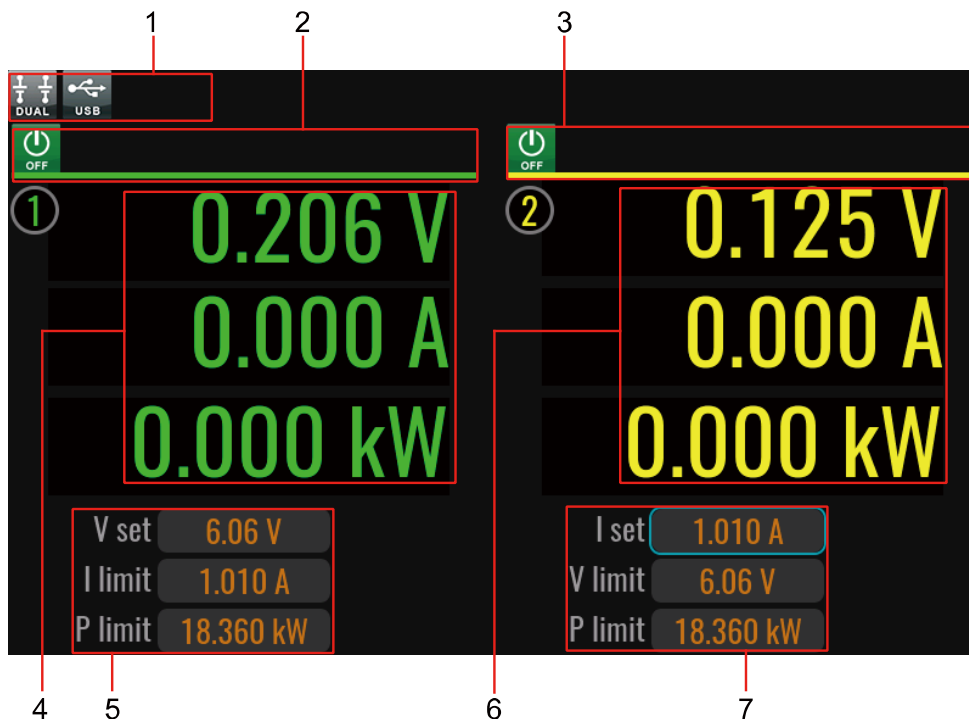

序号	名称	功能说明
1	电源状态栏	显示当前的电源输出状态。
2	CH1 状态栏	显示电源通道 1 的输出状态。
3	CH2 状态栏	显示电源通道 2 的输出状态。
4	CH1 输出值显示区	显示当前输出的电压值、电流值和功率值。
5	CH1 设置值显示区	● CV 优先时，显示电压设置值、电流上限值、功率上限值。 ● CC 优先时，显示电流设置值、电压上限值、功率上限值。
6	CH2 输出值显示区	显示当前输出的电压值、电流值和功率值。
7	CH2 设置值显示区	● CV 优先时，显示电压设置值、电流上限值、功率上限值。 ● CC 优先时，显示电流设置值、电压上限值、功率上限值。


6.2 示波模式

本系列电源提供基于采样数据显示波形功能。可以选择显示或隐藏输入单元的电

压和电流波形。只显示必要波形，易于观察。波形显示界面包括垂直轴和水平轴。

波形显示界面介绍

在 **Menu** 显示界面中，点击**示波**进入波形显示界面。如下图所示。

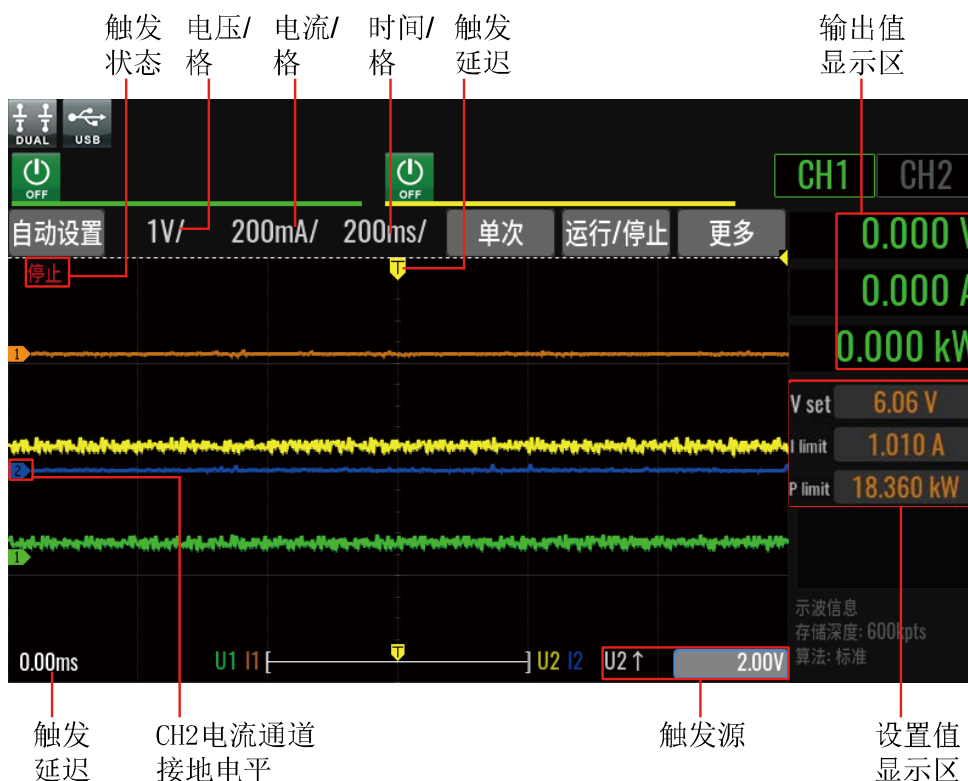

触发状态描述如下：

触发状态	说明
自动	选择触发模式为自动，触发后显示触发状态为自动。
滚动	选择触发模式为自动，未触发时的触发状态为滚动。
触发	选择触发模式为标准，触发后显示触发状态为触发。
就绪	选择触发模式为标准，未触发时的触发状态为就绪。
停止	在波形显示界面，按下停止键时，显示触发状态为停止。

波形显示界面按键说明：

- **自动设置**：自动调整适合的时基、电压/电流刻度，并将触发电平和触发延迟恢复为默认值。
- **电压/电流/时间**：调整当前示波界面中电压/电流/时间的每大格代表的数值。
- **单次**：单次测量键，停止状态下执行单次测量，则按当前数据更新率进行一次测量后重新进入停止状态。在运行状态下执行单次测量，则仪器立即重新开始测量一次后进入停止状态。
- **运行/停止**：可以停止或启动示波功能。
- **更多**：示波功能的高级配置选项。

参数	说明
----	----

触发源	触发源选择，包括电压、电流、外部触发。 ● 电压触发：当 DC 端检测到电压达到设定的触发电压值，并且处于触发上限、下限范围内，则触发一次数据记录操作。 ➢ Trig Level: 触发阈值。 ➢ Edge: 设置触发边沿，上升沿、下降沿或上升&下降沿。 ➢ Trig High: 触发上限值。 ➢ Trig Low: 触发下限值。 ● 电流触发：当 DC 端检测到电流达到设定的触发电流值，并且处于触发上限、下限范围内，则触发一次数据记录操作。 ➢ Trig Level: 触发阈值。 ➢ Edge: 设置触发边沿，上升沿、下降沿或上升&下降沿。 ➢ Trig High: 触发上限值。 ➢ Trig Low: 触发下限值。 ● 外部触发：表示通过数字 I/O 接口（P-IO）的引脚 4 进行触发。关于 I/O 引脚的介绍，详见 5.9 数字 I/O 功能。
触发模式	触发模式，可以选择为自动模式或标准模式。
打印数据	数据记录功能，选择是否开始记录数据。 ● 存储深度：数据记录深度。 ● 算法：可选择标准或峰值。
曲线选择	选择显示的曲线，用于选择是否显示对应通道的电压/电流波形，最多可以显示 4 条示波数据曲线。

触发波形

当满足指定的触发条件时，触发波形显示，触发发生的时间点称为触发点，通常在显示屏幕的中间，触发点之后，显示屏幕开始随时间进程从左至右显示波形。使用触发功能前，用户需要配置如下参数：

- **触发模式**
触发模式指更新屏幕显示的条件。分**自动模式**和**标准模式**。自动模式：在暂停时间内发生触发时，更新显示波形；在暂停时间内未发生触发时，自动更新显示波形。
常规模式：触发时，更新显示；不触发时，不更新显示。
- **触发源**
触发源用于产生触发条件。
- **触发沿**
边沿指信号由低电平向高电平（上升沿）或高电平向低电平（下降沿）的变动；边沿作为一种触发条件时，称为触发沿。
- **触发电平**
触发沿通过的电平，如果触发源信号按照指定触发沿通过已设定的触发电平，

则触发发生。当选中 **U_t** 进行编辑时，可以通过旋钮、数字键或方向键来调整触发电平。改变触发电平大小，在屏幕上可观察触发电平变化。

水平控制和垂直控制

- 垂直定标

选中电压/格或电流/格，使用旋钮或方向键设定当前每格的电压或电流量程。

- 水平定标

选中时间/格，使用旋钮或方向键可调整水平定标（扫描速度）。此时旋转旋钮，更改水平（时间/格）设置，在屏幕上可观察到时间/格信息如何变化。

- 触发延迟

可以通过编辑框（旋钮/方向键/数字按键）或水平滑动来调整触发延迟。默认触发延迟为 **0**，此时触发点位于波形显示区域中间。当触发延迟值为正时，触发点向左移动；当触发延迟值为负时，触发点向右移动。

数据记录

在**更多**菜单中用户可以选择**打印数据**选项，选择数据记录的方式。并在示波器界面面按 **Print** 按键，数据会记录到外部存储设备中。

数据记录方式分为：

- 关闭：关闭数据记录功能。
- 位置数据：记录波形位置的数据。
- 原始数据：记录原始数据。
- 位置&原始数据：记录 Post 和 Raw 两份文件。

6.3 数据记录功能

数据记录功能可以长时间观察和记录输出状态数据，在趋势图界面中用户可以选择需要显示的数据曲线，最多可显示 **6** 条数据曲线。

在 **Menu** 显示界面中，点击**记录仪**进入数据记录功能界面。如下图所示。



- **运行/停止**: 开启/停止刷新数据。
- **清除**: 清除所有曲线数据。
- **配置**: 进入设置菜单中实现更多功能。

参数	说明
视图控制	选择当前显示的数据曲线数量和相应的参数。最多可显示六条曲线，可选参数包括 Vmean, Vmin, Vmax, Imean, Imin, Imax, Pmean, Pmin, Pmax.
数据记录设置	选择需要记录的数据对象。 ● 运行开关: 启用或禁用存储状态。若禁用，所有数据将不会被保存或显示。 ● 电压: 开启或关闭电压存储。 ● 电流: 开启或关闭电流存储。 ● 功率: 开启或关闭功率存储。
触发设置	选择数据记录功能的触发方式, 包括立即触发、手动触发、总线触发、电压触发、电流触发、外部触发。 ● 立即触发: 立即执行一次触发操作。 ● 手动触发: 表示通过前面板按键手动触发，即按一次复合按键[Shift]+[Channel](Trig)，进行一次触发操作。 ● 总线触发: 当仪器接收到触发命令*TRG 时，进行一次触发操作。 ● 电压触发: 当 DC 端检测到电压达到设定的触发电压值，并且处于触发上限、下限范围内，则触发一次数据记录操作。 ➢ 触发值: 触发阈值。 ➢ 边沿: 设置触发边沿，上升沿、下降沿或双边沿。 ➢ 触发上限: 触发上限值。 ➢ 触发下限: 触发下限值。 ● 电流触发: 当 DC 端检测到电流达到设定的触发电流值，并且处于触发上限、下限范围内，则触发一次数据记录操作。 ➢ 触发值: 触发阈值。 ➢ 边沿: 设置触发边沿，上升沿、下降沿或双边沿。 ➢ 触发上限: 触发上限值。 ➢ 触发下限: 触发下限值。 ● 外部触发: 表示通过数字 I/O 接口 (P-IO) 的引脚 4 进行触发。关于 I/O 引脚的介绍，详见 5.9 数字 I/O 功能。
运行时间设置	该参数表示数据记录的时长，单位：秒，即数据记录Y秒后结束，并准备下一次的数据记录。仪器支持的输入范围为：0-99999999s.

采样时间设置	该参数表示数据采样的周期，单位：毫秒，即每隔X秒对测试数据进行一次记录。仪器支持的输入范围为： 0.1ms-1000ms.
文件格式设置	导出到 U 盘中的文件格式，包括 Tdms 和 Csv 两种格式。

- **保持/释放：** 暂停屏幕数据刷新（用于观测数据）/开始动态观测最新的数据。
- **自动：** 自动调整适合的垂直坐标轴的刻度。
- **Time：** 水平坐标的每格代表的时间值，单位 s/Div。
- **Vernier：** 游标卡尺的位置信息。

第七章 技术规格

本章将介绍本系列电源的额定电压、额定电流、额定功率等主要技术参数和电源的使用存储环境、温度。

7.1 补充特性

状态存储器容量：100 组操作状态

建议校准频率：1 次/年

散热方式：风冷

7.2 主要技术参数

7.2.1 1200V

参数			IT6642D-1200-200
额定值范围	电压	串联模式	0 ~ 1200V
		双通道/并联模式	0 ~ 600V
	电流	并联模式	0 ~ 200A
		双通道/串联模式	0 ~ 100A
	功率	每通道	0 ~ 21kW
		总	0 ~ 42kW
	CV 串联内阻	双通道	0 ~ 0.6Ω
		并联模式	0 ~ 0.3Ω
		串联模式	0 ~ 1.2Ω
	CC 负载电阻	双通道	0.046 ~ 7500Ω
		并联模式	0.023 ~ 7500Ω
		串联模式	0.092 ~ 7500Ω
电源调节率	电压	≤0.005%FS	
	电流	≤0.005%FS	
负载调节率	电压	≤0.005%FS	
	电流	≤0.01%FS	
设定值解析度	电压	0.001V	
	电流	0.001A	
	功率	0.001kW	
	电阻	0.001Ω	
回读值解析度	电压	0.001V	
	电流	0.001A	
	功率	0.001kW	
设定值精确度	电压	≤0.02%+0.01%FS	
	电流	≤0.03% + 0.03%FS	
	功率	≤0.05% + 0.15%FS	
回读值精确度	电压	≤0.02%+0.01%FS	
	电流	≤0.03% + 0.03%FS	
	功率	≤0.05% + 0.15%FS	

纹波*1	电压峰峰值	20Hz-20MHz	≤0.1%FS
	电压有效值	20Hz-20MHz	≤0.02%FS
	电流 RMS	20Hz-300KHz	≤0.1%FS
设定值温漂系数	电压	≤15PPM/℃	
	电流	≤30PPM/℃	
回读值温漂系数	电压	≤15PPM/℃	
	电流	≤30PPM/℃	
上升时间（空载）	电压	≤1ms	
上升时间（满载）	电压	≤1ms	
下降时间（空载）	电压	≤1s	
下降时间（满载）	电压	≤100ms	
上升时间（满电流）	电流	≤1ms	
下降时间（满电流）	电流	≤1ms	
动态响应时间	电压	≤200us	
交流输入	输入电压*2*3	三相四线制	21 kW Max. @180-264V-Input
			42 kW Max. @342-528V-Input
	最大输入电流	73A(per phase)@200Vac, 3ø input	
		77A(per phase)@380Vac, 3ø input	
		61A(per phase)@480Vac, 3ø input	
	最大视在功率	45.4kVA	
	频率	47Hz~63Hz	
功率因素*4	0.99		
设定值稳定度-30min	电压	≤0.005%+0.005%FS	
	电流	≤0.01%+0.01%FS	
设定值稳定度-8h	电压	≤0.005%+0.005%FS	
	电流	≤0.01%+0.01%FS	
回读值稳定度-30min	电压	≤0.005%+0.005%FS	
	电流	≤0.01%+0.01%FS	
回读值稳定度-8h	电压	≤0.005%+0.005%FS	
	电流	≤0.01%+0.01%FS	
效率		满电流满功率	~93.5%
		满电压满功率	~94%
输出端口电容		双通道模式	58.4uF
满电流吸收电压（MOV）		≤0.5%FS	
Sense 补偿电压		1%FS	
编程响应时间		1ms	
存储温度		-10℃~70℃	
保护功能		OVP、OCP、OPP、UVP、UCP、OTP、Vsense 保护	
通讯接口		标配：USB、CAN、LAN、数字 IO 选配：GPIB、模拟量卡（包含 RS232）、光纤模块、EtherCAT 卡、继电器卡	
耐压（输出对大地）		2250V	
工作温度		0~50℃	
防护等级		IP20	
安规		IEC 61010	
冷却方式		风冷	
尺寸（mm）		483mm(W)* 151.3mm(H)* 833.6mm(D)	

重量（净重）	50kg
--------	------

- *1 该规格是在输出电压 $\geq 30V$ 的测试条件下测试的。
- *2 (198~264) V 输入时, 40℃环温下输出额定功率的 50%, 50℃环温下输出额定功率的 40%。
- *3 多主上机柜,即选配急停模块(包含交流接触器)的机型,标准 AC 输入电压仅支持 380VAC $\pm 10\%$, 如需 480VAC $\pm 10\%$ 电压需定制。
- *4 标称输入下, 额定功率 50%及以上时, 功率因数为 0.99。

7.2.1 1600V

参数			IT6642D-1600-140
额定值范围	电压	串联模式	0 ~ 1600V
		双通道/并联模式	0 ~ 800V
	电流	并联模式	0 ~ 140A
		双通道/串联模式	0 ~ 70A
	功率	每通道	0 ~ 21kW
		总	0 ~ 42kW
	CV 串联内阻	双通道	0 ~ 1.143 Ω
		并联模式	0 ~ 0.572 Ω
		串联模式	0 ~ 2.286 Ω
	CC 负载电阻	双通道	0.066 ~ 7500 Ω
		并联模式	0.033 ~ 7500 Ω
		串联模式	0.131 ~ 7500 Ω
电源调节率	电压	$\leq 0.005\%FS$	
	电流	$\leq 0.005\%FS$	
负载调节率	电压	$\leq 0.005\%FS$	
	电流	$\leq 0.01\%FS$	
设定值解析度	电压	0.001V	
	电流	0.001A	
	功率	0.001kW	
	电阻	0.001 Ω	
回读值解析度	电压	0.001V	
	电流	0.001A	
	功率	0.001kW	
设定值精确度	电压	$\leq 0.02\% + 0.01\%FS$	
	电流	$\leq 0.03\% + 0.03\%FS$	
	功率	$\leq 0.05\% + 0.15\%FS$	
回读值精确度	电压	$\leq 0.02\% + 0.01\%FS$	
	电流	$\leq 0.03\% + 0.03\%FS$	
	功率	$\leq 0.05\% + 0.15\%FS$	
纹波*1	电压峰峰值	20Hz-20MHz	$\leq 0.1\%FS$
	电压有效值	20Hz-20MHz	$\leq 0.02\%FS$
	电流 RMS	20Hz-300KHz	$\leq 0.1\%FS$
设定值温漂系数	电压	$\leq 15PPM/^{\circ}C$	
	电流	$\leq 30PPM/^{\circ}C$	
回读值温漂系数	电压	$\leq 15PPM/^{\circ}C$	

	电流	$\leq 30\text{PPM}/^{\circ}\text{C}$	
上升时间（空载）	电压	$\leq 1\text{ms}$	
上升时间（满载）	电压	$\leq 1\text{ms}$	
下降时间（空载）	电压	$\leq 1\text{s}$	
下降时间（满载）	电压	$\leq 100\text{ms}$	
上升时间（满电流）	电流	$\leq 1\text{ms}$	
下降时间（满电流）	电流	$\leq 1\text{ms}$	
动态响应时间	电压	$\leq 200\mu\text{s}$	
交流输入	输入电压*2*3	三相四线制	21 kW Max. @180-264V-Input 42 kW Max. @342-528V-Input
	最大输入电流	73A(per phase)@200Vac, 3 ϕ input	
		77A(per phase)@380Vac, 3 ϕ input	
		61A(per phase)@480Vac, 3 ϕ input	
	最大视在功率	45.4kVA	
	频率	47Hz~63Hz	
	功率因素*4	0.99	
设定值稳定度-30min	电压	$\leq 0.005\%+0.005\%\text{FS}$	
	电流	$\leq 0.01\%+0.01\%\text{FS}$	
设定值稳定度-8h	电压	$\leq 0.005\%+0.005\%\text{FS}$	
	电流	$\leq 0.01\%+0.01\%\text{FS}$	
回读值稳定度-30min	电压	$\leq 0.005\%+0.005\%\text{FS}$	
	电流	$\leq 0.01\%+0.01\%\text{FS}$	
回读值稳定度-8h	电压	$\leq 0.005\%+0.005\%\text{FS}$	
	电流	$\leq 0.01\%+0.01\%\text{FS}$	
效率		满电流满功率	$\sim 93.5\%$
		满电压满功率	$\sim 94\%$
输出端口电容		双通道模式	14.6 μF
满电流吸收电压（MOV）		$\leq 0.5\%\text{FS}$	
Sense 补偿电压		1%FS	
编程响应时间		1ms	
存储温度		$-10^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$	
保护功能		OVP、OCP、OPP、UVP、UCP、OTP、Vsense 保护	
通讯接口		标配：USB、CAN、LAN、数字 IO 选配：GPIB、模拟量卡（包含 RS232）、光纤模块、EtherCAT 卡、继电器卡	
耐压（输出对大地）		2250V	
工作温度		$0 \sim 50^{\circ}\text{C}$	
防护等级		IP20	
安规		IEC 61010	
冷却方式		风冷	
尺寸（mm）		483mm(W)* 151.3mm(H)* 833.6mm(D)	
重量（净重）		50kg	

*1 该规格是在输出电压 $\geq 30\text{V}$ 的测试条件下测试的。

*2 (198~264) V 输入时, 40℃环温下输出额定功率的 50%, 50℃环温下输出额定功率的 40%。

*3 多主上机柜, 即选配急停模块(包含交流接触器)的机型, 标准 AC 输入电压仅支持 380VAC±10%, 如需 480VAC±10%电压需定制。

*4 标称输入下, 额定功率 50%及以上时, 功率因数为 0.99。

7.2.3 2250V

参数			IT6642D-2250-100
额定值范围	电压	串联模式	0 ~ 2250V
		双通道/并联模式	0 ~ 1200V
	电流	并联模式	0 ~ 100A
		双通道/串联模式	0 ~ 50A
	功率	每通道	0 ~ 21kW
		总	0 ~ 42kW
	CV 串联内阻	双通道	0 ~ 2.4Ω
		并联模式	0 ~ 1.2Ω
		串联模式	0 ~ 4.5Ω
	CC 负载电阻	双通道	0.092 ~ 7500Ω
		并联模式	0.046 ~ 7500Ω
		串联模式	0.183 ~ 7500Ω
电源调节率	电压	≤0.005%FS	
	电流	≤0.005%FS	
负载调节率	电压	≤0.005%FS	
	电流	≤0.01%FS	
设定值解析度	电压	0.001V	
	电流	0.001A	
	功率	0.001kW	
	电阻	0.001Ω	
回读值解析度	电压	0.001V	
	电流	0.001A	
	功率	0.001kW	
设定值精确度	电压	≤0.02%+0.01%FS	
	电流	≤0.03% + 0.03%FS	
	功率	≤0.05% + 0.15%FS	
回读值精确度	电压	≤0.02%+0.01%FS	
	电流	≤0.03% + 0.03%FS	
	功率	≤0.05% + 0.15%FS	
纹波*1	电压峰峰值	20Hz-20MHz	≤0.1%FS
	电压有效值	20Hz-20MHz	≤0.02%FS
	电流 RMS	20Hz-300KHz	≤0.1%FS
设定值温漂系数	电压	≤15PPM/℃	
	电流	≤30PPM/℃	
回读值温漂系数	电压	≤15PPM/℃	
	电流	≤30PPM/℃	
上升时间 (空载)	电压	≤1ms	
上升时间 (满载)	电压	≤1ms	

下降时间（空载）	电压	≤1s	
下降时间（满载）	电压	≤100ms	
上升时间（满电流）	电流	≤1ms	
下降时间（满电流）	电流	≤1ms	
动态响应时间	电压	≤200us	
交流输入	输入电压*2*3	三相四线制	21 kW Max. @180-264V-Input
			42 kW Max. @342-528V-Input
	最大输入电流	73A(per phase)@200Vac, 3ø input	
		77A(per phase)@380Vac, 3ø input	
		61A(per phase)@480Vac, 3ø input	
	最大视在功率	45.4kVA	
	频率	47Hz～63Hz	
功率因素*4	0.99		
设定值稳定度-30min	电压	≤0.005%+0.005%FS	
	电流	≤0.01%+0.01%FS	
设定值稳定度-8h	电压	≤0.005%+0.005%FS	
	电流	≤0.01%+0.01%FS	
回读值稳定度-30min	电压	≤0.005%+0.005%FS	
	电流	≤0.01%+0.01%FS	
回读值稳定度-8h	电压	≤0.005%+0.005%FS	
	电流	≤0.01%+0.01%FS	
效率		满电流满功率	～93.5%
		满电压满功率	～94%
输出端口电容		双通道模式	14.6uF
满电流吸收电压（MOV）		≤0.5%FS	
Sense 补偿电压		1%FS	
编程响应时间		1ms	
存储温度		-10℃～70℃	
保护功能		OVP、OCP、OPP、UVP、UCP、OTP、Vsense 保护	
通讯接口		标配：USB、CAN、LAN、数字 IO 选配：GPIB、模拟量卡（包含 RS232）、光纤模块、EtherCAT 卡、继电器卡	
耐压（输出对大地）		2250V	
工作温度		0～50℃	
防护等级		IP20	
安规		IEC 61010	
冷却方式		风冷	
尺寸（mm）		483mm(W)* 151.3mm(H)* 833.6mm(D)	
重量（净重）		50kg	

*1 该规格是在输出电压 $\geq 30V$ 的测试条件下测试的。

*2 (198~264) V 输入时， $40^{\circ}C$ 环温下输出额定功率的 50%， $50^{\circ}C$ 环温下输出额定功率的 40%。

*3 多主上机柜，即选配急停模块(包含交流接触器)的机型，标准 AC 输入电压仅支持 $380VAC \pm 10\%$ ，如需 $480VAC \pm 10\%$ 电压需定制。

*4 标称输入下，额定功率 50%及以上时，功率因数为 0.99。

以上规格如有更新，恕不另行通知。

第八章 远程操作

本系列电源标配三种通信接口：USB、LAN 和 CAN，且支持选配两种通信接口：GPIB、RS232。用户可以任意选择一种来实现与计算机的通讯。

当您使用远程接口发送 SCPI 指令时，若使用的编程命令中涉及对仪器设置修改的指令，如修改输出电压值等，则在完成仪器与上位机的通讯连接后，需先执行 **SYST:REM** 指令。

8.1 USB 接口

USB 接口位于仪器后面板，用户可通过一根两头均为 USB 口（一头为 USB A 型接口，一头为 USB B 型接口）的电缆连接本仪器和计算机。

使用 USB 接口之前需在系统菜单中选择 USB 接口类型，可选择如下类型：

- **前面板 USB**：当前 USB 设备是用于存储的外围设备。
- **后面板 USB**：当前 USB 设备是用于通讯的通讯接口。

操作步骤

在系统菜单（System）中更改 USB 接口类型的操作步骤如下：

1. 在前面板按下 **[Shift] + [P-set]** (System) 进入系统菜单界面。
2. 选中**通信**，选择 USB，按 **[Enter]** 键确认。
3. 选择 USB 的位置为**后面板 USB**，按 **[Enter]** 键确认。
4. 选择 **USB 设备类型** 为 VCP 或 TMC，按 **[Enter]** 键确认。

8.2 LAN 接口

当用户使用 LAN 接口与 PC 通讯时，用户参考以下内容进行连接和配置 LAN 接口。本仪器 LAN 接口符合 LXI 标准。

连接接口

使用下列步骤，可以将仪器快速接入局域网并进行配置。下面介绍两种典型的 LAN 接口系统：专用网络和站点网络。

- **连接到专用 LAN**
专用 LAN 是指支持 LAN 的仪器和计算机直连而成的网络。专用 LAN 通常是小型、非集中管理的资源。在与计算机连接时，可用一根标准网线通过 LAN 接口直接连接至计算机。
连接到专用 LAN 时，网关地址需要与计算机的网关地址保持一致，仪器 IP 地址需要与计算机的 IP 地址在同一网段。
- **连接到站点 LAN**
站点 LAN 是指支持 LAN 的仪器和计算机通过路由器、集线器和 / 或交换机连接的局域网。站点 LAN 通常是大型、集中管理的网络，包含 DHCP 和 DNS 服务器之类的服务。在与计算机连接时，可用一根网线连接到路由器，此时，计算机也连接到该路由器。



说明

- 连接到专用 LAN 时，网关地址需要与计算机的网关地址保持一致，仪器 IP 地址需要与计算机的 IP 地址在同一网段。
- 连接到站点 LAN 时，必须为仪器分配一个独立的 IP 地址。

配置 LAN 接口信息

本系列电源支持配置以下的 LAN 通讯参数：

网络配置：

- **模式：**IP 地址设置方式，可以选择**手动**或 DHCP 自动分配。
- **IP：**该值是仪器的 IP（Internet 协议）地址。与仪器进行的所有 IP 和 TCP/IP 通信都需要 IP 地址。IP 地址由四个以小数点分隔的十进制数字组成。每个不带前置 0 的十进制数字的取值范围为 0 到 255（例如，169.254.2.20）。仪器 IP 地址的设置值需要跟电脑的 IP 地址在同一个网段（IP 地址最后一位不同）。
- **子网掩码：**该值是仪器的子网掩码。仪器使用该值可判断客户端 IP 地址是否位于同一本地子网上。同一编号标记适于用作 IP 地址。如果客户端 IP 地址在其他子网上，必须将所有软件包发送到默认网关。
- **网关：**该值是网关的 IP 地址，仪器通过该地址与不在本地子网上的系统通信，这取决于子网掩码的设置。
- **端口：**该值表示服务对应的端口号。

在系统菜单（System）中可设置 LAN 接口的相关信息，操作步骤如下：


1. 在前面板按下复合按键[Shift] + [P-set] (System)进入系统菜单界面。
2. 选中**通信**，按[Enter]键。
3. 按左右键，选中 LAN，设置当前 LAN 模式为**手动**模式。
4. 逐个设置 IP、子网掩码等参数，按[Enter]键。

8.2.1 使用 Web 服务器

仪器提供一个内置的 Web 服务器，您可以直接从计算机的 Web 浏览器监控仪器。使用该 Web 服务器，需将仪器和计算机通过 LAN 接口互连，然后在计算机的 Web 浏览器顶部的地址栏输入仪器的 IP 地址，即可以访问包括 LAN 配置参数在内的前面板控制功能。

浏览器地址栏中输入的地址格式为 **http://192.168.0.100**，具体的 IP 请以实际仪器的设置为准。

打开后的页面显示如下：

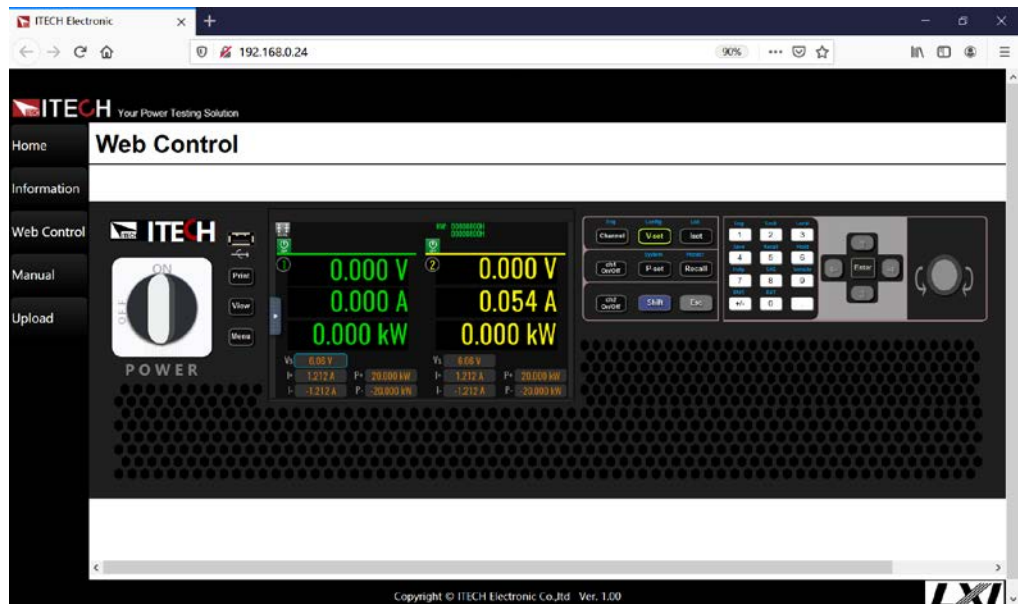

点击窗口左侧导航栏中的不同按钮可以显示不同的界面，详细说明如下：

- Home: Web 主界面，显示仪器型号及外观；
- Information: 显示仪器序列号等系统信息以及 LAN 配置参数；
- Web Control: 启用 Web control 远程控制仪器。在此界面中，您可以监测和控制仪器；
- LAN Configuration: 重新配置 LAN 接口参数；
- Manual: 跳转至 ITECH 官网，查看或下载仪器相关文档；
- Upload: 执行系统升级的操作。

单击 CONNECT 将 PC 与仪器连接，然后单击 Select File 选择系统升级安装包（例如 IT6600-U-VXXX.itech），单击 UPLOAD 执行升级操作。升级完成后，需将仪器重启。

8.2.2 使用 Telnet

Telnet 实用程序（以及套接口）是不使用 I/O 库或驱动程序与仪器通信的另一种方法。使用该方法通信，必须首先建立计算机和仪器的 LAN 连接。

在 MS-DOS 命令提示框中，输入“telnet hostname”，其中 hostname 可以是仪器的主机名或 IP 地址，按回车键，应看到 Telnet 会话框，其中的标题指示您已连接到仪器，23 是仪器的 telnet 端口。在提示符处键入 SCPI 命令。

8.2.3 使用套接字

小心

- 使用该功能前，需配置 Socket Port，且仪器侧的配置与 PC 侧的配置需保持一致。
- 仪器最多同时允许六个套接字和 telnet 连接的任意组合。


ITECH 仪器提供 SCPI 套接字服务。此端口上的套接字可用于发送和接收 SCPI 命令、查询和查询响应。所有命令都必须以换行符结尾，以便输出要解析的消息。所有查询响应也必须以换行符结束。

8.2.4 使用 VNC 传屏

VNC (Virtual Network Computing) 是一种远程桌面控制机器的方法。在使用 VNC 之前，请确保将机器和电脑使用 LAN 连接，并配置好机器的 IP 地址，以确保它们在同一个局域网中。


使用浏览器

在浏览器地址栏中输入机器的 IP 地址+端口号，然后按回车键连接机器。注意端口号必须是 5800。打开后的页面显示如下：

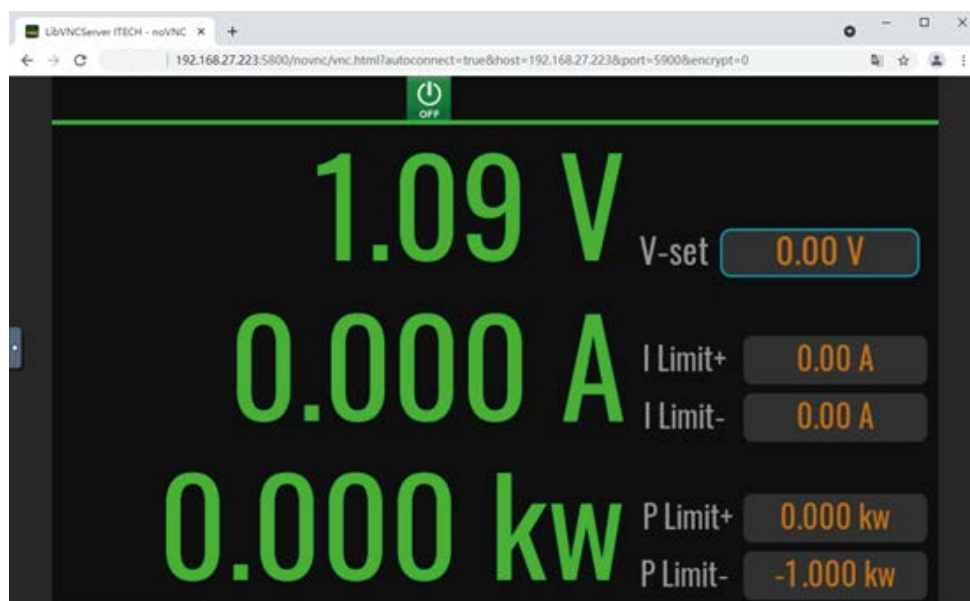




使用 VNC 客户端

1. 双击 VNC 客户端软件。




2. 在打开的软件中，在编辑框中输入机器的 IP 地址，然后按回车键连接访问机器。

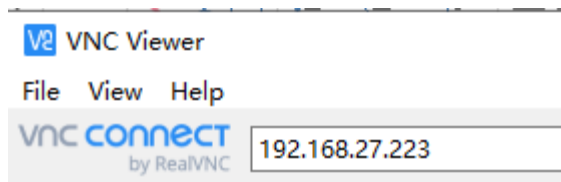

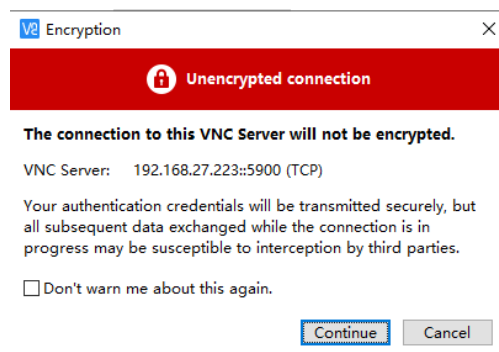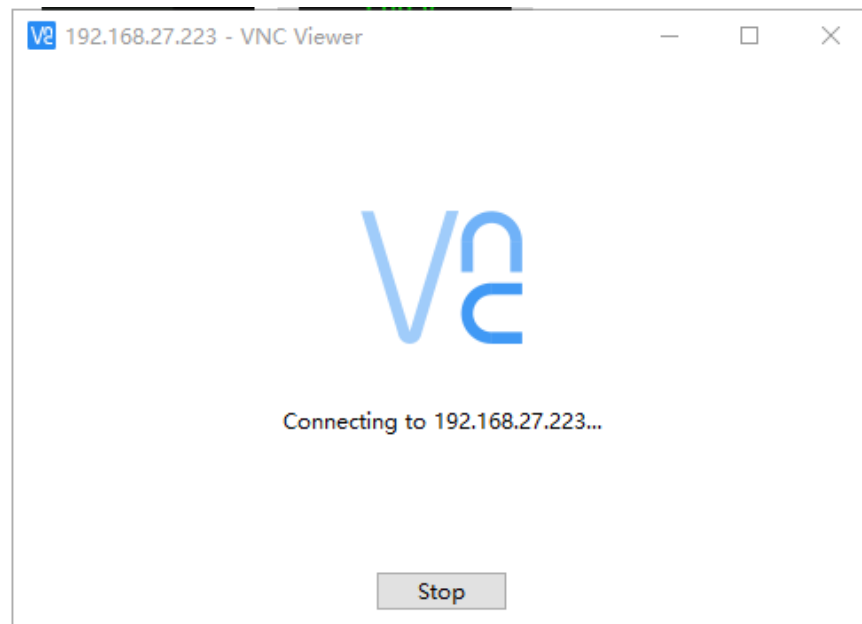

3. 单击[Continue]，显示机器触摸屏。

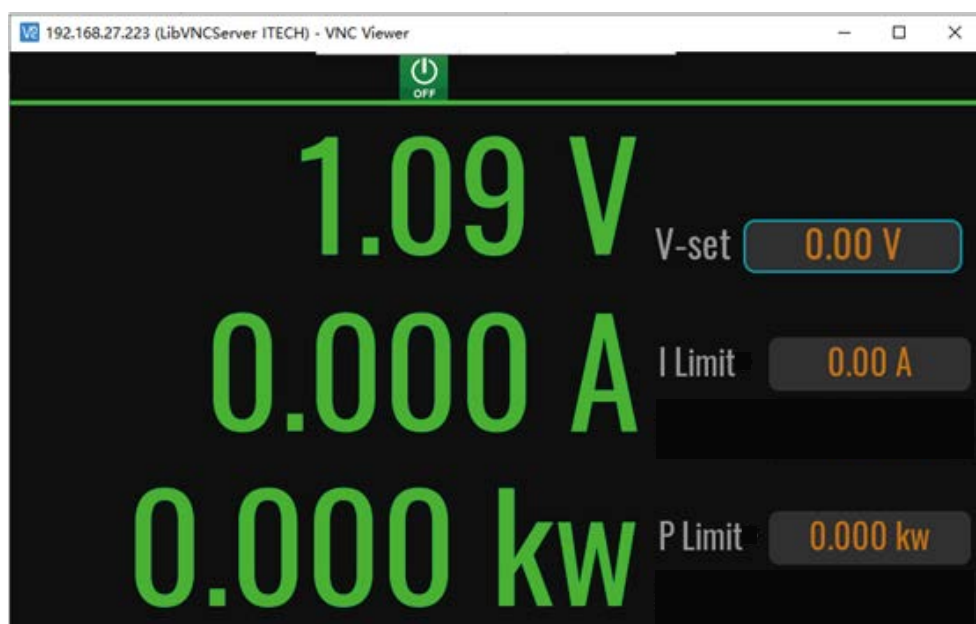

8.3 CAN 接口

CAN 接口位于仪器后面板上，在与计算机连接时，使用 CAN 通讯电缆连接本仪器和计算机。CAN 引脚定义如下所示。

引脚号	描述
H	CAN_H
L	CAN_L

CAN 配置

在进行远程控制之前必须在系统菜单（System）中对 CAN 接口参数进行配置。

项目	设置
波特率	可选择: 5k、10k、20k、40k、50k、80k、100k、125k、200k、250k、400k、500k、600k、800k、1000k
本机通信地址	范围: 0–127
协议 (Protocol)	选择CAN协议类型。 ● CAN_OPEN: CAN 总线的高级协议。 ● CAN2.0: ITECH CAN2.0 版本协议。

设置 CAN 接口参数的操作步骤如下：


1. 在前面板按下复合按键[Shift] + [P-set] (System)进入系统菜单界面。
2. 选中通信，按[Enter]键。
3. 按左右键，选中 CAN，按[Enter]键。
4. 逐个设置波特率、地址等参数，按[Enter]键。

CAN 故障解决：


如果 CAN 连接有问题，检查以下方面：

- 电脑和该仪器设备必须配置相同的波特率。
- 就如 CAN 连接器中描述的一样，必须使用正确的接口电缆或适配器。注意即使电缆有合适的插头，内部布线也可能不对。
- 接口电缆必须连接正确（CAN_H-CAN_H,CAN_L-CAN_L）。
- 若通讯信号质量较差或不稳定，建议连接 120 欧的终端电阻。

单台设备的连接示意图如下。

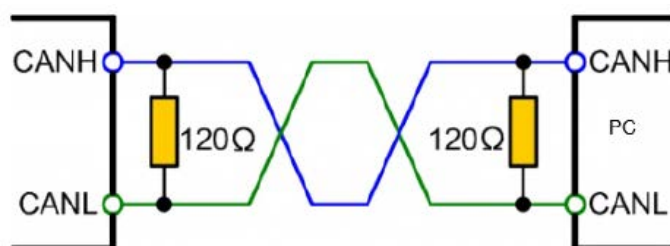

多台设备的连接示意图如下。

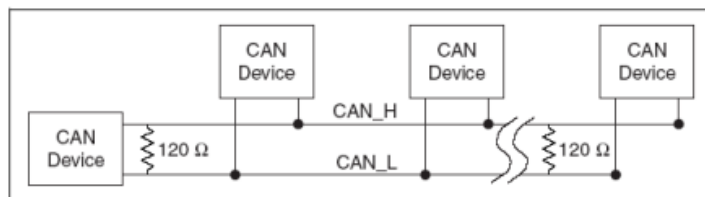

8.4 GPIB 接口（选配）

GPIB (IEEE-488) 接口位于 IT-E176 通讯卡上，在与计算机连接时，通过 GPIB 接口线缆将 GPIB 接口和计算机上 GPIB 卡连接好，一定要充分接触，将螺钉拧紧。

GPIB 配置


GPIB 接口上的每台设备必须具有一个介于 1 和 30 之间唯一的整数地址。您计算机的 GPIB 接口卡地址不能与接口总线上的任何仪器冲突。此设置为非易失性；它不会因为*RST 而改变。

当您购买了该接口配件、并且成功插入仪器后面板对应的位置后，在系统菜单（System）中才会出现可更改 GPIB 地址的菜单项。具体操作步骤如下：

1. 确认本仪器的电源开关已关闭，即仪器处于 Power Off 的状态。
2. 将单独购买的 GPIB 接口卡插入仪器后面板的卡槽。
3. 通过 GPIB 接口线缆将本仪器与计算机连接，连接成功后，打开本仪器的电源开关。
4. 在前面板按下复合按键[Shift] + [P-set] (System)进入系统菜单界面。
5. 选中通信，选中 GPIB，按[Enter]键。
6. 按数字键设置 GPIB 地址，按[Enter]键。

8.5 RS232 接口（选配）

RS232 接口与模拟量功能共用同一个通讯卡 IT-E177。

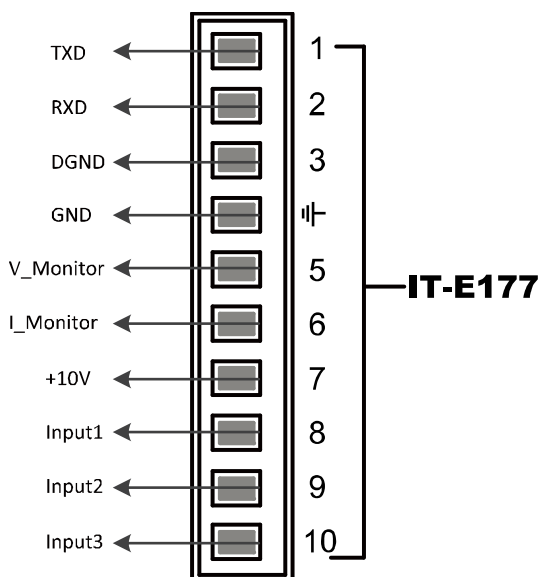

使用 RS232 接口通讯时，需将 IT-E177 的引脚 1、引脚 2、引脚 3 与 PC 进行连接。引脚说明如下：

引脚	说明
1	TXD，传输数据
2	RXD，接收数据
3	DGND，接地

当您购买了该接口配件、并且成功插入仪器后面板对应的位置后，在系统菜单（System）中才会出现 RS232 的菜单项。具体操作步骤如下：

1. 确认本仪器的电源开关已关闭，即仪器处于 **Power Off** 的状态。
2. 将单独购买的 RS232 接口卡插入仪器后面板的卡槽。
3. 通过 RS232 电缆将本仪器与计算机连接，连接成功后，打开本仪器的电源开关。
4. 在前面板按下复合按键[Shift] + [P-set] (System)进入系统菜单界面。
5. 选中**通信**，选中 RS232，按[Enter]键。
6. 依次设置相关的通讯参数，按[Enter]键。

RS232 故障解决

若使用 RS232 接口通讯时遇到问题，以下内容将有助于问题的解决：

- 检查计算机和仪器的波特率配置是否相同；
- 确认已经连接了正确的电缆与适配器。注意即使电缆有合适的插头，内部布线也可能不对；
- 接口电缆必须连接到计算机上正确的串口(COM1，COM2 等)。

8.6 EtherCAT 接口（选配）

EtherCAT 接口位于 IT-E1601-black 通讯卡上，在与计算机连接时，使用网线连接本仪器和计算机。

EtherCAT 配置

当您购买了该接口配件、并且成功插入仪器后面板对应的位置后，在系统菜单（System）中才会出现配置 EtherCAT 的菜单项。具体操作步骤如下。

1. 确认本仪器的电源开关已关闭，即仪器处于 **Power Off** 的状态。
2. 将单独购买的 EtherCAT 接口卡插入仪器后面板的卡槽。
3. 通过网线将本仪器与计算机连接，连接成功后，打开本仪器的电源开关。
4. 在 Menu 界面点击 **System**，进入系统菜单功能页面。
5. 点击 **COMM** 页签，进入通信设置页面。
6. 上下滑动 **COMM** 设置界面，找到菜单项 **Card Config**。

在 **Type** 功能处，点击右侧参数，在下拉选项框中选择 **ECAT**。

7. 通讯设置完成后，需重启机器才能正常通讯。
8. 重复上述步骤 4~6，可以查看 EtherCAT 信息。

显示信息	说明
Card Config	-
State: Init/Preop/Safeop/Op	状态：初始状态/预操作/安全操作/操作
Addr: 1001	从站地址（该地址由 EtherCAT 主站分配给本从站的地址）
Alias Addr: 1	从站地址别名
HW Ver: 256	通讯卡硬件版本号
Soft Ver: 1	通讯卡软件版本号

控制代码

本系列机器提供 xml 配置文件和 CANopen 控制协议，详细资料请联系 ITECH 官方获取。仅在需要更新内容或新增功能时，才需更新此 xml 文件。

附录

红黑测试线规格

艾德克斯公司为客户提供可选配的红黑测试线，用户可以选配本公司测试线进行测试，如下表格列出本公司红黑测试线规格与所能承受的最大电流。

型号	规格	长度	横截面积	描述
IT-E30110-AB	10A	1m	-	鳄鱼夹-香蕉插头红黑测试线一对
IT-E30110-BB	10A	1m	-	香蕉插头-香蕉插头红黑测试线一对
IT-E30110-BY	10A	1m	-	香蕉插头-Y端子红黑测试线一对
IT-E30312-YY	30A	1.2m	6mm ²	Y端子 红黑测试线一对
IT-E30320-YY	30A	2m	6mm ²	Y端子 红黑测试线一对
IT-E30615-OO	60A	1.5m	20mm ²	圆端子红黑测试线一对
IT-E31220-OO	120A	2m	50mm ²	圆端子红黑测试线一对
IT-E32410-OO	240A	1m	70mm ²	圆端子红黑测试线一对
IT-E32420-OO	240A	2m	70mm ²	圆端子红黑测试线一对
IT-E33620-OO	360A	2m	95mm ²	圆端子红黑测试线一对

如下表格列举了 AWG 铜线所能承受的最大电流值对应关系。

AWG	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
最大电流值(A)	40	25	20	13	10	7	5	3.5	2.5	1.7

注：AWG (American Wire Gage)，表示的是 X 号线（导线上有标记）。上表列举的是单条导线在工作温度 30°C 时的载流量。仅供参考。

联系我们

感谢您关注ITECH 产品,如果您对手册内容有任何疑问,可以通过以下几种方式联系我们。

